

Regione del Veneto  
**AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA**

**Delibera del Direttore Generale n. 1671 del 27/11/2020**

OGGETTO: ID 18P058 - Procedura aperta per la fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" per l'Azienda Ospedale-Università Padova per il periodo di 24 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Aggiudicazione fornitura ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si aggiudica definitivamente la procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" per l'Azienda Ospedale-Università Padova per il periodo di 24 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Inoltre si procede all'affidamento della fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" alle attuali ditte fornitrici fino al 28/02/2021, periodo necessario per il passaggio dalle attuali apparecchiature alle nuove apparecchiature.

Il Direttore della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** riferisce:

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 31/01/2020 è stata indetta gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" per l'Azienda Ospedale – Università Padova per il periodo di 24 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

Con il medesimo atto è stato stabilito di prevedere l'aggiudicazione per singolo lotto, completo di tutti i riferimenti previsti nei documenti di gara, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: qualità 70 punti (sulla base dei criteri riportati nel Capitolato Speciale), prezzo 30 punti.

Alla gara succitata è stata data pubblicità sulla base di quanto previsto dagli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016, e precisamente mediante la pubblicazione del bando e degli avvisi di gara nella G.U.U.E. e nella GURI

e, allo scopo di maggiore diffusione, per estratto in quattro quotidiani, di cui due a carattere nazionale e due a carattere locale.

Entro il termine perentorio stabilito nel Bando di gara (29/05/2020) hanno caricato la documentazione richiesta le seguenti ditte: MEDI-H-ART S.r.l. di Peschiera Borromeo (MI), Zuccato HC S.r.l. di Verona, Smith & Nephew S.r.l. di Agrate Brianza (MB), Sanacilia S.r.l. di Roma, Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio Unico di Verona, Lohmann & Rauscher S.r.l. di Rubano (PD) e Convatec Italia S.r.l. di Roma.

In data 04/06/2020 l'Autorità di gara ha proceduto alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa caricata dalle ditte concorrenti, con i seguenti esiti:

- ✓ le ditte MEDI-H-ART S.r.l., Zuccato HC S.r.l., Smith & Nephew S.r.l., Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio Unico, Lohmann & Rauscher S.r.l. e Convatec Italia S.r.l. sono state ammesse al prosieguo della presente procedura di gara in quanto la documentazione presentata è risultata completa e corretta;
- ✓ la ditta Sanacilia S.r.l. è stata ammessa con riserva in quanto la documentazione presentata è risultata incompleta.

A seguito richiesta prot. n. 34148 del 05/06/2020 da parte della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, la ditta Sanacilia S.r.l. ha inviato la documentazione integrativa e, pertanto, viene ammessa al prosieguo della procedura di gara in disamina – come da Verbale del 10/06/2020 agli atti presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 950 del 10/07/2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e della eventuale campionatura presentata dalle ditte concorrenti partecipanti alla procedura di gara avente per oggetto la fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" per l'Azienda Ospedale – Università Padova per il periodo di 24 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

Si precisa che con atto di fusione n. 6765 di Repertorio – n. 3402 di Raccolta, la ditta MEDI-H-ART S.r.l. è stata incorporata alla ditta Service Med S.p.a. di Milano.

Sulla base dei Verbali della Commissione Giudicatrice, sedute riservate del 28/07/2020, 04/09/2020, 07/09/2020 e 22/09/2020, risulta quanto segue:

- ✓ i lotti 1, 2 e 5 risultano aggiudicabili;
- ✓ i lotti 3 e 4 risultano non aggiudicabili in quanto le ditte offerenti non hanno raggiunto il punteggio minimo oppure non hanno i requisiti minimi stabiliti nei documenti di gara;
- ✓ la ditta MEDI-H-ART S.r.l., ora Service Med S.p.a., è stata esclusa dai lotti 1 e 2 in quanto non possiede i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Speciale (Verbale n. 1 del 28/07/2020);
- ✓ la ditta Zuccato HC S.r.l. è stata esclusa dal lotto 1 in quanto non raggiunge il punteggio minimo stabilito nel Capitolato Speciale e dal lotto 4 in quanto non possiede i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Speciale (Verbale n. 1 del 28/07/2020);
- ✓ la ditta Sanacilia S.r.l. è stata esclusa dai lotti 1 e 3 in quanto non raggiunge il punteggio minimo stabilito nel Capitolato Speciale;
- ✓ la ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. viene esclusa dai lotti 3 e 5 in quanto non possiede i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Speciale (Verbale n. 1 del 28/07/2020) e dal lotto 5 in quanto non raggiunge il punteggio minimo stabilito nel Capitolato Speciale;
- ✓ la ditta Lohmann & Rauscher S.r.l. viene esclusa del lotto 4 in quanto non raggiunge il punteggio minimo stabilito nel Capitolato Speciale.

Per quanto sopra risultano ammesse al prosieguo della presente procedura di gara, apertura busta economica, le ditte di seguito indicate per i lotti:

Ditta	Lotto
Smith & Nephew S.r.l.	1, 2, 5
Waldener Tecnologie Medicali S.r.l.	1, 2
Lohmann & Rauscher S.r.l.	1
Convatec Italia S.r.l.	5

Con comunicazione pubblicata sulla piattaforma telematica "Sintel" è stato reso noto alle ditte concorrenti che il giorno 27 ottobre 2020 alle ore 9,00 è stata fissata la seduta pubblica per l'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica.

Nella data sopraindicata l'Autorità di gara ha proceduto alla lettura dei Verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice e all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica delle ditte ammesse.

A seguito di tale operazione è risultato quanto segue:

LOTTO 1 – Importo a base d'asta € 164.957,24

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1 <sup>^</sup>	Waldner	€ 154.342,00	63	18,70	81,70
2 <sup>^</sup>	Lohmann	€ 94.684,00	50	30	80,00

3^	Smith&Nephew	€ 152.711,60	58	19,38	77,38
----	--------------	--------------	----	-------	-------

LOTTO 2 – Importo a base d'asta € 90.400,00

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Smith&Nephew	€ 59.648,00	61	30	91,00
2^	Waldner	€ 65.200,00	62	28,54	90,54

LOTTO 3 – Importo a base d'asta € 114.800,00

Nessuna offerta tecnica valida					
--------------------------------	--	--	--	--	--

LOTTO 4 – Importo a base d'asta € 29.673,60

Nessuna offerta tecnica valida					
--------------------------------	--	--	--	--	--

LOTTO 5 – Importo a base d'asta € 120.000,00

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Smith&Nephew	€ 108.000,00	67	25,66	92,66
2^	Convatec Italia	€ 97.600,00	60	30	90,00

per un importo complessivo di fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" per l'Azienda Ospedale – Università per il periodo di 24 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi di € 321.990,00 I.V.A. 22% esclusa.

Tenuto conto che le offerte della ditta Smith & Nephew S.r.l. per i lotti 2 e 5 hanno realizzato sia i quattro quinti dei punti relativi al prezzo che i quattro quinti dei punti relativi alla qualità, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato chiesto alla ditta sopraindicata di presentare le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare l'importo complessivo proposto.

A seguito della documentazione inviata dalla ditta Smith & Nephew S.r.l. non sono stati riscontrati elementi tali da ritenere le offerte non congrue, come risulta dal Verbale del 05/11/2020 agli atti presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Sulla base delle varie fasi di gara e delle risultanze vengono allegati al presenta atto e ne fanno parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- ✓ Verbale del 04/06/2020 con il quale l'Autorità di gara ha provveduto alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa caricata dalle ditte concorrenti – Allegato 1;
- ✓ Verbale del 10/06/2020 con il quale l'Autorità di gara ha provveduto all'ammissione delle ditte alla fase successiva di gara – Allegato 2;
- ✓ Verbale del 27/10/2020 con il quale l'Autorità di gara ha provveduto all'apertura della busta telematica economica delle ditte ammesse ed

all'individuazione della ditta prima in graduatoria. Tale Verbale del 27/10/2020 comprende: a) Verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 28/07/2020, Verbale n. 2 del 04/09/2020, Verbale n. 3 del 07/09/2020 e Verbale n. 4 del 22/09/2020 – si precisa che il Verbale n. 4 del 22/09/2020 è comprensivo degli allegati con i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice e le relative motivazioni; b) offerte delle ditte Smith & Nephew S.r.l. per i lotti 2 e 5 e Waldner Technologie Medicali S.r.l. per il lotto 1 – Allegato 3.

Nelle more della conclusione della procedura di affidamento in oggetto ed al fine di consentire alle Unità Operative che utilizzano i sistemi a pressione negativa e relativo materiale di consumo di gestire il passaggio dagli attuali sistemi ai nuovi sistemi garantendo nello stesso tempo la regolarità e qualità del servizio, si rende necessario affidare agli attuali fornitori la fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" fino al 28/02/2021, periodo necessario – tenuto conto della particolarità dei dispositivi qui trattati - per gestire il passaggio succitato per un importo, calcolato sulla base dei consumi dell'ultimo periodo, di € 45.500,00 I.V.A. 22% esclusa, così suddiviso: € 12.000,00 ditta Smith & Nephew S.r.l. e € 33.500,00 ditta Waldner Technologie Medicali S.r.l..

In considerazione di ciò, con note prot. n. 70538/2020 e n. 70539/2020, è stato richiesto rispettivamente alle ditte Smith & Nephew S.r.l. e Waldner Technologie Medicali S.r.l. disponibilità a garantire le attuali forniture fino al 28/02/2021 confermando o migliorando le condizioni economiche attualmente in essere.

Le ditte sopraindicate hanno comunicato la propria disponibilità a proseguire gli attuali contratti di fornitura fino al 28/02/2021 confermando le condizioni economiche, come risulta da documentazione agli atti presso questa Unità Operativa.

Si propone pertanto:

- a) di assegnare la fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" per l'Azienda Ospedale – Università Padova per il periodo di 24 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi alle ditte indicate nelle tabelle sopra riportate per un importo complessivo di € 321.990,00 I.V.A. 22% esclusa, per i dispositivi indicati nelle offerte presentate dalle ditte aggiudicatrici e allegate nel Verbale apertura economica del 27/10/2020 nelle quali viene riportato: descrizione del prodotto, nome commerciale del prodotto, codice prodotto, marca prodotto, CND, RDM, fabbisogno per 12 mesi, prezzo unitario, prezzo

## AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

- complessivo per 12 mesi e prezzo complessivo per 48 mesi;
- b) di procedere all'affidamento alle attuali ditte fornitrici, Smith & Nephew S.r.l. e Waldner Tecnologie Medicali S.r.l., della fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" fino al 28/02/2021 – periodo necessario per il passaggio dagli attuali sistemi a pressione negativa ai nuovi sistemi a pressione negativa garantendo la regolarità e qualità del servizio – per un importo complessivo di € 45.500,00 I.V.A. 22% esclusa.

Di prendere atto che i lotti 3 e 4 non possono essere aggiudicati in quanto:

- ✓ l'offerta tecnica della ditta Sanacilia S.r.l. per il lotto 3 non ha raggiunto il punteggio minimo stabilito nel Capitolato Speciale;
- ✓ l'offerta tecnica della ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. per i lotti 3 e 4 non possiede i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Speciale;
- ✓ l'offerta tecnica della ditta Zuccato HC S.r.l. per il lotto 4 non possiede i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Speciale.

Si evidenzia che la procedura d'acquisto in disamina non è allo stato attuale oggetto di Convenzioni Attive CONSIP e neppure di gare centralizzate a livello regionale.

Viene approntata la presente deliberazione avendo presente quanto disposto dalla normativa vigente per l'acquisto di beni e servizi.

Tutto ciò premesso:

### IL DIRETTORE GENERALE

**PRESO ATTO** della suesposta proposta e accertato che il Direttore della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

**IN BASE** ai poteri conferitigli dal D.P.G.R.nr.92 del 01.08.2016.

Regione del Veneto  
**AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA**

**DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di prendere atto:

- ✓ del Verbale del 04/06/2020 con il quale l'Autorità di gara ha provveduto alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa caricata dalle ditte concorrenti - Allegato 1;
- ✓ del Verbale del 10/06/2020 con il quale l'Autorità di gara ha provveduto all'ammissione delle ditte alla fase successiva di gara - Allegato 2;
- ✓ del Verbale del 27/10/2020 con il quale l'Autorità di gara ha provveduto all'apertura della busta telematica economica delle ditte ammesse ed all'individuazione della ditta prima in graduatoria. Tale Verbale del 27/10/2020 comprende: a) Verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 28/07/2020, Verbale n. 2 del 04/09/2020, Verbale n. 3 del 07/09/2020 e Verbale n. 4 del 22/09/2020 - si precisa che il Verbale n. 4 del 22/09/2020 è comprensivo degli allegati riportanti i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice e le relative motivazioni; b) offerte delle ditte Smith & Nephew S.r.l. per i lotti 2 e 5 e Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. per il lotto 1 - Allegato 3;

2. di aggiudicare conseguentemente, sulla base di quanto previsto dall'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" per l'Azienda Ospedale - Università Padova per il periodo di 24 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi per un importo complessivo di € 321.990,00 I.V.A. 22% esclusa alle ditte indicate nel Verbale apertura economica del 27/10/2020 e sulla base delle offerte allegate nelle quali viene riportato: descrizione del prodotto, nome commerciale del prodotto, codice prodotto, marca prodotto, CND, RDM, fabbisogno per 12 mesi, prezzo unitario, prezzo complessivo per 12 mesi e prezzo complessivo per 48 mesi;
3. di prendere atto che, per le motivazioni indicate in premessa, i lotti 3 e 4 non possono essere aggiudicati;
4. di subordinare l'aggiudicazione di cui al punto 2) all'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa che regola i contratti pubblici di fornitura;
5. di precisare che la spesa complessiva di € 392.827,80 I.V.A 22% inclusa sarà imputata ai conti costo n. 400101080103 e n. 40040201 aventi per oggetto rispettivamente "Dispositivi medici altro" e "Canoni di noleggio" e ripartita negli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024;

**AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA**

6. di procedere con successivo atto alla nomina, ai sensi dell'articolo 300 del D.P.R. n. 207/2010, del Direttore dell'esecuzione del contratto;
7. di dare atto che gli atti essenziali richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013, di cui all'Allegato 4 facente parte integrante e sostanziale del presente atto, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedale – Università Padova;
8. di procedere all'affidamento alle attuali ditte fornitrici, Smith & Nephew S.r.l. e Waldner Tecnologie Medicali S.r.l., della fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" fino al 28/02/2021 – periodo necessario per il passaggio dagli attuali sistemi a pressione negativa ai nuovi sistemi a pressione negativa garantendo la regolarità e qualità del servizio – per un importo complessivo di € 45.500,00 I.V.A. 22% esclusa;
9. di precisare che la spesa complessiva di cui al punto precedente pari a € 55.510,00 I.V.A. 22% inclusa farà carico ai conti costo n. 400101080103 e n. 40040201 aventi per oggetto rispettivamente "Dispositivi medici altro" e "Canoni di noleggio" e ripartita negli esercizi finanziari 2020-2021;
10. di delegare il Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti.

Il Direttore Generale  
F.to Dr. Luciano Flor



Regione del Veneto

## AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – [www.aopd.veneto.it](http://www.aopd.veneto.it) – P.E.C.: [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Luisa Bissoli

**ID Gara n. 18P058 – Procedura aperta telematica per la fornitura di “Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse” per l’Azienda Ospedale – Università Padova per il periodo di 24 mesi + opzione di rinnovo per 24 mesi.**

### VERBALE APERTURA AMMINISTRATIVA

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 4 (quattro) del mese di giugno alle ore 9,00 (nove/zero) presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – Viale della Navigazione Interna 38 – 35129 Z.I. Padova, il seggio di gara nominato con nota prot. n. 33401 del 03/06/2020 (costituito dalla Dott.ssa Antonella Dai Prà dirigente amministrativo, in qualità di Autorità di gara, dal Rag. Fabio Moro collaboratore amministrativo in qualità di teste e verbalizzante e dalla Dott.ssa Maria Caratozzolo assistente amministrativo in qualità di teste), procede all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa.

Si precisa che:

- la procedura di gara in disamina è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 31/01/2020;
- la procedura verrà espletata utilizzando il sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a. denominato “Sintel”;
- il seggio di gara incaricato individuato con nota prot. n. 33401 del 03/06/2020 del Dirigente della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica è costituito da:
  - Dott.ssa Antonella Dai Prà – in qualità di Autorità di gara
  - Rag. Fabio Moro – in qualità di teste e verbalizzante
  - Dott.ssa Maria Caratozzolo – in qualità di teste
- come da invito inoltrato tramite la piattaforma telematica Sintel hanno caricato entro il termine

fissato nei documenti di gara (29/05/2020) la documentazione richiesta le seguenti ditte: MEDI-H-ART S.r.l. di Peschiera Borromeo (MI), Zuccato HC S.r.l. di Verona, Smith & Nephew S.r.l. di Agrate Brianza (MB), Sanacilia S.r.l. di Roma, Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio Unico di Verona, Lohmann & Rauscher S.r.l. di Rubano (PD) e Convatec Italia S.r.l. di Roma;

- tramite la piattaforma telematica "Sintel" e il sito web dell'Azienda Ospedale – Università Padova è stato comunicato alle ditte che l'apertura della busta telematica amministrativa avviene, tenuto conto dello stato di emergenza provocato dalla diffusione del virus COVID-19 appena passato, in seduta riservata in data odierna alle ore 9,00.

A seguito delle operazioni di apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa è risultato quanto segue:

- ✓ la documentazione amministrativa presentata dalle ditte MEDI-H-ART S.r.l., Zuccato HC S.r.l., Smith & Nephew S.r.l., Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio Unico, Lohmann & Rauscher S.r.l. e Convatec Italia S.r.l. risulta completa e corretta e, pertanto, le ditte vengono ammesse al prosieguo della procedura di gara in disamina;
- ✓ la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Sanacilia S.r.l. risulta incompleta (DGUE – Parte IV – Lettera C – Punto 12), pertanto la ditta viene ammessa con riserva.

Questa Unità Operativa provvederà a richiedere alla ditta Sanacilia S.r.l. l'integrazione della documentazione presentata.

La seduta di gara si conclude alle ore 12,45.

Viene redatto il presente verbale, composto da 3 facciate e n. 1 allegato, sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

IL SEGGIO DI GARA:

PRESIDENTE

Dott.ssa Antonella Dai Prà



TESTE

Dott.ssa Maria Caratozzolo

Maria Caratozzolo

VERBALIZZANTE

Rag Fabio Moro

Fabio Moro

AT

SCHEMA AMMISSIONE DITTE SEDUTA PUBBLICA DEL 04/06/2020 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE COMPLESSE" PER L'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA PER IL PERIODO DI 48 MESI, COMPRENSIVO DELL'OPZIONE DI RINNOVO PER 24 MESI															
	Ditta	Lotti per i quali la ditta partecipa	Istanza - Allegato "A"	DGUE - Allegato B all'Istanza di partecipazione	Imposta di bollo	Garanzia Provvisoria	Dichiarazione impegno fideiussore	Ricevuta versamento contributo ANAC per il Lotto 1	Avvalimento	R.T.I.	In caso di R.T.I. dichiarazione di: Mandato, Quote, impegno	Segreto commerciale	Subappalto	NOTE	Ammessa, Non Ammessa, Ammessa con riserva
1	MEDI-H-ART S.r.l.	1 - 2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	/	/	/	NO	NO		AMMESSA
2	ZUCCATO HC	1 - 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	/	/	/	SI	NO		AMMESSA
3	SMITH & NEPHEW S.r.l.	1 - 2 - 5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	/	/	/	NO	NO		AMMESSA
4	SANACILIA S.r.l.	1 - 3	OK	Incompleto (Parte IV - Lettera C - Punto 12)	OK	OK	OK	OK	/	/	/	SI	NO		AMMESSA CON RISERVA
5	WALDNER Tecnologie Medicali S.r.l.	1 - 2 - 3 - 4 - 5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	/	/	/	SI	NO		AMMESSA
6	LOHMANN & RAUSCHER S.r.l.	1 - 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	/	/	/	NO	NO		AMMESSA
7	CONVATEC ITALIA S.r.l.	5	OK	OK	OK	OK	OK	Non prevista	/	/	/	SI	NO		AMMESSA



Regione del Veneto

## AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111

Cod. Fisc./P. IVA 00349040287 – [www.aopd.veneto.it](http://www.aopd.veneto.it) – P.E.C.: [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it)

### DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Luisa Bissoli

**ID Gara n. 18P058 – Procedura aperta telematica per la fornitura di “Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse” per l’Azienda Ospedale – Università Padova per il periodo di 24 mesi + opzione di rinnovo per 24 mesi.**

#### VERBALE AMMISSIONE DITTE

L'anno 2020 (duemilaventini) il giorno 10 (dieci) del mese di giugno alle ore 11,00 (undici/zero) presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – Viale della Navigazione Interna 38 – 35129 Z.I. Padova, il seggio di gara nominato con nota prot. n. 35226 del 10/06/2020 (costituito dalla Dott.ssa Antonella Dai Prà dirigente amministrativo, in qualità di Autorità di gara, dal Rag. Fabio Moro collaboratore amministrativo in qualità di teste e verbalizzante e dal Dott. Daniele Rizzo collaboratore amministrativo in qualità di teste), procede all'ammissione delle ditte che hanno risposto alla procedura in disamina.

Si precisa che:

- la procedura di gara in disamina è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 31/01/2020;
- il seggio di gara incaricato individuato con nota prot. n. 35226 del 10/06/2020 del Dirigente della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica è costituito da:
  - Dott.ssa Antonella Dai Prà – in qualità di Autorità di gara
  - Rag. Fabio Moro – in qualità di teste e verbalizzante
  - Dott. Daniele Rizzo – in qualità di teste
- come da invito inoltrato tramite la piattaforma telematica Sintel hanno caricato entro il termine fissato nei documenti di gara (29/05/2020) la documentazione richiesta le seguenti ditte:  
MEDI-H-ART S.r.l. di Peschiera Borromeo (MI), Zuccato HC S.r.l. di Verona, Smith & Nephew

S.r.l. di Agrate Brianza (MB), Sanacilia S.r.l. di Roma, Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio Unico di Verona, Lohmann & Rauscher S.r.l. di Rubano (PD) e Convatec Italia S.r.l. di Roma;

- ✓ a seguito delle operazioni di apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa avvenuta in data 4 giugno 2002 è risultato che:
  - le ditte MEDI-H-ART S.r.l., Zuccato HC S.r.l., Smith & Nephew S.r.l., Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio Unico, Lohmann & Rauscher S.r.l. e Convatec Italia S.r.l. sono state ammesse al prosieguo della presente procedura di gara in quanto la documentazione amministrativa presentata era risultata completa e corretta;
  - la ditta Sanacilia S.r.l. era stata ammessa con riserva in quanto il DGUE era risultato incompleto.

A seguito richiesta, prot. 34148 del 05/06/2020, la ditta Sanacilia S.r.l. ha inviato la documentazione integrativa e, pertanto, viene ammessa al prosieguo della procedura di gara in disamina.

La seduta di gara si conclude alle ore 12,00.

Viene redatto il presente verbale, composto da 3 facciate sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

IL SEGGIO DI GARA:


PRESIDENTE

Dott.ssa Antonella Dai Prà

  
\_\_\_\_\_

TESTE

Dott. Daniele Rizzo

  
\_\_\_\_\_

VERBALIZZANTE

Rag Fabio Moro

  
\_\_\_\_\_



Regione del Veneto

## AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – [www.aopd.veneto.it](http://www.aopd.veneto.it) – P.E.C.: [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it)

### DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Luisa Bissoli

**ID Gara n. 18P058 – Procedura aperta telematica per la fornitura di “Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse” per l’Azienda Ospedale – Università Padova per il periodo di 24 mesi + opzione di rinnovo per 24 mesi.**

#### VERBALE APERTURA ECONOMICA

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre alle ore 9,00 (nove/zero) presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – Viale della Navigazione Interna 38 – 35129 Z.I. Padova, il seggio di gara nominato con nota prot. n. 64249 del 27/10/2020 (costituito dalla Dott.ssa Antonella Dai Prà dirigente amministrativo, in qualità di Autorità di gara, dal Rag. Fabio Moro collaboratore amministrativo in qualità di teste e verbalizzante e dalla Sig.ra Nicoletta Pegoraro collaboratore amministrativo in qualità di teste), procede all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica.

Si prende atto, che risultano presenti le seguenti ditte:

- ✓ Zuccato HC S.r.l., rappresentata dal Sig. Emanuele Disperati nato a Verona il 08/12/1982 (C.I. AT7646592 rilasciata dal Comune di Verona il 18/06/2013) giusta delega conferita in data 27/10/2020 che gli permette di rappresentare la ditta nella presente seduta di gara;
- ✓ Smith & Nephew S.r.l., rappresentata dalla Sig.ra Simona Maria Cirincione nata a Foggia il 10/02/1970 (C.I. AT5089002 rilasciata dal Comune di Padova il 12/11/2011) giusta delega conferita in data 21/10/2020 che gli permette di rappresentare la ditta nella presente seduta di gara;
- ✓ Waldner Tecnologie Medicali S.r.l., rappresentata dalla Sig.ra Daniela Bottarel nata a Uznach (CH) il 01/04/1968 (C.I. AV2110923 rilasciata dal Comune di Padova il 16/04/2015) giusta delega conferita in data 22/10/2020 che gli permette di rappresentare la ditta nella presente

seduta di gara;

- ✓ Lohmann & Rauscher S.r.l., rappresentata dalla Sig.ra Monica Andreazzo nata a Camposampiero (PD) il 20/08/1987 (C.I. AU4979716 rilasciata dal Comune di Massanzago – PD – il 26/09/2013) giusta procura registrata in data 27/11/2019 – n° 19136 S. 1T che gli permette di rappresentare la ditta nella presente seduta di gara;
- ✓ Convatec Italia S.r.l., rappresentata dalla Sig.ra Claudia Alfonsi nata a Padova il 18/02/1988 (C.I. AU4963084 rilasciata dal Comune di Noventa Padovana – PD – il 23/02/2013) giusta procura registrata in data 21/10/2019 – n° 32276 S. 1T che gli permette di rappresentare la ditta nella presente seduta di gara.

Si precisa che:

- la procedura di gara in disamina è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 31/01/2020;
- la procedura verrà espletata utilizzando il sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a. denominato "Sintel";
- il seggio di gara incaricato individuato con nota prot. n. 64249 del 27/10/2020 del Dirigente della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica è costituito da:
  - Dott.ssa Antonella Dai Prà – in qualità di Autorità di gara
  - Rag. Fabio Moro – in qualità di teste e verbalizzante
  - Sig.ra Nicoletta Pegoraro – in qualità di teste
- come da invito inoltrato tramite la piattaforma telematica Sintel hanno caricato entro il termine fissato nei documenti di gara (29/05/2020) la documentazione richiesta le seguenti ditte: MEDI-H-ART S.r.l. di Peschiera Borromeo (MI), Zuccato HC S.r.l. di Verona, Smith & Nephew S.r.l. di Agrate Brianza (MB), Sanacilia S.r.l. di Roma, Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio Unico di Verona, Lohmann & Rauscher S.r.l. di Rubano (PD) e Convatec Italia S.r.l. di Roma;
- come risulta dai Verbali del 04/06/2020 e del 10/06/2020 – custoditi presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica -, con i quali l'Autorità di gara ha proceduto alla verifica della correttezza e completezza della documentazione amministrativa ed alla conseguente ammissione delle ditte concorrenti alla successiva fase di gara per i

seguenti lotti:

- ✓ MEDI-H-ART S.r.l. lotti 1 e 2
- ✓ Zuccato HC S.r.l. lotti 1 e 4
- ✓ Smith & Nephew S.r.l. lotti 1, 2 e 5
- ✓ Sanacilia S.r.l. lotti 1 e 3
- ✓ Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. lotti 1, 2, 3, 4 e 5
- ✓ Lohmann & Rauscher S.r.l. lotti 1 e 4
- ✓ Convatec Italia S.r.l. lotto 5

- l'aggiudicazione avverrà per lotto completo di tutti i riferimenti previsti nel Capitolato Tecnico, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: Qualità punteggio massimo 70 punti (sulla base dei criteri riportati nel Capitolato Speciale), Prezzo punteggio massimo 30 punti;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 950 del 10/07/2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;
- la Commissione Giudicatrice a seguito dei lavori di valutazione delle offerte tecniche e della campionatura richiesta e presentata ha redatto per ogni attività svolta, sedute riservate del 28/07/2020, 04/09/2020, 07/09/2020 e 22/09/2020, i relativi verbali custoditi presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
- con atto di fusione, n. 6765 di Repertorio – n. 3402 di Raccolta, la ditta Medi-H-Art S.r.l. è stata incorporata alla ditta Service Med S.p.a.;
- dai Verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice risulta quanto segue:
  - ✓ risultano aggiudicabili i lotti 1, 2 e 5 – non risultano aggiudicabili i lotti 3 e 4;
  - ✓ la ditta Medi-H-Art S.r.l., ora Service Med S.p.a., viene esclusa dai lotti 1 e 2 in quanto non possiede uno dei requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Speciale;
  - ✓ la ditta Zuccato HC S.r.l. viene esclusa dai lotti 1 e 4 rispettivamente per non aver raggiunto il punteggio minimo e per mancanza di uno dei requisiti stabiliti nel Capitolato Speciale;
  - ✓ la ditta Sanacilia S.r.l. viene esclusa dai lotti 1 e 3 in quanto non raggiunge il punteggio

HP

minimo stabilito nel Capitolato Speciale;

- ✓ la ditta Waldner Technologie Medicali S.r.l. viene esclusa dai lotti 3 e 4 in quanto non possiede uno dei requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Speciale e dal lotto 5 in quanto non raggiunge il punteggio minimo;
- ✓ la ditta Lohmann & Rauscher S.r.l. viene esclusa dal lotto 4 in quanto non possiede uno dei requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Speciale;

Per quanto sopra si procederà all'apertura delle busta telematica contenente l'offerta economica delle ditte sotto indicate per i lotti di seguito indicati:

Lotto	Ditte:
1	Smith & Nephew S.r.l., Waldner Technologie Medicali S.r.l., Lohmann & Rauscher S.r.l.
2	Smith & Nephew S.r.l., Waldner Technologie Medicali S.r.l.
3	Nessuna offerta tecnica valida
4	Nessuna offerta tecnica valida
5	Smith & Nephew S.r.l., Convatec Italia S.r.l.

*AS*

Si procede all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica delle ditte sopraindicate ed alla conseguente individuazione delle ditte aggiudicatarie.

Da tale operazione è risultato quanto segue:

LOTTO 1 – Importo a base d'asta € 164.957,24

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1 <sup>^</sup>	Waldner Technologie	€ 154.342,00	63	18,70	81,70
2 <sup>^</sup>	Lohmann & Rauscher	€ 94.684,00	50	30	80,00
3 <sup>^</sup>	Smith&Nepheew	€ 152.711,60	58	19,38	77,38

LOTTO 2 – Importo a base d'asta € 90.400,00

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1 <sup>^</sup>	Smith&Nepheew	€ 59.648,00	61	30	91,00
2 <sup>^</sup>	Waldner Technologie	€ 65.200,00	62	28,54	90,54

LOTTO 3 – Importo a base d'asta € 114.800,00

Nessuna offerta tecnica valida
--------------------------------

LOTTO 4 – Importo a base d'asta € 29.673,60

Nessuna offerta tecnica valida

LOTTO 5 – Importo a base d'asta € 120.000,00

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Smith&Nephew	€ 108.000,00	67	25,66	92,66
2^	Convatec Italia	€ 97.600,00	60	30	90,00

Dal momento che l'offerta della ditta Smith & Nephew S.r.l., per i lotti 2 e 5, ha realizzato sia i quattro quinti dei punti relativi al prezzo che i quattro quinti dei punti relativi alla qualità, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà cura della Stazione Appaltante richiedere alla ditta sopraindicata la presentazione delle giustificazioni relativi alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo proposto.

L'aggiudicazione definitiva della fornitura rimane subordinata a quanto stabilito nei documenti di gara che regolano la presente procedura, ed a quant'altro dovesse emergere in merito alla regolarità delle offerte e della documentazione presentata dalle ditte aggiudicatarie.

La seduta di gara si conclude alle ore 10,35.

Viene redatto il presente verbale, composto da 5 (cinque) facciate e n. 7 allegati rappresentati da: Verbale n. 1 del 28/07/2020, Verbale n. 2 del 04/09/2020, Verbale n. 3 del 07/09/2020 e Verbale n. 4 del 22/09/2020 – nei quali vengono riportate le motivazioni ed i relativi punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice, offerta della ditta Waldner Technologie Medicali S.r.l. per il lotto 1 e offerte della ditta Smith & Nephew S.r.l. per i lotti 2 e 5, sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

IL SEGGIO DI GARA:

PRESIDENTE

Dott.ssa Antonella Dai Prà

Antonella Dai Prà

TESTE

Sig.ra Nicoletta Pegoraro


Nicoletta Pegoraro

VERBALIZZANTE

Rag Fabio Moro

Fabio Moro

AM



Regione del Veneto  
**AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA**  
[www.aopd.veneto.it](http://www.aopd.veneto.it) – P.E.C.: [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it)  
via Nicolò Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA  
c.f./p.iva 00349040287

**VERBALE N. 1 del 28 Luglio 2020**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE COMPLESSE PER L'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA PER IL PERIODO DI 48 MESI (COMPRENSIVO DELL'OPZIONE DI RINNOVO PER 24 MESI) – ID GARA 18P065**

L'anno duemilaventiti, il giorno 28 del mese di luglio alle ore 15,00 presso il Centro Gallucci - Biblioteca "Pier Giuseppe Cesese" dell'Azienda Ospedale – Università Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura aperta telematica mediante piattaforma Sintel, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" per l'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 31/01/2020.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 950 del 10/07/2020 è così composta:

**PRESIDENTE:** Dott. Roberto Bianco – U.O.C. Cardiocirurgia

**COMPONENTI:** Dott.ssa Carlotta Scarpa – U.O.C. Chirurgia Plastica

Dott. Alex Pontini – U.O.C. Grandi Ustionati

Dott. Enzo Mammano – S.C. Chirurgia OSA

P.I. Roberto Bacchin – U.O.S. Ingegneria Clinica

**PREMESSO**

- che l'aggiudicazione della fornitura succitata verrà effettuata per lotto completo ed indivisibile (le ditte dovranno offrire tutti i riferimenti facenti parte del lotto);

- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio stabilito all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio qualità + punteggio prezzo), determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità                      punteggio massimo punti 70  
- prezzo                      punteggio massimo punti 30

- che a seguito dell'assegnazione dei punteggi, come indicato al punto precedente, verranno individuate, lotto per lotto, le ditte che avendo proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa risultano prime in graduatoria;
- che non verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le ditte che otterranno un punteggio di qualità inferiore a 42 punti su 70 punti.

#### IL PRESIDENTE

- constatata la presenza di tutti componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
  1. l'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dai documenti di gara;
  2. l'eventuale richiesta di campionatura

Precisa che le varie fasi di verifica/valutazione potranno essere effettuate dai vari componenti della Commissione Giudicatrice, sulla base delle specifiche competenze e della tipologia dei prodotti da esaminare, anche separatamente senza la presenza simultanea di tutti i componenti.

Rimane inteso che gli esiti di tali verifiche/valutazioni saranno condivisi da tutti i componenti della Commissione Giudicatrice.  
Inoltre:

- ✓ rileva che entro i termini previsti (29/05/2020) hanno inviato la documentazione richiesta le seguenti ditte:  
MEDI-HART S.r.l. di Peschiera Borromeo (MI) per i lotti 1 e 2  
Zuccato HC S.r.l. di Verona per i lotti 1 e 4  
Smith & Nephew S.r.l. di Agrate Brianza (MB) per i lotti 1, 2 e 5  
Sanacilia S.r.l. di Roma per i lotti 1 e 3  
Waldner Technologie Medicali S.r.l. a Socio Unico di Verona per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5  
Lohmann & Rauscher S.r.l. di Rubano per i lotti 1 e 4  
Convatec Italia S.r.l. per il lotto 5
- ✓ da corso alla lettura della documentazione tecnica presentata secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale e dal Disciplinare di gara.

#### LA COMMISSIONE

procede alla verifica dei requisiti minimi dei dispositivi proposti dalle ditte con i seguenti esiti:




- ✓ la ditta MEDI-HART S.r.l. NON rispetta i requisiti minimi di durata della batteria per i lotti 1 e 2, pertanto non si procede alla valutazione dei prodotti;
- ✓ la ditta Waldner Technologie Medicali S.r.l. NON rispetta i requisiti minimi di durata della batteria per i lotti 3 e 4, pertanto non si procede alla valutazione dei prodotti;
- ✓ la ditta Zucato HC S.r.l. NON rispetta i requisiti minimi per il lotto 4, e precisamente: presenta Canister NON sterili e materiale NON idoneo al contatto con i visceri; in quanto manca in IFU la specifica di possibile utilizzo a contatto con gli stessi, pertanto non si procede alla valutazione del prodotto.

La Commissione decide che il P.I. Roberto Bacchin provvederà ad inoltrare alla U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica la richiesta di campionatura da inviare alle ditte concorrenti, la campionatura dovrà essere consegnata entro il 21/08/2020.

I lavori si concludono alle ore 17,00.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dott. Roberto Bianco	
Dott.ssa Carlotta Scarpa	
Dott. Alex Pontini	
Dott. Enzo Mammamo	
P.I. Roberto Bacchin	

Verbalizzante: Dott.ssa Carlotta Scarpa



Regione del Veneto  
**AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA**

[www.aopd.veneto.it](http://www.aopd.veneto.it) - P.E.C.: [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it)

via Nicolò Giustiniani, 1 - 35128 PADOVA

c.f./p.iva 00349040287

**VERBALE N. 2 del 4 settembre 2020**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE COMPLESSE PER L'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA PER IL PERIODO DI 48 MESI (COMPRENSIVO DELL'OPZIONE DI RINNOVO PER 24 MESI) - ID GARA 18P065**

L'anno duemilaventit, il giorno 4 del mese di settembre alle ore 13,00 presso il Centro Gallucci - Biblioteca "Pier Giuseppe Cevese" dell'Azienda Ospedale - Università Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura aperta telematica mediante piattaforma Sintel, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" per l'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 31/01/2020.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 950 del 10/07/2020 è così composta:

**PRESIDENTE:** Dott. Roberto Bianco - U.O.C. Cardiocirurgia

**COMPONENTI:** Dott.ssa Carlotta Scarpa - U.O.C. Chirurgia Plastica

Dott. Alex Pontini - U.O.C. Grandi Ustionati

Dott. Enzo Mammano - S.C. Chirurgia OSA

P.I. Roberto Bacchin - U.O.S. Ingegneria Clinica

**PREMESSO**

- che l'aggiudicazione della fornitura succitata verrà effettuata per lotto completo ed indivisibile (le ditte dovranno offrire tutti i riferimenti facenti parte del lotto);



- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio stabilito all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio qualità + punteggio prezzo), determinandola in base ai seguenti parametri:  
 - qualità punteggio massimo punti 70  
 - prezzo punteggio massimo punti 30
- che a seguito dell'assegnazione dei punteggi, come indicato al punto precedente, verranno individuate, lotto per lotto, le ditte che avendo proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa risultano prime in graduatoria;
- che non verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le ditte che otterranno un punteggio di qualità inferiore a 42 punti su 70 punti.

**IL PRESIDENTE**

- constatata la presenza di tutti componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'assegnazione dei punteggi e relative motivazioni.

**LA COMMISSIONE**

procede all'assegnazione dei punteggi qualità e relative motivazioni sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati:

n.	Criteri di valutazione della qualità LOTTI 1, 2, 3 e 4	Punteggio minimo pena esclusione	Punteggio massimo

<b>APPARECCHIATURE</b>			
	Assistenza tecnica (organizzazione del servizio, tecnici dedicati su Padova, tempi di risposta massima per intervento tecnico, risoluzione del guasto ed intervento tempestivo in caso di guasto) fornire autodichiarazione	-	
2	Durata ed autonomia della batteria	-	10
3	Ingombro, sistema di trasporto e aggancio al letto	-	10
4	Facilità di percezione e gestione degli allarmi	-	10
	<b>MATERIALE DI CONSUMO</b>	-	



ML






AR

	comprensibilità dei dati relativi al dispositivo contenuto, lotto, scadenza, ref. ecc.)		
6	Gamma, misure e caratteristiche tecniche delle medicazioni	-	10
	<b>APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO</b>		
7	Maneggevolezza e praticità d'uso del sistema	-	10
	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>		<b>70</b>

Non verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le ditte che totalizzeranno un punteggio di qualità inferiore al punteggio minimo di 42 punti.

Gli allegati riportanti i punteggi con relative motivazioni assegnati alle ditte concorrenti vengono allegati al presente verbale e ne fanno parte integrante e sostanziale (n. 12 Allegati).

La Commissione non procede all'assegnazione del punteggio relativo al criterio 1: "Assistenza tecnica (organizzazione del servizio, tecnici dedicati su Padova, tempi di risposta massima per intervento tecnico, risoluzione del guasto, da specificare, ed intervento tempestivo in caso di guasto) fornire autodichiarazione" in quanto si riserva di effettuare ulteriori verifiche e approfondimenti.

I lavori si concludono alle ore 16,30.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:


Dott. Roberto Bianco	
Dott.ssa Carlotta Scarpa	
Dott. Alex Pontini	
Dott. Enzo Mammamo	

AR



P.I. Roberto Bacchin	
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Verbalizzante: Dott.ssa Carlotta Scarpa



### **Lotto 1: Terapia a pressione negativa.**

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione di ogni Ditta e all'assegnazione dei punteggi

#### **Ditta Waldner Tecnologie Medicali**

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, ma tuttavia assente di pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touchscreen del dispositivo. Il sistema di aggancio al letto seppur presente, è basilico. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura, assieme alla sacca per la disinfezione. Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

**Punto 4** Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore. Facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura però, pur essendo multicolor e touchscreen, non si presenta di ampie dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

**Punto 5** Le medicazioni in schiuma si presentano in confezione singola ma assenti di doppio sacchetto contenitore (solo sacchetto esterno). La medicazione in garza si presenta con ulteriore sacchetto contenitore la garza in rotolo. La confezione presenta lotto e data di scadenza con contenuto ben visibile dall'esterno, in quanto la busta è trasparente; l'etichettatura è ben visibile. Esternamente comunque appare ben descritto il tipo di medicazione e il contenuto della busta. La busta contiene: pellicola adesiva con serigrafie che possono aiutare l'operatore nell'applicazione e la cui applicazione appare maneggevole e semplice; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; è presente inoltre righello flessibile per la misurazione della lesione e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione. Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta idoneo, con chiare indicazioni per l'applicazione da parte dell'operatore. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. L'attacco del tubo al sistema di canister è rapido e a baionetta. Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**Punto 7** La medicazione è fornita in ampia gamma di dimensioni e forme, personalizzabile ritagliandola a seconda della necessità sia per dimensione che per spessore. (Numerosi gli accessori presentati a parte come, ad esempio, confezioni contenenti le sole pellicole adesive, o il solo sistema di fissaggio del tubo di aspirazione alla medicazione.) Per tali motivi si assegnano punti **15/15**

**Punto 8** Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando touchscreen multicolor anche se di non ampie dimensioni; le medicazioni sono varie e facilmente applicabili. Il software appare di facile comprensione sia per i messaggi che per il codice colore, che aiuta l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Per tali motivi si assegnano punti **4/5**

**TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza tecnica (Punto 1) 58/70**

Ditta Lohmann & Rauscher

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, con pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. Il sistema di aggancio al letto seppur presente, è basico. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura, assieme ai contenitori per il serbatoio di aspirazione (grande e piccolo). La presenza pellicola protettiva la finestra di accesso al touchscreen ne consente una maggiore igiene. Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

**Punto 4** Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore, è inoltre presente led che si illumina di diverso colore a seconda del buono e cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Gli allarmi risultano facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo di allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura si presenta di ampie dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**Punto 5** Le medicazioni si presentano in confezione singola con doppio sacchetto contenitore (sacchetto esterno non sterile e interno sterile). La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente comunque appare ben descritto il tipo di medicazione e il contenuto della busta. La busta contiene: pellicola adesiva senza serigrafie che possano aiutare l'operatore nell'applicazione che appare discretamente maneggevole; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione. Per tali motivi si assegnano punti **3/5**

**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, il meccanismo di fissaggio al serbatoio di aspirazione è a pressione diretta e a blocco. Tuttavia il meccanismo del sistema di inserimento del tubo di aspirazione e al serbatoio di drenaggio appare fragile per la presenza di parti in plastica facilmente usurabili, rendendo quindi il sistema stesso poco pratico. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti **4/10**

**Punto 7** La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta (3 misure), appena sufficiente; le dimensioni, seppur conformabili, sono standard. Le pellicole adesive si presentano assenti di serigrafie per l'operatore e di dimensioni ridotte. Solo la medicazione in garza presenta rotolo adesivo ritagliabile. Per tali motivi si assegnano punti **8/15**

**Punto 8** Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando con touchscreen multicolor e di ampie dimensioni. Il software appare di facile comprensione sia per la sequenza dei colori che per i messaggi che aiutano l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

**TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza tecnica (Punto 1) 45/70**

The image shows four handwritten signatures or initials in black ink. From left to right: a large, stylized signature; the initials 'BR'; the initials 'RC'; and a signature that appears to be 'S'.

**Ditta Sanacilia**

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria è di 24 ore, ma deve essere verificato se anche quando in uso. Per tali motivi si assegnano punti **8/10**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare piuttosto ingombrante, completa di borsetta pluriuso in materiale scadente e non idonea a contenere il serbatoio di più grandi dimensioni. Non è presente valigetta contenitore e la cavetteria viene fornita a parte in sacchetto di plastica, così come il dispositivo stesso. Assente il sistema di fissaggio e aggancio al letto. Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

**Punto 4** L'allarme è acustico e con messaggio su schermo che però si presenta monocore. Assente un codice colore che faciliti la comprensione dello stesso. Lo schermo non è touch screen per la gestione degli allarmi. Durante la prova la segnalazione di perdita d'aria si presenta solo dopo parecchi minuti. Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

**Punto 5** Le medicazioni si presentano in confezione singola con doppio sacchetto contenitore (sacchetto esterno non sterile e interno sterile) solo per quelle in garza. Sulla busta principale sono presenti lotto e data di scadenza, la descrizione del contenuto è assolutamente sommaria. Per tali motivi si assegnano punti **2/5**

**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, e privo di serigrafia che possa aiutare l'operatore nella sua applicazione, che comunque si presenta poco maneggevole e di non facile posizionamento. Il meccanismo di collegamento del tubo di drenaggio al sistema di aspirazione è a vite. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti **4/10**

**Punto 7** La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta (3 misure), le dimensioni, seppur conformabili, sono standard. Le pellicole adesive si presentano idonee con serigrafie che indicano all'operatore la corretta sequenza di applicazione. I canister sono dispostabili e graduati, ma i più grandi non solo utilizzabili con la borsa fornita per il trasporto. La medicazione in garza si presenta a tramatura larga, in pezzi e non a rotolo e di materiale appena accettabile. Per tali motivi si assegnano punti **6/15**

**Punto 8** Nel complesso il sistema si presenta poco maneggevole e poco pratico non presentando touchscreen ed essendo monocore. Il software appare poco chiaro e il sistema di serbatoio (canister) non è sempre utilizzabile con la borsa in dotazione. Per tali motivi si assegnano punti **2/10**

**TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza (Punto 1) 28/70**

La Valutazione ha dimostrato 4 parametri pienamente insufficienti, anche in mancanza della valutazione del punto 1 in ogni caso la ditta non raggiunge il punteggio minimo stabilito nei documenti di gara (42 punti).



**Ditta Smith & Nephew**

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti.  
Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, con pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. La borsa fornita in dotazione tuttavia non è idonea a contenere il canister di dimensioni maggiori. Il sistema di aggancio al letto è molto valido. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura. La presenza pellicola protettiva la finestra di accesso al touchscreen ne consente una maggiore igiene.  
Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

**Punto 4** Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore. Gli allarmi risultano facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura si presenta di ampie dimensioni, touchscreen, multicolor.  
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**Punto 5** Le medicazioni si presentano in confezione singola e unica busta. La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente è presente la descrizione del contenuto. La busta contiene: pellicola adesiva con serigrafie che possono aiutare l'operatore nell'applicazione che appare maneggevole; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione.  
Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta idoneo, il meccanismo di collegamento tra tubo di drenaggio e serbatoio appare a pressione e completato da ulteriore meccanismo di sicurezza a incastro. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Non sono tuttavia presenti serigrafie per l'operatore.  
Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

**Punto 7** La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta varia ma comunque ridotta. Le medicazioni appaiono tuttavia conformabili. Le pellicole adesive sono numerose, ma presentano serigrafie per l'operatore appena sufficienti. La medicazione in garza si presenta in rotolo adesivo separato. (Numerosi gli accessori)  
Per tali motivi si assegnano punti **10/15**

**Punto 8** Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando un touchscreen multicolor e di ampie dimensioni. Il software appare di facile comprensione sia per la sequenza dei colori che per i messaggi che aiutano l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Tuttavia la borsa in dotazione non risulta essere idonea a contenere il canister di maggiori dimensioni.  
Per tali motivi si assegnano punti **4/5**

**TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza tecnica (Punto 1) 53/70**

**Ditta Zuccato HC**

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria è di 24 ore, ma deve essere verificato se anche quando in uso. Per tali motivi si assegnano punti **8/10**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare leggermente ingombrante. Non è presente valigetta contenitore e la cavetteria viene fornita a parte. Non è presente un sistema di aggancio aletto specifico. Per tali motivi si assegnano punti **5/10**

**Punto 4** Lo schermo si presenta monocolor e di dimensioni estremamente ridotte e non adeguate per la visualizzazione e l'interpretazione degli allarmi che risultano quindi difficilmente visibili e interpretabili. E' assente un codice colore. Per tali motivi si assegnano punti **2/10**

**Punto 5** Le medicazioni si presentano in doppia busta. Sulla busta principale sono presenti lotto e data di scadenza, la descrizione del contenuto è assolutamente sommaria. Assenti le serigrafie per l'operatore. E' tuttavia presente righello per misurare la lesione. Per tali motivi si assegnano punti **3/5**

**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, e privo di serigrafia che possa aiutare l'operatore nella sua applicazione, che comunque si presenta discretamente maneggevole. Il meccanismo di collegamento del tubo di drenaggio al sistema di aspirazione è a baionetta. Il sistema di serbatoio (canister) appare non adeguato presentando blocco a vite sull'apparecchiatura. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

**Punto 7** La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta, così come le dimensioni delle pellicole adesive che sono prive di serigrafie. La spugna di poliuretano appare poco malleabile e poco maneggevole. Per tali motivi si assegnano punti **4/15**

**Punto 8** Nel complesso il sistema si presenta poco maneggevole e poco pratico non presentando touchscreen ed essendo monocolor. Il software appare poco chiaro; il sistema di serbatoio (canister) appare non adeguato presentando sistema di aggancio all'apparecchiatura con blocco a vite. Per tali motivi si assegnano punti **2/10**

**TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza tecnica (Punto 1) 30/70**

Anche in mancanza della valutazione del punto 1 in ogni caso la ditta non raggiunge il punteggio minimo stabilito nei documenti di gara (42 punti).

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, the letters 'AR', and several other initials.

## **Lotto 2: Argento.**

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione di ogni Ditta e all'assegnazione dei punteggi.

### **Ditta Waldner Technologie Medicali**

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, ma tuttavia assente di pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. Il sistema di aggancio al letto seppur presente, è basilico. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura, assieme alla sacca per la disinfezione. Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

**Punto 4** Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore. Facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura però, pur essendo multicolor e touch screen, non si presenta di ampie dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

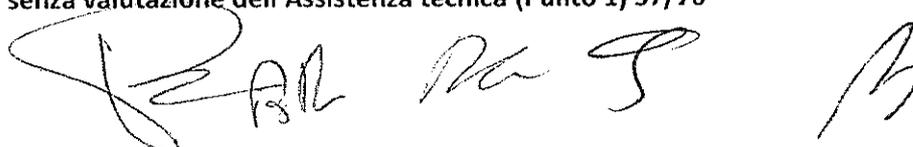
**Punto 5** Le medicazioni in schiuma si presentano in confezione singola ma assenti di doppio sacchetto contenitore (solo sacchetto esterno). La confezione presenta lotto e data di scadenza con contenuto ben visibile dall'esterno, in quanto la busta è trasparente; l'etichettatura è ben visibile. Esternamente comunque appare ben descritto il tipo di medicazione e il contenuto della busta. La busta contiene: pellicola adesiva con serigrafie che possono aiutare l'operatore nell'applicazione e la cui applicazione appare maneggevole e semplice; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; è presente inoltre righello flessibile per la misurazione della lesione e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione. Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta idoneo, con chiare indicazioni per l'applicazione da parte dell'operatore. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. L'attacco del tubo al sistema di canister è rapido e a baionetta. Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**Punto 7** La medicazione è fornita in ampia gamma di dimensioni e forme, personalizzabile ritagliandola a seconda della necessità sia per dimensione che per spessore. L'argento richiesto appare contenuto all'interno della schiuma stessa, caratteristica questa che ne comporta la rimozione ogni qual volta la medicazione esterna, come ad esempio la pellicola adesiva o la schiuma, debba essere rinnovata. (Numerosi gli accessori presentati a parte come, ad esempio, confezioni contenenti le sole pellicole adesive, o il solo sistema di fissaggio del tubo di aspirazione alla medicazione.) Per tali motivi si assegnano punti **14/15**

**Punto 8** Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando touchscreen multicolor anche se di **non** ampie dimensioni; le medicazioni sono varie e facilmente applicabili. Il software appare di facile comprensione sia per i messaggi che per il codice colore, che aiuta l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Per tali motivi si assegnano punti **4/5**

**TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza tecnica (Punto 1) 57/70**



**Ditta Smith and Nephew**

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti.  
Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, con pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. La borsa fornita in dotazione tuttavia non è idonea a contenere il canister di dimensioni maggiori. Il sistema di aggancio al letto è molto valido. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura. La presenza pellicola protettiva la finestra di accesso al touchscreen ne consente una maggiore igiene.  
Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

**Punto 4** Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore. Gli allarmi risultano facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura si presenta di ampie dimensioni, touchscreen, multicolor.  
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**Punto 5** Le medicazioni si presentano in confezione singola e unica busta. La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente è presente la descrizione del contenuto. La busta contiene: pellicola adesiva con serigrafie che possono aiutare l'operatore nell'applicazione che appare maneggevole; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione.  
Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta idoneo, il meccanismo di collegamento tra tubo di drenaggio e serbatoio appare a pressione e completato da ulteriore meccanismo di sicurezza a incastro. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Non sono tuttavia presenti serigrafie per l'operatore.  
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**Punto 7** La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta varia ma comunque ridotta. Le medicazioni appaiono tuttavia conformabili. Le pellicole adesive sono numerose, ma presentano serigrafie per l'operatore appena sufficienti. L'argento è contenuto in una medicazione a parte (Acticoat) che viene posizionata al di sotto della schiuma in poliuretano consentendo la sua permanenza in sede, anche qualora sia necessario il cambio di medicazione esterna intesa come pellicola adesiva e/o schiuma di poliuretano. (Numerosi gli accessori).  
Per tali motivi si assegnano punti **12/15**

**Punto 8** Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando un touchscreen multicolor e di ampie dimensioni. Il software appare di facile comprensione sia per la sequenza dei colori che per i messaggi che aiutano l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Tuttavia la borsa in dotazione non risulta essere idonea a contenere il canister di maggiori dimensioni..  
Per tali motivi si assegnano punti **4/5**

**TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza tecnica (Punto 1) 56/70**



### **Lotto 3: Instillazione**

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione della Ditta Sanacilia.

La Ditta Waldner Tecnologie Medicali **NON** rispetta i requisiti minimi di durata della batteria e pertanto, nonostante presenti apparecchiatura valida, maneggevole e ampia gamma di medicazioni viene esclusa.

#### **Ditta Sanacilia**

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria è di 24 ore, ma deve essere verificato se anche quando in uso. Per tali motivi si assegnano punti **8/10**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare piuttosto ingombrante, completa di borsetta pluriuso in materiale scadente e non idonea a contenere il serbatoio di più grandi dimensioni. Non è presente valigetta contenitore e la cavetteria viene fornita a parte in sacchetto di plastica, così come il dispositivo stesso. Assente il sistema di fissaggio e aggancio al letto.

Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

**Punto 4** L'allarme è acustico e con messaggio su schermo che però si presenta monocore. Assente un codice colore che faciliti la comprensione dello stesso. Lo schermo non è touchscreen per la gestione degli allarmi. Durante la prova la segnalazione di perdita d'aria si presenta solo dopo parecchi minuti.

Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

**Punto 5** Le medicazioni si presentano in confezione singola con doppio sacchetto contenitore (sacchetto esterno non sterile e interno sterile) solo per quelle in garza. Sulla busta principale sono presenti lotto e data di scadenza, la descrizione del contenuto è assolutamente sommaria. Il sistema per instillazione si presenta a parte in ulteriore confezione.

Per tali motivi si assegnano punti **2/5**

**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, e privo di serigrafia che possa aiutare l'operatore nella sua applicazione, che comunque si presenta poco maneggevole e di non facile posizionamento il meccanismo di collegamento del tubo di drenaggio al sistema di aspirazione è a vite. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking.

Per tali motivi si assegnano punti **4/10**

**Punto 7** La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta (3 misure), appena sufficiente, le dimensioni, seppur conformabili, sono standard. Le pellicole adesive si presentano idonee con serigrafie che indicano all'operatore la corretta sequenza di applicazione. I canister sono disposable e graduati, ma i più grandi non solo utilizzabili con la borsa fornita per il trasporto. La medicazione in garza si presenta a tramatura larga, in pezzi e non a rotolo e di materiale appena accettabile. Il sistema per instillazione consta di un semplice sistema a caduta che viene applicato come secondo pad sulla medicazione e come tale non risulta idoneo per il trattamento di lesioni di ridotte dimensioni.

Per tali motivi si assegnano punti **5/15**

**Punto 8** Nel complesso il sistema si presenta poco maneggevole e poco pratico non presentando touchscreen ed essendo monocore. Il software appare poco chiaro e il sistema di serbatoio (canister) non è sempre utilizzabile con la borsa in dotazione.

Per tali motivi si assegnano punti **2/10**

**TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza tecnica (Punto 1) 27/70.**

La Valutazione ha dimostrato 4 parametri pienamente insufficienti, la ditta non raggiunge il punteggio minimo stabilito nei documenti di gara anche nel caso nel criterio "Assistenza tecnica" dovesse essere assegnato il punteggio massimo (5 punti)



#### Lotto 4: Addome Aperto

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione della Ditta Lohmann & Rauscher.

La Ditta Waldner **NON** rispetta i requisiti minimi di durata della batteria e pertanto, nonostante presenti apparecchiatura valida, maneggevole e medicazione assolutamente idonea al contatto con i visceri, non viene ammessa al prosieguo della gara.

La Ditta Zuccato **NON** rispetta i requisiti minimi: presenta Canister NON sterili e materiale NON idoneo al contatto con i visceri, in quanto manca in IFU la specifica di possibile utilizzo a contatto con gli stessi, e pertanto non viene ammessa al prosieguo della gara.

#### Ditta Lohmann

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, con pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. Il sistema di aggancio al letto seppur presente, è basico. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura, assieme ai contenitori per il serbatoio di aspirazione (grande e piccolo). La presenza pellicola protettiva la finestra di accesso al touchscreen ne consente una maggiore igiene. Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

**Punto 4** Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore, è inoltre presente led che si illumina di diverso colore a seconda del buono e cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Gli allarmi risultano facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura si presenta di ampie dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**Punto 5** Le medicazioni si presentano in confezione singola. La confezione presenta lotto e data di scadenza. L'etichettatura è ben visibile. Esternamente comunque appare ben descritto il tipo di medicazione e il contenuto della busta. La busta contiene: pellicola adesiva senza serigrafie che possano aiutare l'operatore nell'applicazione che appare discretamente maneggevole; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione. E' presente involucro per "impacchettare" la spugna e applicarla a contatto con visceri. Per tali motivi si assegnano punti **3/5**

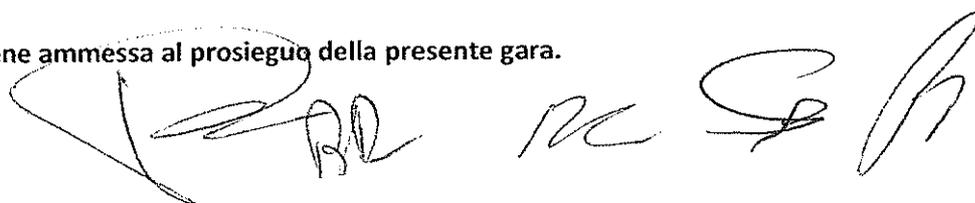
**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, il meccanismo di fissaggio al serbatoio di aspirazione è a pressione diretta e a blocco. Tuttavia il meccanismo del sistema di inserimento del tubo di aspirazione e al serbatoio di drenaggio appare fragile per la presenza di parti in plastica facilmente rompibili, rendendo quindi il sistema stesso poco idoneo alla sua funzione. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti **4/10**

**Punto 7** La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta. 1 sola misura non sufficiente. Le pellicole adesive si presentano assenti di serigrafie per l'operatore e di dimensioni ridotte. E' presente involucro per "impacchettare" la spugna e applicarla a contatto con visceri. Tale involucro si presenta assolutamente molto fragile alla minima trazione, e come tale assolutamente non adeguato al posizionamento all'interno dell'addome. La sua fragilità infatti comporta un elevato rischio di permanenza del materiale in sede e di contatto diretto della schiuma di poliuretano con i visceri, evenienza questa assolutamente dannosa.

**Per tali motivi il materiale si ritiene NON IDONEO e NON rispondente ai requisiti minimi del Lotto in oggetto**

**Punto 8** Non valutabile

La Ditta non viene ammessa al prosieguo della presente gara.



### **Lotto 5: Monouso**

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione delle varie Ditte.

#### **Ditta Convatec**

**Punto 2** L'apparecchiatura è fornita con 6 batterie ministilo monouso, di cui 3 di ricambio.  
Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso molto contenuto. Non è tuttavia presente sistema di trasporto dedicato.  
Per tali motivi si assegnano punti **15/15**

**Punto 4** La letteratura presentata consta di case report e case series. E' presente un solo studio randomizzato prospettico. Nel complesso quindi è da ritenere di basso Level of Evidence.  
Per tali motivi si assegnano punti **5/15**

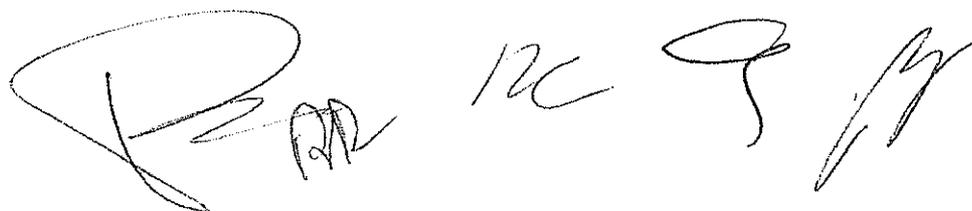
**Punto 5** Le medicazioni si presentano in confezione singola e unica busta. La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente è presente comunque la descrizione del contenuto che appare comunque ben visibile essendo la confezione costituita di parte trasparente.  
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**Punto 6** La gamma e la tipologia delle medicazioni si presenta molto varia (7 misure), e di facile applicazione grazie alle serigrafie presenti. La medicazione è applicabile su ferita chiusa.  
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**Punto 7** Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico con allarmi ben visibili, il software si presenta di facile interpretazione  
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza tecnica (Punto 1) 55/70**

AP

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'P. R.'. To its right are several smaller initials, including 'RC', 'G', and 'JG'.

**Ditta Smith and Nephew**

**Punto 2** L'apparecchiatura è fornita con batterie stilo monouso senza ricambio. La durata comunque è sufficiente come da requisiti.

Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso molto contenuto. E' presente sistema di trasporto.

Per tali motivi si assegnano punti **15/15**

**Punto 4** La letteratura presentata è costituita da studi randomizzato, di cui uno prospettico e uno controllato e da una metaanalisi. Nel complesso è quindi da ritenere Level of Evidence medio alto.

Per tali motivi si assegnano punti **12/15**

**Punto 5** Le medicazioni si presentano in confezione singola e unica busta. La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente è presente comunque la descrizione del contenuto che appare comunque ben visibile essendo la confezione costituita di parte trasparente.

Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

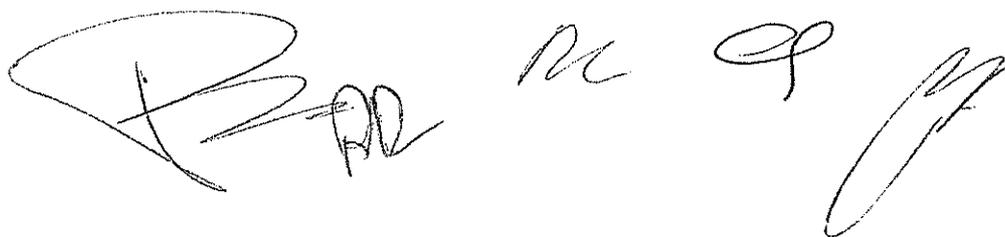
**Punto 6** La gamma e la tipologia delle medicazioni si presenta molto varia (10 misure), e di facile applicazione grazie alle serigrafie presenti. La medicazione è applicabile su ferita chiusa.

Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**Punto 7** Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico con allarmi ben visibili, il software si presenta di facile interpretazione

Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza (Punto 1) 62/70**

The image shows four handwritten signatures or initials in black ink. From left to right: a large, stylized signature that appears to be 'AR'; a smaller signature that looks like 'AL'; a signature that looks like 'S'; and a large, stylized signature that looks like 'M'.

## Ditta Waldner

**Punto 2** L'apparecchiatura non prevede batterie essendo meccanica a depressione, come tale non è possibile prevedere la durata della terapia e la sua autonomia, dipendendo la stessa dalla quantità di essudato aspirato nel canister portatile e, di conseguenza, la prestazione risulta essere inferiore e non uniforme rispetto a quelle a batteria.

Per tali motivi si assegnano punti **2/5**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso molto contenuto, anche se lo stantuffi opresente per creare la depressione risulta essere sporgente e di facile rottura. Inoltre per mantenere la depressione richiesta è necessario ripetere l'operazione con stantuffo più volte. E' presente sistema di trasporto.

Per tali motivi si assegnano punti **10/15**

**Punto 4** La letteratura presentata è costituita da 2 studi randomizzati, un caso controllo, una analisi di letteratura (ma non sistematica) e un lavoro sperimentale. Nel complesso è quindi da ritenere Level of Evidence medio-basso.

Per tali motivi si assegnano punti **6/15**

**Punto 5** Le medicazioni si presentano in più confezioni contenute in una scatola che riporta lotto e scadenza.

Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

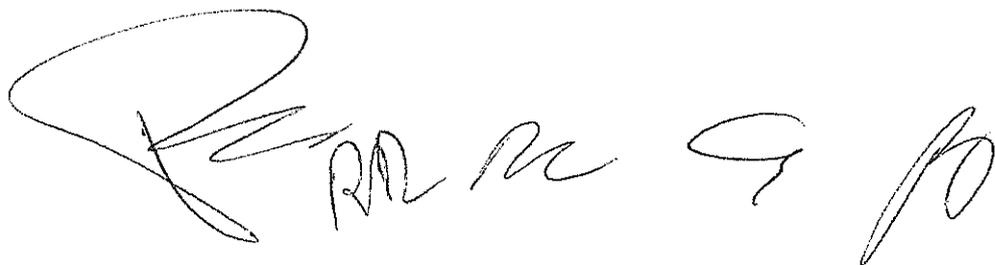
**Punto 6** La gamma e la tipologia delle medicazioni si presenta molto ridotta e applicabile solo su lesione aperta. Il pad adesivo in idrocolloide costituisce parte integrante della medicazione, e come tale non è conformabile.

Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

**Punto 7** Nel complesso il sistema si presenta insufficientemente maneggevole e poco pratico, non essendo possibile prevederne la durata. L'impossibilità inoltre di conformare il pad adesivo ne limita fortemente il nostro utilizzo.

Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

**Preso atto delle insufficienze ottenute nella valutazione, 34 punti, la Ditta non raggiunge il punteggio minimo stabilito (42 punti).**

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'RA M G P'.



Regione del Veneto  
**AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA**  
[www.aopd.veneto.it](http://www.aopd.veneto.it) – P.E.C.: [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it)  
via Nicolò Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA  
c.f./p.iva 00349040287

**VERBALE N. 3 del 7 settembre 2020**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE COMPLESSE PER L'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA PER IL PERIODO DI 48 MESI (COMPRENSIVO DELL'OPZIONE DI RINNOVO PER 24 MESI) – ID GARA 18P065**

L'anno duemilaventi, il giorno 7 del mese di settembre alle ore 15,00 presso il Centro Gallucci - Biblioteca "Pier Giuseppe Cevese" dell'Azienda Ospedale – Università Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura aperta telematica mediante piattaforma Sintel, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" per l'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 31/01/2020.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 950 del 10/07/2020 è così composta:

**PRESIDENTE:** Dott. Roberto Bianco – U.O.C. Cardiocirurgia

**COMPONENTI:** Dott. ssa Carlotta Scarpa – U.O.C. Chirurgia Plastica

Dott. Alex Pontini – U.O.C. Grandi Ustionati

Dott. Enzo Mammanno – S.C. Chirurgia OSA

P.I. Roberto Bacchin – U.O.S. Ingegneria Clinica

**PREMESSO**

- che l'aggiudicazione della fornitura succitata verrà effettuata per lotto completo ed indivisibile (le ditte dovranno offrire tutti i riferimenti facenti parte del lotto);

- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio stabilito all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio qualità + punteggio prezzo), determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità punteggio massimo punti 70
- prezzo punteggio massimo punti 30
- che a seguito dell'assegnazione dei punteggi, come indicato al punto precedente, verranno individuate, lotto per lotto, le ditte che avendo proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa risultano prime in graduatoria;
- che non verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le ditte che otterranno un punteggio di qualità inferiore a 42 punti su 70 punti.

#### IL PRESIDENTE

- constatata la presenza di tutti componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'elaborazione delle domande da inoltrare alle ditte al fine di ottenere i dati necessari per l'assegnazione del punteggio del criterio 1

#### LA COMMISSIONE

procede all'elaborazione delle domande da inoltrare alle ditte concorrenti, n. 27 domande che vengono allegate al presente verbale e ne fanno parte integrante e sostanziale.

Le risposte da parte delle ditte dovranno pervenire entro martedì 15 settembre 2020 e, nel caso in cui non fossero esaustive al fine dell'assegnazione del punteggio del criterio 1, viene deciso di convocare le ditte a un dialogo tecnico per martedì 22 settembre 2020.

I lavori si concludono alle ore 16,45.


Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dott. Roberto Bianco	
Dott.ssa Carlotta Scarpa	
Dott. Alex Pontini	

PR2

Dott. Enzo Mammamo	
P.I. Roberto Bacchin	

Verbalizzante: Dott.ssa Carlotta Scarpa



# Domande Gara ID18P058

## ASSISTENZA

1. Qual è la Vostra Organizzazione sul Territorio?
2. C'è la presenza di un tecnico dedicato per Padova?
3. Qual è la tempistica di risposta dell'operatore?
4. Qual è la tempistica di distribuzione delle nuove macchine?
5. Qual è la tempistica ritiro e sanificazione delle apparecchiature utilizzate?
6. Fino a quante apparecchiature potete mantenere contemporaneamente disponibili?

## APPARECCHIATURA


7. La durata della batteria dichiarata riguarda la batteria durante l'uso dell'apparecchiatura o durante lo stand by?
8. Sul monitor è presente un sistema grafico che indichi il livello della batteria e che sia completo di interpretazione grafica della durata?
9. Il monitor presente sull'apparecchiatura è touchscreen o no?
10. Il monitor presente sull'apparecchiatura è multicolor o no?
11. Il monitor rimane visibile anche qualora l'apparecchiatura sia posizionata all'interno della borsa da trasporto?
12. Una volta inserita l'apparecchiatura nella borsa di trasporto, il monitor è protetto da un sistema di pellicola trasparente oppure no?
13. La borsa per il trasporto è lavabile?
14. La borsa per il trasporto consente l'utilizzo di canister di diverse dimensioni o è necessaria una borsa più grande per i canister di maggiori dimensioni?
15. L'aggancio al letto è costituito dalla borsa o vi è un sistema di aggancio separato?
16. Gli allarmi sono acustici, con messaggio, con codice colore, con descrizione della causa e possibile risoluzione della stessa?
17. Quanto tempo impiega l'apparecchiatura per creare la depressione?
18. E' presente il seal check?
19. L'apparecchiatura è impermeabile?
20. L'apparecchiatura può essere disinfettata e se sì con quali detergenti?
21. I detergenti utilizzati per la sanificazione sono quelli in dotazione all'Azienda Ospedale – Università Padova o sono specifici per questo procedimento?



## MEDICAZIONI

22. Le confezioni delle medicazioni contengono quanti steridrape?
23. Gli steridrape forniti nella confezione sono sufficienti e di idonee dimensioni per essere utilizzati con le diverse misure della spugna in schiuma di poliuretano, o è necessario aprire ulteriori confezioni di steridrape per le schiume a maggiore dimensione?
24. Ci sono confezioni di soli steridrape a parte?
25. Ci sono confezioni contenenti a parte il sistema di fissaggio alla medicazione?
26. Sono presenti confezioni contenenti accessori quali ad esempio il raccordo ad Y o il gel adesivo? *(Tale domanda non è oggetto della quantificazione del punteggio)*
27. Le medicazioni sono conformabili?

The image shows four distinct handwritten marks in black ink. From left to right: a large, stylized signature that appears to be 'P. R.'; a set of initials 'RR'; a cursive signature that looks like 'na'; and a circular mark containing the number '5'.



Regione del Veneto  
**AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA**  
[www.aopd.veneto.it](http://www.aopd.veneto.it) – P.E.C.: [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it)  
via Nicolò Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA  
c.f./p.iva 00349040287

**VERBALE N. 4 del 22 settembre 2020**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE COMPLESSE PER L'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA PER IL PERIODO DI 48 MESI (COMPRENSIVO DELL'OPZIONE DI RINNOVO PER 24 MESI) – ID GARA 18P065**

L'anno duemilaventiti, il giorno 22 del mese di settembre alle ore 15,00 presso il Centro Gallucci - Biblioteca "Pier Giuseppe Cevese" dell'Azienda Ospedale – Università Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura aperta telematica mediante piattaforma Sintel, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" per l'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 31/01/2020.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 950 del 10/07/2020 è così composta:

**PRESIDENTE:** Dott. Roberto Bianco – U.O.C. Cardiocirurgia

**COMPONENTI:** Dott.ssa Carlotta Scarpa – U.O.C. Chirurgia Plastica  
Dott. Alex Pontini – U.O.C. Grandi Ustionati  
Dott. Enzo Mammano – S.C. Chirurgia OSA  
P.I. Roberto Bacchin – U.O.S. Ingegneria Clinica


**PREMESSO**

- che l'aggiudicazione della fornitura succitata verrà effettuata per lotto completo ed indivisibile (le ditte dovranno offrire tutti i riferimenti facenti parte del lotto);



<b>MATERIALE DI CONSUMO</b>		-	
5	Confezionamento (inteso come facilità di apertura del confezionamento primario, chiarezza e facile comprensibilità dei dati relativi al dispositivo contenuto, lotto, scadenza, ref, ecc.)	-	5
6	Sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione	-	10
7	Gamma, misure e caratteristiche tecniche delle medicazioni	-	15
<b>APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO</b>			
8	Maneggevolezza e praticità d'uso del sistema	-	5
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>70</b>

n.	<b>Criteria di valutazione della qualità LOTTO 5</b>	<b>Punteggio minimo pena esclusione</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>APPARECCHIATURE</b>			
1	Assistenza tecnica (organizzazione del servizio, tecnici dedicati su Padova, tempi di risposta massima per intervento tecnico, risoluzione del guasto, da specificare, ed intervento tempestivo in caso di guasto) fornire autodichiarazione	-	5
2	Durata ed autonomia della batteria	-	5
3	Ingombro e sistema di trasporto	-	15
4	Numerosità e tipologia degli studi clinici a supporto dei prodotti presentati	-	15
<b>MATERIALE DI CONSUMO</b>		-	


5	Confezionamento (inteso come facilità di apertura del confezionamento primario, chiarezza e facile comprensibilità dei dati relativi al dispositivo contenuto, lotto, scadenza, ref, ecc.)	-	10
6	Gamma, misure e caratteristiche tecniche delle medicazioni	-	10
<b>APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO</b>			
7	Maneggevolezza e praticità d'uso del sistema	-	10
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>70</b>

Non verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le ditte che totalizzeranno un punteggio di qualità inferiore al punteggio minimo di 42 punti.

Le risposte inviate dalle ditte relativamente al criterio 1: "Assistenza tecnica (organizzazione del servizio, tecnici dedicati su Padova, tempi di risposta massima per intervento tecnico, risoluzione del guasto, da specificare, ed intervento tempestivo in caso di guasto) fornire autodichiarazione" risultano complete e esaustive per poter procedere all'assegnazione del punteggio.


Gli allegati riportanti i punteggi con relative motivazioni assegnati alle ditte concorrenti vengono allegati al presente verbale e ne fanno parte integrante e sostanziale (n. 12 Allegati), e vengono riassunti nella tabella sottostante:

Lotto	MEDI-H-ART	Zuccato HC	Smith&Nephew	Sanacilia	Waldner	Lohmann	Convatec
1	NO requisiti minimi	NO punteggio minimo	58 punti	NO punteggio minimo	63 punti	50 punti	//////////
2	NO requisiti minimi	//////////	61 punti	//////////	62 punti	//////////	//////////
3	//////////	//////////	//////////	NO punteggio minimo	NO requisiti minimi	//////////	//////////
4	//////////	NO requisiti minimi	//////////	//////////	NO requisiti minimi	NO requisiti minimi	//////////
5	//////////	//////////	67 punti	//////////	NO punteggio minimo	//////////	60 punti

I lavori si concludono alle ore 16,30.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:



Dott. Roberto Bianco	
Dott.ssa Carlotta Scarpa	
Dott. Alex Pontini	
Dott. Enzo Marmaro	
P.I. Roberto Bacchin	

Verbalizzante: Rag. Fabio Moro

### **Lotto 1: Terapia a pressione negativa.**

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione di ogni Ditta e all'assegnazione dei punteggi

#### **Ditta Waldner Tecnologie Medicali**

**Punto 1** Si assegnano punti **5/5**

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, ma tuttavia assente di pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touchscreen del dispositivo. Il sistema di aggancio al letto seppur presente, è basilico. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura, assieme alla sacca per la disinfezione. Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

**Punto 4** Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore. Facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura però, pur essendo multicolor e touchscreen, non si presenta di ampie dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

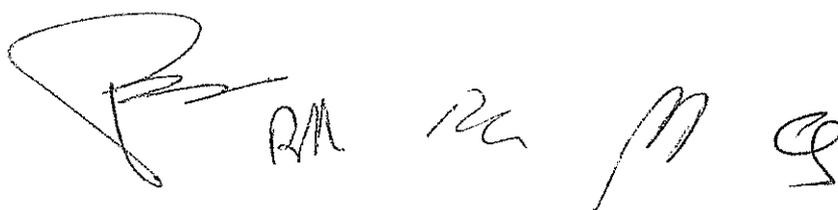
**Punto 5** Le medicazioni in schiuma si presentano in confezione singola ma assenti di doppio sacchetto contenitore (solo sacchetto esterno). La medicazione in garza si presenta con ulteriore sacchetto contenitore la garza in rotolo. La confezione presenta lotto e data di scadenza con contenuto ben visibile dall'esterno, in quanto la busta è trasparente; l'etichettatura è ben visibile. Esternamente comunque appare ben descritto il tipo di medicazione e il contenuto della busta. La busta contiene: pellicola adesiva con serigrafie che possono aiutare l'operatore nell'applicazione e la cui applicazione appare maneggevole e semplice; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; è presente inoltre righello flessibile per la misurazione della lesione e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione. Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta idoneo, con chiare indicazioni per l'applicazione da parte dell'operatore. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. L'attacco del tubo al sistema di canister è rapido e a baionetta. Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**Punto 7** La medicazione è fornita in ampia gamma di dimensioni e forme, personalizzabile ritagliandola a seconda della necessità sia per dimensione che per spessore. (Numerosi gli accessori presentati a parte come, ad esempio, confezioni contenenti le sole pellicole adesive, o il solo sistema di fissaggio del tubo di aspirazione alla medicazione.) Per tali motivi si assegnano punti **15/15**

**Punto 8** Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando touchscreen multicolor anche se di non ampie dimensioni; le medicazioni sono varie e facilmente applicabili. Il software appare di facile comprensione sia per i messaggi che per il codice colore, che aiuta l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Per tali motivi si assegnano punti **4/5**

**TOTALE 63/70**

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, the initials 'RM', '126', 'M', and 'G'.

**Ditta Lohmann & Rauscher**

**Punto 1** Si assegnano punti 5/5

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti 6/10

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, con pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. Il sistema di aggancio al letto seppur presente, è basico. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura, assieme ai contenitori per il serbatoio di aspirazione (grande e piccolo). La presenza pellicola protettiva la finestra di accesso al touchscreen ne consente una maggiore igiene. Per tali motivi si assegnano punti 9/10

**Punto 4** Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore, è inoltre presente led che si illumina di diverso colore a seconda del buono e cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Gli allarmi risultano facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo di allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura si presenta di ampie dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti 10/10

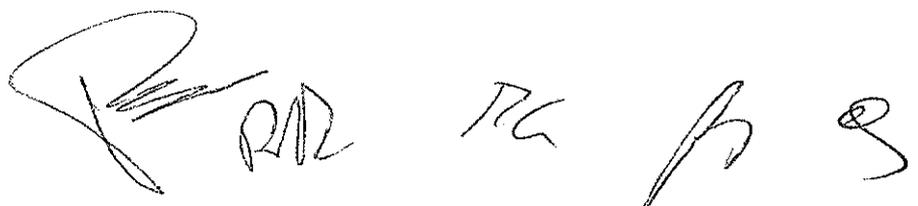
**Punto 5** Le medicazioni si presentano in confezione singola con doppio sacchetto contenitore (sacchetto esterno non sterile e interno sterile). La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente comunque appare ben descritto il tipo di medicazione e il contenuto della busta. La busta contiene: pellicola adesiva senza serigrafie che possano aiutare l'operatore nell'applicazione che appare discretamente maneggevole; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione. Per tali motivi si assegnano punti 3/5

**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, il meccanismo di fissaggio al serbatoio di aspirazione è a pressione diretta e a blocco. Tuttavia il meccanismo del sistema di inserimento del tubo di aspirazione e al serbatoio di drenaggio appare fragile per la presenza di parti in plastica facilmente usurabili, rendendo quindi il sistema stesso poco pratico. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti 4/10

**Punto 7** La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta (3 misure), appena sufficiente; le dimensioni, seppur conformabili, sono standard. Le pellicole adesive si presentano assenti di serigrafie per l'operatore e di dimensioni ridotte. Solo la medicazione in garza presenta rotolo adesivo ritagliabile. Per tali motivi si assegnano punti 8/15

**Punto 8** Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando con touchscreen multicolor e di ampie dimensioni. Il software appare di facile comprensione sia per la sequenza dei colori che per i messaggi che aiutano l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Per tali motivi si assegnano punti 5/5

**TOTALE 50/70**

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature that appears to be 'R' followed by 'R12'. To its right are the initials 'MG'. Further right is a signature that looks like 'A', and finally, a signature that looks like 'S'.

**Ditta Sanacilia**

**Punto 1** Disponibilità apparecchiature limitato (10 apparecchiature). Si assegnano punti **3/5**

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria è di 24 ore, ma deve essere verificato se anche quando in uso. Per tali motivi si assegnano punti **8/10**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare piuttosto ingombrante, completa di borsetta pluriuso in materiale scadente e non idonea a contenere il serbatoio di più grandi dimensioni. Non è presente valigetta contenitore e la cavetteria viene fornita a parte in sacchetto di plastica, così come il dispositivo stesso. Assente il sistema di fissaggio e aggancio al letto. Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

**Punto 4** L'allarme è acustico e con messaggio su schermo che però si presenta monocoloro. Assente un codice colore che faciliti la comprensione dello stesso. Lo schermo non è touch screen per la gestione degli allarmi. Durante la prova la segnalazione di perdita d'aria si presenta solo dopo parecchi minuti. Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

**Punto 5** Le medicazioni si presentano in confezione singola con doppio sacchetto contenitore (sacchetto esterno non sterile e interno sterile) solo per quelle in garza. Sulla busta principale sono presenti lotto e data di scadenza, la descrizione del contenuto è assolutamente sommaria. Per tali motivi si assegnano punti **2/5**

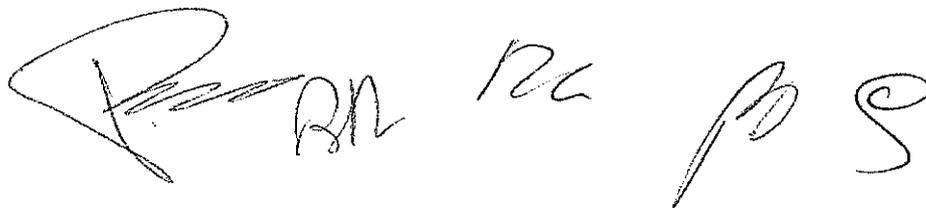
**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, e privo di serigrafia che possa aiutare l'operatore nella sua applicazione, che comunque si presenta poco maneggevole e di non facile posizionamento. Il meccanismo di collegamento del tubo di drenaggio al sistema di aspirazione è a vite. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti **4/10**

**Punto 7** La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta (3 misure), le dimensioni, seppur conformabili, sono standard. Le pellicole adesive si presentano idonee con serigrafie che indicano all'operatore la corretta sequenza di applicazione. I canister sono disposable e graduati, ma i più grandi non solo utilizzabili con la borsa fornita per il trasporto. La medicazione in garza si presenta a tramatura larga, in pezzi e non a rotolo e di materiale appena accettabile. Per tali motivi si assegnano punti **6/15**

**Punto 8** Nel complesso il sistema si presenta poco maneggevole e poco pratico non presentando touchscreen ed essendo monocoloro. Il software appare poco chiaro e il sistema di serbatoio (canister) non è sempre utilizzabile con la borsa in dotazione. Per tali motivi si assegnano punti **2/10**

**TOTALE 31/70**

La Valutazione ha dimostrato 4 parametri pienamente insufficienti, la ditta non raggiunge il punteggio minimo stabilito nei documenti di gara (42 punti).

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature that appears to be 'R...', followed by the initials 'BN'. To the right of these are the initials 'RC'. Further right is another signature that looks like 'PS', and finally, a large, stylized letter 'S'.

## Ditta Smith & Nephew

**Punto 1** Si assegnano punti 5/5

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti 6/10

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, con pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. La borsa fornita in dotazione tuttavia non è idonea a contenere il canister di dimensioni maggiori. Il sistema di aggancio al letto è molto valido. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura. La presenza pellicola protettiva la finestra di accesso al touchscreen ne consente una maggiore igiene.

Per tali motivi si assegnano punti 9/10

**Punto 4** Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore. Gli allarmi risultano facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura si presenta di ampie dimensioni, touchscreen, multicolor.

Per tali motivi si assegnano punti 10/10

**Punto 5** Le medicazioni si presentano in confezione singola e unica busta. La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente è presente la descrizione del contenuto.

La busta contiene: pellicola adesiva con serigrafie che possono aiutare l'operatore nell'applicazione che appare maneggevole; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione.

Per tali motivi si assegnano punti 5/5

**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta idoneo, il meccanismo di collegamento tra tubo di drenaggio e serbatoio appare a pressione e completato da ulteriore meccanismo di sicurezza a incastro. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Non sono tuttavia presenti serigrafie per l'operatore.

Per tali motivi si assegnano punti 9/10

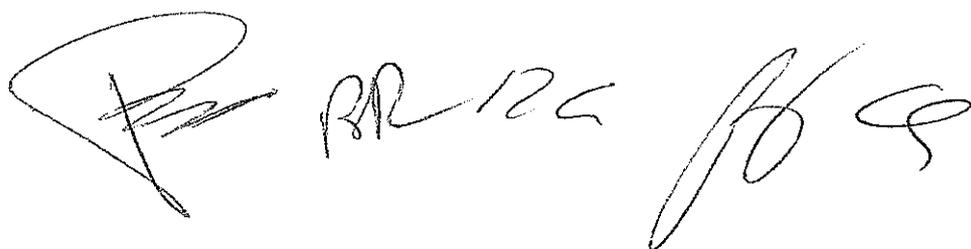
**Punto 7** La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta varia ma comunque ridotta. Le medicazioni appaiono tuttavia conformabili. Le pellicole adesive sono numerose, ma presentano serigrafie per l'operatore appena sufficienti. La medicazione in garza si presenta in rotolo adesivo separato. (Numerosi gli accessori)

Per tali motivi si assegnano punti 10/15

**Punto 8** Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando un touchscreen multicolor e di ampie dimensioni. Il software appare di facile comprensione sia per la sequenza dei colori che per i messaggi che aiutano l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Tuttavia la borsa in dotazione non risulta essere idonea a contenere il canister di maggiori dimensioni.

Per tali motivi si assegnano punti 4/5

**TOTALE 58/70**

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. The first is a large, stylized signature that appears to be 'R'. The second is 'RR 125'. The third is a signature that appears to be 'JG'.

**Ditta Zuccato HC**

**Punto 1** Disponibilità apparecchiature limitato (30 apparecchiature). Si assegnano punti **4/5**

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria è di 24 ore, ma deve essere verificato se anche quando in uso. Per tali motivi si assegnano punti **8/10**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare leggermente ingombrante. Non è presente valigetta contenitore e la cavetteria viene fornita a parte. Non è presente un sistema di aggancio aletto specifico. Per tali motivi si assegnano punti **5/10**

**Punto 4** Lo schermo si presenta monocolor e di dimensioni estremamente ridotte e non adeguate per la visualizzazione e l'interpretazione degli allarmi che risultano quindi difficilmente visibili e interpretabili. E' assente un codice colore. Per tali motivi si assegnano punti **2/10**

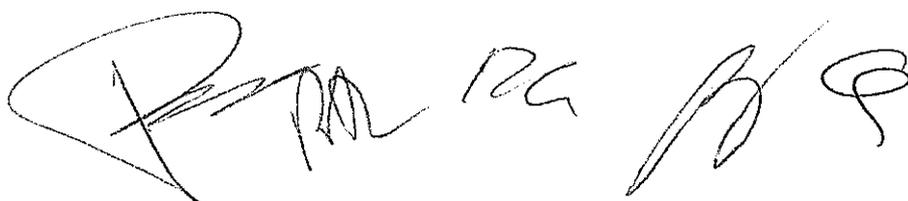
**Punto 5** Le medicazioni si presentano in doppia busta. Sulla busta principale sono presenti lotto e data di scadenza, la descrizione del contenuto è assolutamente sommaria. Assenti le serigrafie per l'operatore. E' tuttavia presente righello per misurare la lesione. Per tali motivi si assegnano punti **3/5**

**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, e privo di serigrafia che possa aiutare l'operatore nella sua applicazione, che comunque si presenta discretamente maneggevole. Il meccanismo di collegamento del tubo di drenaggio al sistema di aspirazione è a baionetta. Il sistema di serbatoio (canister) appare non adeguato presentando blocco a vite sull'apparecchiatura. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

**Punto 7** La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta, così come le dimensioni delle pellicole adesive che sono prive di serigrafie. La spugna di poliuretano appare poco malleabile e poco maneggevole. Per tali motivi si assegnano punti **4/15**

**Punto 8** Nel complesso il sistema si presenta poco maneggevole e poco pratico non presentando touchscreen ed essendo monocolor e. Il software appare poco chiaro; il sistema di serbatoio (canister) appare non adeguato presentando sistema di aggancio all'apparecchiatura con blocco a vite. Per tali motivi si assegnano punti **2/10**

**TOTALE 34/70** la ditta non raggiunge il punteggio minimo stabilito nei documenti di gara (42 punti).



## Lotto 2: Argento.

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione di ogni Ditta e all'assegnazione dei punteggi.

### Ditta Waldner Tecnologie Medicali

**Punto 1** Si assegnano punti 5/5

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti 6/10

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, ma tuttavia assente di pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. Il sistema di aggancio al letto seppur presente, è basilico. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura, assieme alla sacca per la disinfezione. Per tali motivi si assegnano punti 9/10

**Punto 4** Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore. Facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura però, pur essendo multicolor e touch screen, non si presenta di ampie dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti 9/10

**Punto 5** Le medicazioni in schiuma si presentano in confezione singola ma assenti di doppio sacchetto contenitore (solo sacchetto esterno). La confezione presenta lotto e data di scadenza con contenuto ben visibile dall'esterno, in quanto la busta è trasparente; l'etichettatura è ben visibile. Esternamente comunque appare ben descritto il tipo di medicazione e il contenuto della busta.

La busta contiene: pellicola adesiva con serigrafie che possono aiutare l'operatore nell'applicazione e la cui applicazione appare maneggevole e semplice; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; è presente inoltre righello flessibile per la misurazione della lesione e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione.

Per tali motivi si assegnano punti 5/5

**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta idoneo, con chiare indicazioni per l'applicazione da parte dell'operatore. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. L'attacco del tubo al sistema di canister è rapido e a baionetta.

Per tali motivi si assegnano punti 10/10

**Punto 7** La medicazione è fornita in ampia gamma di dimensioni e forme, personalizzabile ritagliandola a seconda della necessità sia per dimensione che per spessore. L'argento richiesto appare contenuto all'interno della schiuma stessa, caratteristica questa che ne comporta la rimozione ogni qual volta la medicazione esterna, come ad esempio la pellicola adesiva o la schiuma, debba essere rinnovata. (Numerosi gli accessori presentati a parte come, ad esempio, confezioni contenenti le sole pellicole adesive, o il solo sistema di fissaggio del tubo di aspirazione alla medicazione.)

Per tali motivi si assegnano punti 14/15

**Punto 8** Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando touchscreen multicolor anche se di **non** ampie dimensioni; le medicazioni sono varie e facilmente applicabili. Il software appare di facile comprensione sia per i messaggi che per il codice colore, che aiuta l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato.

Per tali motivi si assegnano punti 4/5

TOTALE 67/70



**Ditta Smith and Nephew**

**Punto 1** Si assegnano punti 5/5

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti 6/10

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, con pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. La borsa fornita in dotazione tuttavia non è idonea a contenere il canister di dimensioni maggiori. Il sistema di aggancio al letto è molto valido. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura. La presenza pellicola protettiva la finestra di accesso al touchscreen ne consente una maggiore igiene.

Per tali motivi si assegnano punti 9/10

**Punto 4** Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore. Gli allarmi risultano facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura si presenta di ampie dimensioni, touchscreen, multicolor.

Per tali motivi si assegnano punti 10/10

**Punto 5** Le medicazioni si presentano in confezione singola e unica busta. La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente è presente la descrizione del contenuto.

La busta contiene: pellicola adesiva con serigrafie che possono aiutare l'operatore nell'applicazione che appare maneggevole; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione.

Per tali motivi si assegnano punti 5/5

**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presentai idoneo, il meccanismo di collegamento tra tubo di drenaggio e serbatoio appare a pressione e completato da ulteriore meccanismo di sicurezza a incastro. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Non sono tuttavia presenti serigrafie per l'operatore.

Per tali motivi si assegnano punti 10/10

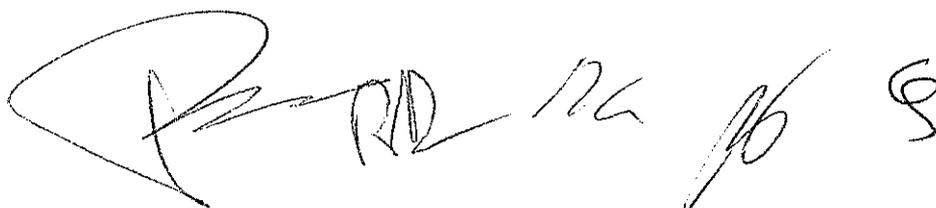
**Punto 7** La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta varia ma comunque ridotta. Le medicazioni appaiono tuttavia conformabili. Le pellicole adesive sono numerose, ma presentano serigrafie per l'operatore appena sufficienti. L'argento è contenuto in una medicazione a parte (Acticoat) che viene posizionata al di sotto della schiuma in poliuretano consentendo la sua permanenza in sede, anche qualora sia necessario il cambio di medicazione esterna intesa come pellicola adesiva e/o schiuma di poliuretano. (Numerosi gli accessori).

Per tali motivi si assegnano punti 12/15

**Punto 8** Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando un touchscreen multicolor e di ampie dimensioni. Il software appare di facile comprensione sia per la sequenza dei colori che per i messaggi che aiutano l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Tuttavia la borsa in dotazione non risulta essere idonea a contenere il canister di maggiori dimensioni..

Per tali motivi si assegnano punti 4/5

**TOTALE 61/70**



### Lotto 3: Instillazione

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione della Ditta Sanacilia.

La Ditta Waldner Tecnologie Medicali **NON** rispetta i requisiti minimi di durata della batteria e pertanto, nonostante presenti apparecchiatura valida, maneggevole e ampia gamma di medicazioni viene esclusa.

#### Ditta Sanacilia

**Punto 1** Disponibilità apparecchiature limitato (10 apparecchiature). Si assegnano punti **3/5**

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria è di 24 ore, ma deve essere verificato se anche quando in uso. Per tali motivi si assegnano punti **8/10**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare piuttosto ingombrante, completa di borsetta pluriuso in materiale scadente e non idonea a contenere il serbatoio di più grandi dimensioni. Non è presente valigetta contenitore e la cavetteria viene fornita a parte in sacchetto di plastica, così come il dispositivo stesso. Assente il sistema di fissaggio e aggancio al letto. Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

**Punto 4** L'allarme è acustico e con messaggio su schermo che però si presenta monocoloro. Assente un codice colore che faciliti la comprensione dello stesso. Lo schermo non è touchscreen per la gestione degli allarmi. Durante la prova la segnalazione di perdita d'aria si presenta solo dopo parecchi minuti. Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

**Punto 5** Le medicazioni si presentano in confezione singola con doppio sacchetto contenitore (sacchetto esterno non sterile e interno sterile) solo per quelle in garza. Sulla busta principale sono presenti lotto e data di scadenza, la descrizione del contenuto è assolutamente sommaria. Il sistema per instillazione si presenta a parte in ulteriore confezione. Per tali motivi si assegnano punti **2/5**

**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, e privo di serigrafia che possa aiutare l'operatore nella sua applicazione, che comunque si presenta poco maneggevole e di non facile posizionamento. Il meccanismo di collegamento del tubo di drenaggio al sistema di aspirazione è a vite. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti **4/10**

**Punto 7** La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta (3 misure), appena sufficiente, le dimensioni, seppur conformabili, sono standard. Le pellicole adesive si presentano idonee con serigrafie che indicano all'operatore la corretta sequenza di applicazione. I canister sono disposable e graduati, ma i più grandi non solo utilizzabili con la borsa fornita per il trasporto. La medicazione in garza si presenta a tramatura larga, in pezzi e non a rotolo e di materiale appena accettabile. Il sistema per instillazione consta di un semplice sistema a caduta che viene applicato come secondo pad sulla medicazione e come tale non risulta idoneo per il trattamento di lesioni di ridotte dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti **5/15**

**Punto 8** Nel complesso il sistema si presenta poco maneggevole e poco pratico non presentando touchscreen ed essendo monocoloro. Il software appare poco chiaro e il sistema di serbatoio (canister) non è sempre utilizzabile con la borsa in dotazione. Per tali motivi si assegnano punti **2/10**

**TOTALE 30/70** La valutazione ha dimostrato 4 parametri pienamente insufficienti, la ditta non raggiunge il punteggio minimo stabilito (42 punti)



#### **Lotto 4: Addome Aperto**

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione della Ditta Lohmann & Rauscher.

La Ditta Waldner **NON** rispetta i requisiti minimi di durata della batteria e pertanto, nonostante presenti apparecchiatura valida, maneggevole e medicazione assolutamente idonea al contatto con i visceri, non viene ammessa al prosieguo della gara.

La Ditta Zuccato **NON** rispetta i requisiti minimi: presenta Canister NON sterili e materiale NON idoneo al contatto con i visceri, in quanto manca in IFU la specifica di possibile utilizzo a contatto con gli stessi, e pertanto non viene ammessa al prosieguo della gara.

#### **Ditta Lohmann**

**Punto 1** Si assegnano punti 5/5

**Punto 2** La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti 6/10

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, con pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. Il sistema di aggancio al letto seppur presente, è basico. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura, assieme ai contenitori per il serbatoio di aspirazione (grande e piccolo). La presenza pellicola protettiva la finestra di accesso al touchscreen ne consente una maggiore igiene.

Per tali motivi si assegnano punti 9/10

**Punto 4** Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore, è inoltre presente led che si illumina di diverso colore a seconda del buono e cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Gli allarmi risultano facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura si presenta di ampie dimensioni

Per tali motivi si assegnano punti 10/10

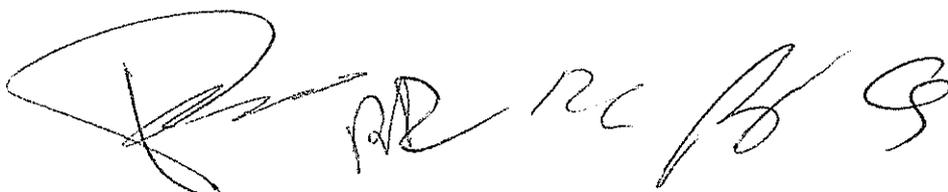
**Punto 5** Le medicazioni si presentano in confezione singola La confezione presenta lotto e data di scadenza l'etichettatura è ben visibile. Esternamente comunque appare ben descritto il tipo di medicazione e il contenuto della busta. La busta contiene: pellicola adesiva senza serigrafie che possano aiutare l'operatore nell'applicazione che appare discretamente maneggevole; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione. E' presente involucro per "impacchettare" la spugna e applicarla a contatto con visceri.

Per tali motivi si assegnano punti 3/5

**Punto 6** Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, il meccanismo di fissaggio al serbatoio di aspirazione è a pressione diretta e a blocco. Tuttavia il meccanismo del sistema di inserimento del tubo di aspirazione e al serbatoio di drenaggio appare fragile per la presenza di parti in plastica facilmente rompibili, rendendo quindi il sistema stesso poco idoneo alla sua funzione. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti 4/10

**Punto 7** La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta 1 sola misura non sufficiente. Le pellicole adesive si presentano assenti di serigrafie per l'operatore e di dimensioni ridotte. E' presente involucro per "impacchettare" la spugna e applicarla a contatto con visceri. Tale involucro si presenta assolutamente molto fragile alla minima trazione, e come tale assolutamente non adeguato al posizionamento all'interno dell'addome. La sua fragilità infatti comporta un elevato rischio di permanenza del materiale in sede e di contatto diretto della schiuma di poliuretano con i visceri, evenienza questa assolutamente dannosa.

**Per tali motivi il materiale si ritiene NON IDONEO e NON rispondente ai requisiti minimi del Lotto in oggetto**

Handwritten signature and initials in black ink, including a large stylized 'R' and other characters.

Punto 8 Non valutabile

L'offerta tecnica della Ditta non viene ammessa al prosieguo della presente gara.

**Lotto 5: Monouso**

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione delle varie Ditte.

**Ditta Convatec**

**Punto 1** Si assegnano punti **5/5**

**Punto 2** L'apparecchiatura è fornita con 6 batterie ministilo monouso, di cui 3 di ricambio.  
Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso molto contenuto. Non è tuttavia presente sistema di trasporto dedicato.  
Per tali motivi si assegnano punti **15/15**

**Punto 4** La letteratura presentata consta di case report e case series. E' presente un solo studio randomizzato prospettico. Nel complesso quindi è da ritenere di basso Level of Evidence.  
Per tali motivi si assegnano punti **5/15**

**Punto 5** Le medicazioni si presentano in confezione singola e unica busta. La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente è presente comunque la descrizione del contenuto che appare comunque ben visibile essendo la confezione costituita di parte trasparente.  
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**Punto 6** La gamma e la tipologia delle medicazioni si presenta molto varia (7 misure), e di facile applicazione grazie alle serigrafie presenti. La medicazione è applicabile su ferita chiusa.  
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**Punto 7** Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico con allarmi ben visibili, il software si presenta di facile interpretazione  
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**TOTALE 60/70**



**Ditta Smith and Nephew**

**Punto 1** Si assegnano punti **5/5**

**Punto 2** L'apparecchiatura è fornita con batterie stilo monouso senza ricambio. La durata comunque è sufficiente come da requisiti.

Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso molto contenuto. E' presente sistema di trasporto.

Per tali motivi si assegnano punti **15/15**

**Punto 4** La letteratura presentata è costituita da studi randomizzato, di cui uno prospettico e uno controllato e da una metaanalisi. Nel complesso è quindi da ritenere Level of Evidence medio alto.

Per tali motivi si assegnano punti **12/15**

**Punto 5** Le medicazioni si presentano in confezione singola e unica busta. La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente è presente comunque la descrizione del contenuto che appare comunque ben visibile essendo la confezione costituita di parte trasparente.

Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**Punto 6** La gamma e la tipologia delle medicazioni si presenta molto varia (10 misure), e di facile applicazione grazie alle serigrafie presenti. La medicazione è applicabile su ferita chiusa.

Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**Punto 7** Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico con allarmi ben visibili, il software si presenta di facile interpretazione

Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

**TOTALE 67/70**



## Ditta Waldner

**Punto 1** Si assegnano punti 5/5

**Punto 2** L'apparecchiatura non prevede batterie essendo meccanica a depressione, come tale non è possibile prevedere la durata della terapia e la sua autonomia, dipendendo la stessa dalla quantità di essudato aspirato nel canister portatile e, di conseguenza, la prestazione risulta essere inferiore e non uniforme rispetto a quelle a batteria.

Per tali motivi si assegnano punti 2/5

**Punto 3** L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso molto contenuto, anche se lo stantuffo opresente per creare la depressione risulta essere sporgente e di facile rottura. Inoltre per mantenere la depressione richiesta è necessario ripetere l'operazione con stantuffo più volte. E' presente sistema di trasporto.

Per tali motivi si assegnano punti 10/15

**Punto 4** La letteratura presentata è costituita da 2 studi randomizzati, un caso controllo, una analisi di letteratura (ma non sistematica) e un lavoro sperimentale. Nel complesso è quindi da ritenere Level of Evidence medio-basso.

Per tali motivi si assegnano punti 6/15

**Punto 5** Le medicazioni si presentano in più confezioni contenute in una scatola che riporta lotto e scadenza.

Per tali motivi si assegnano punti 10/10

**Punto 6** La gamma e la tipologia delle medicazioni si presenta molto ridotta e applicabile solo su lesione aperta. Il pad adesivo in idrocolloide costituisce parte integrante della medicazione, e come tale non è conformabile.

Per tali motivi si assegnano punti 3/10

**Punto 7** Nel complesso il sistema si presenta insufficientemente maneggevole e poco pratico, non essendo possibile prevederne la durata. L'impossibilità inoltre di conformare il pad adesivo ne limita fortemente il nostro utilizzo.

Per tali motivi si assegnano punti 3/10

**TOTALE 39/70**

Preso atto delle insufficienze ottenute nella valutazione, la Ditta non raggiunge il punteggio minimo stabilito (42 punti).





## OGGETTO: ID 18P058 SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE COMPLESSE PER L'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA

La scrivente Impresa SMITH & NEPHEW S.R.L., con sede legale in ... AGGATE BRUNAZZA (NB), Via ... DE CARPANI 2/A, avverte P.I./C.F. n. 00953780992/09531210154, nella persona del Legale Rappresentante ... STEFANIA MAINO, nato a ... MONZA, il 02/10/1970, in riferimento alla Procedura APERTA, per la fornitura di "ID 18P058 SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE COMPLESSE PER I FABBISOGNI DELL'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA", presso l'Unità Operativa di Chirurgia Vascolare, in riferimento alle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura in oggetto, formula la seguente offerta n. 23952/2020/rrv \_\_\_\_\_

Firma:

Lotto Rif.	Descrizione prodotto	Nome commerciale	Codice prodotto	Marca prodotto	CND	Numero iscrizione repertorio (se Direttiva 93/42/CEE)	Fabbisogno per 12 mesi	Prezzo unitario	Prezzo X 12 mesi (prezzo unitario x fabbisogno)	Prezzo complessivo per 48 mesi	Percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta (MAX 5 decimali)
2 1	Descrizione 2.1	Console REMASYS TOUCH 4th Edition (2019). Unità di azione comprensiva di: REMASYS TOUCH contenitore per trasporto REMASYS TOUCH traccolla REMASYS TOUCH borsa REMASYS TOUCH asta di supporto per pompa (completa di clamp per letto) REMASYS TOUCH alimentatore 220 Vac.	66802134 66801276 66801277 66801278 66801286	SMITH & NEPHEW SMITH & NEPHEW SMITH & NEPHEW SMITH & NEPHEW SMITH & NEPHEW	212040205 212040205 212040205 212040205 212040205	1778920 1360598 1360595 1451750 1451724	800	€ 2,11	€ 1.688,00	€ 6.752,00000	
2 2	Descrizione 2.2	REMASYS - F - KIT Small REMASYS - F - KIT Medium REMASYS - F - KIT Large REMASYS - F - KIT Extra Large ACTICCAT FLEX cm. 10 x 10	66800794 66800795 66800796 66800797 66800399	SMITH & NEPHEW SMITH & NEPHEW SMITH & NEPHEW SMITH & NEPHEW SMITH & NEPHEW	M49099 M49099 M49099 M49099 M09000201	1413611 1413613 1413679 1413738 983839	200	€ 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 6,12	€ 6.000,00 € 24.000,00000	€ 1.224,00 € 4.896,00000	
2 3	Descrizione 2.3	REMASYS TOUCH canister integrato da 300 ml con solidificante REMASYS TOUCH canister integrato da 800 ml con solidificante REMASYS TOUCH canister integrato da 300 ml senza solidificante non sterile	66801273 66801274 66801275	SMITH & NEPHEW SMITH & NEPHEW SMITH & NEPHEW	A060399 A060399 A060399	1360582 1360590 1497534	200	€ 30,00 € 35,00 € 30,00	€ 6.000,00 € 24.000,00000	€ 24.000,00000 € 7.800,00000	
TOTALE OFFERTA ECONOMICA (48 mesi)										€ 59.648,00000	
TOTALE PERCENTUALE RIBASSO										34,07765%	

**N.B. Il prezzo del Lotto 1 Rif.to 1, del Lotto 2 Rif.to 1, del Lotto 3 Rif.to 1 e del Lotto 4 Rif.to 1 dovrà essere comprensivo della manutenzione e assistenza tecnica Full-Risk per ciascuna apparecchiatura**

Per i punti 1, 2, 3 e 4 si precisa quanto segue:

Nel caso in cui i Kit medicazione e i contenitori siano articolati in diverse misure e capacità, nell'offerta la ditta dovrà proporre UN UNICO PREZZO

Nell'offerta dovrà essere indicato il VALORE COMMERCIALE di ciascuna apparecchiatura offerta

Nell'offerta dovrà essere indicato il costo per l'eventuale passaggio di proprietà delle apparecchiature al termine del periodo contrattuale

Nell'offerta dovrà essere riportata la PERCENTUALE DI SCONTO che verrà applicata sull'ULTIMO LISTINO PREZZI PER TUTTA LA DURATA DELLA FORNITURA per l'acquisto di eventuale ulteriore materiale di consumo

**VALORE COMMERCIALE DELL'APPARECCHIATURA OFFERTA € 34.048,45 (comprensiva di accessori) IVA esclusa**  
**costo per l'eventuale passaggio di proprietà delle apparecchiature al termine del periodo contrattuale € 3.500,00 IVA esclusa**  
**PERCENTUALE DI SCONTO che verrà applicata sull'ULTIMO LISTINO PREZZI PER TUTTA LA DURATA DELLA FORNITURA per l'acquisto di eventuale ulteriore materiale di consumo 30% (trentapercento)**

Tutti i prezzi sopra indicati sono impegnativi e irrevocabili per almeno 240 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

**Struttura economica dell'offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate negli articoli 95, c. 10 e nell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.**

Si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio.

Voci di prezzo	%	costo
costi industriali	36,90%	22010,11
costi generali	41,70%	24673,22
costi della manodopera	18,20%	10855,94
costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante)		
costi per la formazione del personale	0,10%	59,65
eventuali altri costi	//	59,65
utili di impresa	3,0%	1789,44
onni della sicurezza in relazione ai rischi, inferenziali, valutati dalla Stazione appaltante non soggetti a ribasso.	0%	0

## OGGETTO: ID 18P058 SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE COMPLESSE PER L'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA

La scrivente impresa **SMITH & NEPHEW S.p.A.**, con sede legale in **AGATE BRANCA (MB)**, Via **DE CABITANI 2/A**, Aveme P.I.C.F. n. **00993780962/09631210154**, nella persona del Legale Rappresentante **STEFANIA MAINO**, nata a **MONZA**, il **02/10/1970**, in riferimento alla Procedura **APERTA**, per la fornitura di **ID 18P058 SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE COMPLESSE PER L'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA**, presso l'Atto delle modalità di appaltamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura in oggetto, formula la seguente offerta:  
n. **2395272020hrv** Firma: 

Lotto	Rif.	Descrizione prodotto	Nome commerciale	Codice prodotto	Marca prodotto	CND	Numero iscrizione repertorio (se Direttiva 93/42/CEE)	Fabbisogno per 12 mesi	Prezzo unitario	Prezzo x 12 mesi (prezzo unitario x fabbisogno)	Prezzo complessivo per 48 mesi	Percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta (MAX 5 decimali)
5	1	Descrizione 5.1	medicazione PICO 7 - 1 Pompa sterile e 1	66802010	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678581		€ 135,00			
			medicazione PICO 7 - 1 Pompa sterile e 1	66802011	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678559		€ 135,00			
			medicazione PICO 7 - 1 Pompa sterile e 1	66802012	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678560		€ 135,00			
			medicazione PICO 7 - 1 Pompa sterile e 1	66802013	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678561		€ 135,00			
			medicazione PICO 7 - 1 Pompa sterile e 1	66802014	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678563	200	€ 135,00	€ 27.000,00	€ 108.000,00000	
			medicazione PICO 7 - 1 Pompa sterile e 1	66802015	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678564		€ 135,00			
			medicazione PICO 7 - 1 Pompa sterile e 1	66802016	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678582		€ 135,00			
			medicazione PICO 7 - 1 Pompa sterile e 1	66802017	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678584		€ 135,00			
			medicazione PICO 7 - 1 Pompa sterile e 1	66802018	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678578		€ 135,00			
			medicazione PICO 7 - 1 Pompa sterile e 1	66802019	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678579		€ 135,00			
<b>TOTALE OFFERTA ECONOMICA (48 mesi)</b>										<b>€ 108.000,00</b>		
<b>TOTALE PERCENTUALE RIBASSO</b>											<b>10,00000%</b>	

Per il lotto 5 si precisa quanto segue:  
Nell'offerta dovrà essere riportata la PERCENTUALE DI SCONTO che verrà applicata sull'ULTIMO LISTINO PREZZI PER TUTTA LA DURATA DELLA FORNITURA per l'acquisto di eventuale ulteriore materiale di consumo

**PERCENTUALE DI SCONTO che verrà applicata sull'ULTIMO LISTINO PREZZI PER TUTTA LA DURATA DELLA FORNITURA per l'acquisto di eventuale ulteriore materiale di consumo: 45% (quarantacinqueper cento)**

Tutti i prezzi sopra indicati sono impegnativi e irrevocabili per almeno 240 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.  
**Sintetizza economicamente l'offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate negli articoli 95, c. 10 e nell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.**  
Si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio:

Voci di prezzo	%	costo
costi industriali	36,90%	39852,00
costi generali	41,70%	45036,00
costi della manodopera	18,20%	19656,00

costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il fondo specifico, valutati dal datore di lavoro (dalla partecipante)	0,10%	108,00
costi per la formazione del personale	0,10%	108,00
eventuali altri costi	0	0
utili di impresa	3,0%	3240,00
oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione appaltante non soggetti a ribasso	0%	0



## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Avv.Maria Grazia Cali)**

---

## **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 27/11/2020

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Avv.Maria Grazia Cali)**

---

Copia composta di n°68 fogli ( incluso il presente ) della delibera n. 1671 del 27/11/2020 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Avv.Maria Grazia Cali)**

---