



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Luisa Bissoli

ID Gara n. 18P058 – Procedura aperta telematica per la fornitura di “Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse” per l’Azienda Ospedale – Università Padova per il periodo di 24 mesi + opzione di rinnovo per 24 mesi.

VERBALE APERTURA ECONOMICA

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre alle ore 9,00 (nove/zero) presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – Viale della Navigazione Interna 38 – 35129 Z.I. Padova, il seggio di gara nominato con nota prot. n. 64249 del 27/10/2020 (costituito dalla Dott.ssa Antonella Dai Prà dirigente amministrativo, in qualità di Autorità di gara, dal Rag. Fabio Moro collaboratore amministrativo in qualità di teste e verbalizzante e dalla Sig.ra Nicoletta Pegoraro collaboratore amministrativo in qualità di teste), procede all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica.

Si prende atto, che risultano presenti le seguenti ditte:

- ✓ Zuccato HC S.r.l., rappresentata dal Sig. Emanuele Disperati nato a Verona il 08/12/1982 (C.I. AT7646592 rilasciata dal Comune di Verona il 18/06/2013) giusta delega conferita in data 27/10/2020 che gli permette di rappresentare la ditta nella presente seduta di gara;
- ✓ Smith & Nephew S.r.l., rappresentata dalla Sig.ra Simona Maria Cirincione nata a Foggia il 10/02/1970 (C.I. AT5089002 rilasciata dal Comune di Padova il 12/11/2011) giusta delega conferita in data 21/10/2020 che gli permette di rappresentare la ditta nella presente seduta di gara;
- ✓ Waldner Tecnologie Medicali S.r.l., rappresentata dalla Sig.ra Daniela Bottarel nata a Uznach (CH) il 01/04/1968 (C.I. AV2110923 rilasciata dal Comune di Padova il 16/04/2015) giusta delega conferita in data 22/10/2020 che gli permette di rappresentare la ditta nella presente

MB

seduta di gara;

- ✓ Lohmann & Rauscher S.r.l., rappresentata dalla Sig.ra Monica Andreazzo nata a Camposampiero (PD) il 20/08/1987 (C.I. AU4979716 rilasciata dal Comune di Massanzago – PD – il 26/09/2013) giusta procura registrata in data 27/11/2019 – n° 19136 S. 1T che gli permette di rappresentare la ditta nella presente seduta di gara;
- ✓ Convatec Italia S.r.l., rappresentata dalla Sig.ra Claudia Alfonsi nata a Padova il 18/02/1988 (C.I. AU4963084 rilasciata dal Comune di Noventa Padovana – PD – il 23/02/2013) giusta procura registrata in data 21/10/2019 – n° 32276 S. 1T che gli permette di rappresentare la ditta nella presente seduta di gara.

Si precisa che:

ANF

- la procedura di gara in disamina è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 31/01/2020;
- la procedura verrà espletata utilizzando il sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a. denominato "Sintel";
- il seggio di gara incaricato individuato con nota prot. n. 64249 del 27/10/2020 del Dirigente della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica è costituito da:
 - Dott.ssa Antonella Dai Prà – in qualità di Autorità di gara
 - Rag. Fabio Moro – in qualità di teste e verbalizzante
 - Sig.ra Nicoletta Pegoraro – in qualità di teste
- come da invito inoltrato tramite la piattaforma telematica Sintel hanno caricato entro il termine fissato nei documenti di gara (29/05/2020) la documentazione richiesta le seguenti ditte: MEDI-H-ART S.r.l. di Peschiera Borromeo (MI), Zuccato HC S.r.l. di Verona, Smith & Nephew S.r.l. di Agrate Brianza (MB), Sanacilia S.r.l. di Roma, Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio Unico di Verona, Lohmann & Rauscher S.r.l. di Rubano (PD) e Convatec Italia S.r.l. di Roma;
- come risulta dai Verbali del 04/06/2020 e del 10/06/2020 – custoditi presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica -, con i quali l'Autorità di gara ha proceduto alla verifica della correttezza e completezza della documentazione amministrativa ed alla conseguente ammissione delle ditte concorrenti alla successiva fase di gara per i

seguenti lotti:

- ✓ MEDI-H-ART S.r.l. lotti 1 e 2
- ✓ Zuccato HC S.r.l. lotti 1 e 4
- ✓ Smith & Nephew S.r.l. lotti 1, 2 e 5
- ✓ Sanacilia S.r.l. lotti 1 e 3
- ✓ Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. lotti 1, 2, 3, 4 e 5
- ✓ Lohmann & Rauscher S.r.l. lotti 1 e 4
- ✓ Convatec Italia S.r.l. lotto 5

- l'aggiudicazione avverrà per lotto completo di tutti i riferimenti previsti nel Capitolato Tecnico, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: Qualità punteggio massimo 70 punti (sulla base dei criteri riportati nel Capitolato Speciale), Prezzo punteggio massimo 30 punti;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 950 del 10/07/2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;
- la Commissione Giudicatrice a seguito dei lavori di valutazione delle offerte tecniche e della campionatura richiesta e presentata ha redatto per ogni attività svolta, sedute riservate del 28/07/2020, 04/09/2020, 07/09/2020 e 22/09/2020, i relativi verbali custoditi presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
- con atto di fusione, n. 6765 di Repertorio – n. 3402 di Raccolta, la ditta Medi-H-Art S.r.l. è stata incorporata alla ditta Service Med S.p.a.;
- dai Verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice risulta quanto segue:
 - ✓ risultano aggiudicabili i lotti 1, 2 e 5 – non risultano aggiudicabili i lotti 3 e 4;
 - ✓ la ditta Medi-H-Art S.r.l., ora Service Med S.p.a., viene esclusa dai lotti 1 e 2 in quanto non possiede uno dei requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Speciale;
 - ✓ la ditta Zuccato HC S.r.l. viene esclusa dai lotti 1 e 4 rispettivamente per non aver raggiunto il punteggio minimo e per mancanza di uno dei requisiti stabiliti nel Capitolato Speciale;
 - ✓ la ditta Sanacilia S.r.l. viene esclusa dai lotti 1 e 3 in quanto non raggiunge il punteggio

HP

minimo stabilito nel Capitolato Speciale;

- ✓ la ditta Waldner Technologie Medicali S.r.l. viene esclusa dai lotti 3 e 4 in quanto non possiede uno dei requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Speciale e dal lotto 5 in quanto non raggiunge il punteggio minimo;
- ✓ la ditta Lohmann & Rauscher S.r.l. viene esclusa dal lotto 4 in quanto non possiede uno dei requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Speciale;

Per quanto sopra si procederà all'apertura delle busta telematica contenente l'offerta economica delle ditte sotto indicate per i lotti di seguito indicati:

Lotto	Ditte:
1	Smith & Nephew S.r.l., Waldner Technologie Medicali S.r.l., Lohmann & Rauscher S.r.l.
2	Smith & Nephew S.r.l., Waldner Technologie Medicali S.r.l.
3	Nessuna offerta tecnica valida
4	Nessuna offerta tecnica valida
5	Smith & Nephew S.r.l., Convatec Italia S.r.l.

AM

Si procede all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica delle ditte sopraindicate ed alla conseguente individuazione delle ditte aggiudicatrici.

Da tale operazione è risultato quanto segue:

LOTTO 1 – Importo a base d'asta € 164.957,24

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1 [^]	Waldner Technologie	€ 154.342,00	63	18,70	81,70
2 [^]	Lohmann & Rauscher	€ 94.684,00	50	30	80,00
3 [^]	Smith&Nepheew	€ 152.711,60	58	19,38	77,38

LOTTO 2 – Importo a base d'asta € 90.400,00

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1 [^]	Smith&Nepheew	€ 59.648,00	61	30	91,00
2 [^]	Waldner Technologie	€ 65.200,00	62	28,54	90,54

LOTTO 3 – Importo a base d'asta € 114.800,00

Nessuna offerta tecnica valida

LOTTO 4 – Importo a base d'asta € 29.673,60

Nessuna offerta tecnica valida

LOTTO 5 – Importo a base d'asta € 120.000,00

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Smith&Nephew	€ 108.000,00	67	25,66	92,66
2^	Convatec Italia	€ 97.600,00	60	30	90,00

Dal momento che l'offerta della ditta Smith & Nephew S.r.l., per i lotti 2 e 5, ha realizzato sia i quattro quinti dei punti relativi al prezzo che i quattro quinti dei punti relativi alla qualità, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà cura della Stazione Appaltante richiedere alla ditta sopraindicata la presentazione delle giustificazioni relativi alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo proposto.

L'aggiudicazione definitiva della fornitura rimane subordinata a quanto stabilito nei documenti di gara che regolano la presente procedura, ed a quant'altro dovesse emergere in merito alla regolarità delle offerte e della documentazione presentata dalle ditte aggiudicatarie.

La seduta di gara si conclude alle ore 10,35.

Viene redatto il presente verbale, composto da 5 (cinque) facciate e n. 7 allegati rappresentati da: Verbale n. 1 del 28/07/2020, Verbale n. 2 del 04/09/2020, Verbale n. 3 del 07/09/2020 e Verbale n. 4 del 22/09/2020 – nei quali vengono riportate le motivazioni ed i relativi punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice, offerta della ditta Waldner Technologie Medicali S.r.l. per il lotto 1 e offerte della ditta Smith & Nephew S.r.l. per i lotti 2 e 5, sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

IL SEGGIO DI GARA:

PRESIDENTE

Dott.ssa Antonella Dai Prà

Antonella Dai Prà

TESTE

Sig.ra Nicoletta Pegoraro

Nicoletta Pegoraro

VERBALIZZANTE

Rag Fabio Moro

Fabio Moro

AN

VERBALE N. 1 del 28 Luglio 2020

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE COMPLESSE PER L'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA PER IL PERIODO DI 48 MESI (COMPRENSIVO DELL'OPZIONE DI RINNOVO PER 24 MESI) – ID GARA 18P065

L'anno duemilaventiti, il giorno 28 del mese di luglio alle ore 15,00 presso il Centro Gallucci - Biblioteca "Pier Giuseppe Cesese" dell'Azienda Ospedale – Università Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura aperta telematica mediante piattaforma Sintel, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" per l'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 31/01/2020.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 950 del 10/07/2020 è così composta:

PRESIDENTE: Dott. Roberto Bianco – U.O.C. Cardiocirurgia

COMPONENTI: Dott.ssa Carlotta Scarpa – U.O.C. Chirurgia Plastica

Dott. Alex Pontini – U.O.C. Grandi Ustionati

Dott. Enzo Mammano – S.C. Chirurgia OSA

P.I. Roberto Bacchin – U.O.S. Ingegneria Clinica

PREMESSO

- che l'aggiudicazione della fornitura succitata verrà effettuata per lotto completo ed indivisibile (le ditte dovranno offrire tutti i riferimenti facenti parte del lotto);








AD

- ✓ la ditta MEDI-H-ART S.r.l. NON rispetta i requisiti minimi di durata della batteria per i lotti 1 e 2, pertanto non si procede alla valutazione dei prodotti;
- ✓ la ditta Waldner Technologie Medicali S.r.l. NON rispetta i requisiti minimi di durata della batteria per i lotti 3 e 4, pertanto non si procede alla valutazione dei prodotti;
- ✓ la ditta Zuccato HC S.r.l. NON rispetta i requisiti minimi per il lotto 4, e precisamente: presenta Canister NON sterili e materiale NON idoneo al contatto con i visceri; in quanto manca in IFU la specifica di possibile utilizzo a contatto con gli stessi, pertanto non si procede alla valutazione del prodotto.

La Commissione decide che il P.I. Roberto Bacchin provvederà ad inoltrare alla U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica la richiesta di campionatura da inviare alle ditte concorrenti, la campionatura dovrà essere consegnata entro il 21/08/2020.

I lavori si concludono alle ore 17,00.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dott. Roberto Bianco	
Dott.ssa Carlotta Scarpa	
Dott. Alex Pontini	
Dott. Enzo Mammamo	
P.I. Roberto Bacchin	

Verbalizzante: Dott.ssa Carlotta Scarpa

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

via Nicolò Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA

c.f./p.iva 00349040287

VERBALE N. 2 del 4 settembre 2020

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE COMPLESSE PER L'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA PER IL PERIODO DI 48 MESI (COMPRENSIVO DELL'OPZIONE DI RINNOVO PER 24 MESI) – ID GARA 18P065

L'anno duemilaventiti, il giorno 4 del mese di settembre alle ore 13,00 presso il Centro Gallucci - Biblioteca "Pier Giuseppe Cevese" dell'Azienda Ospedale – Università Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura aperta telematica mediante piattaforma Sintel, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" per l'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 31/01/2020.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 950 del 10/07/2020 è così composta:

PRESIDENTE: Dott. Roberto Bianco – U.O.C. Cardiocirurgia

COMPONENTI: Dott.ssa Carlotta Scarpa – U.O.C. Chirurgia Plastica

Dott. Alex Pontini – U.O.C. Grandi Ustionati

Dott. Enzo Mammano – S.C. Chirurgia OSA

P.I. Roberto Bacchin – U.O.S. Ingegneria Clinica

PREMESSO

- che l'aggiudicazione della fornitura succitata verrà effettuata per lotto completo ed indivisibile (le ditte dovranno offrire tutti i riferimenti facenti parte del lotto);

- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio stabilito all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio qualità + punteggio prezzo), determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità punteggio massimo punti 70
- prezzo punteggio massimo punti 30

- che a seguito dell'assegnazione dei punteggi, come indicato al punto precedente, verranno individuate, lotto per lotto, le ditte che avendo proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa risultano prime in graduatoria;
- che non verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le ditte che otterranno un punteggio di qualità inferiore a 42 punti su 70 punti.

IL PRESIDENTE

- constatata la presenza di tutti componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'assegnazione dei punteggi e relative motivazioni.

LA COMMISSIONE

procede all'assegnazione dei punteggi qualità e relative motivazioni sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati:

n.	Criteri di valutazione della qualità LOTTI 1, 2, 3 e 4	Punteggio minimo pena esclusione	Punteggio massimo

APPARECCHIATURE			
			5
1	Assistenza tecnica (organizzazione del servizio, tecnici dedicati su Padova, tempi di risposta massima per intervento tecnico, risoluzione del guasto ed intervento tempestivo in caso di guasto) fornire autodichiarazione	-	
2	Durata ed autonomia della batteria	-	10
3	Ingombro, sistema di trasporto e aggancio al letto	-	10
4	Facilità di percezione e gestione degli allarmi	-	10
	MATERIALE DI CONSUMO		

ML

5	Confezionamento (inteso come facilità di apertura del confezionamento primario, chiarezza e facile comprensibilità dei dati relativi al dispositivo contenuto, lotto, scadenza, ref. ecc.)	-	5
6	Sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione	-	10
7	Gamma, misure e caratteristiche tecniche delle medicazioni	-	15
	APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO		
8	Maneggevolezza e praticità d'uso del sistema	-	5
	TOTALE PUNTEGGIO		70

n.	Criteria di valutazione della qualità LOTTO 5	Punteggio minimo pena esclusione	Punteggio massimo
	APPARECCHIATURE		
1	Assistenza tecnica (organizzazione del servizio, tecnici dedicati su Padova, tempi di risposta massima per intervento tecnico, risoluzione del guasto, da specificare, ed intervento tempestivo in caso di guasto) fornire autodichiarazione	-	5
2	Durata ed autonomia della batteria	-	5
3	Ingombro e sistema di trasporto	-	15
4	Numerosità e tipologia degli studi clinici a supporto dei prodotti presentati	-	15
	MATERIALE DI CONSUMO		
5	Confezionamento (inteso come facilità di apertura del confezionamento primario, chiarezza e facile	-	10

NR

CS

AR

	comprensibilità dei dati relativi al dispositivo contenuto, lotto, scadenza, ref. ecc.)		
6	Gamma, misure e caratteristiche tecniche delle medicazioni	-	10
	APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO		
7	Maneggevolezza e praticità d'uso del sistema	-	10
	TOTALE PUNTEGGIO		70





Non verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le ditte che totalizzeranno un punteggio di qualità inferiore al punteggio minimo di 42 punti.

Gli allegati riportanti i punteggi con relative motivazioni assegnati alle ditte concorrenti vengono allegati al presente verbale e ne fanno parte integrante e sostanziale (n. 12 Allegati).


La Commissione non procede all'assegnazione del punteggio relativo al criterio 1: "Assistenza tecnica (organizzazione del servizio, tecnici dedicati su Padova, tempi di risposta massima per intervento tecnico, risoluzione del guasto, da specificare, ed intervento tempestivo in caso di guasto) fornire autodichiarazione" in quanto si riserva di effettuare ulteriori verifiche e approfondimenti.

I lavori si concludono alle ore 16,30.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dott. Roberto Bianco	
Dott.ssa Carlotta Scarpa	
Dott. Alex Pontini	
Dott. Enzo Mammamo	

AR

P.I. Roberto Bacchin	
----------------------	--

Verbalizzante: Dott.ssa Carlotta Scarpa







Lotto 1: Terapia a pressione negativa.

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione di ogni Ditta e all'assegnazione dei punteggi

Ditta Waldner Tecnologie Medicali

Punto 2 La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, ma tuttavia assente di pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touchscreen del dispositivo. Il sistema di aggancio al letto seppur presente, è basilico. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura, assieme alla sacca per la disinfezione. Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

Punto 4 Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore. Facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura però, pur essendo multicolor e touchscreen, non si presenta di ampie dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

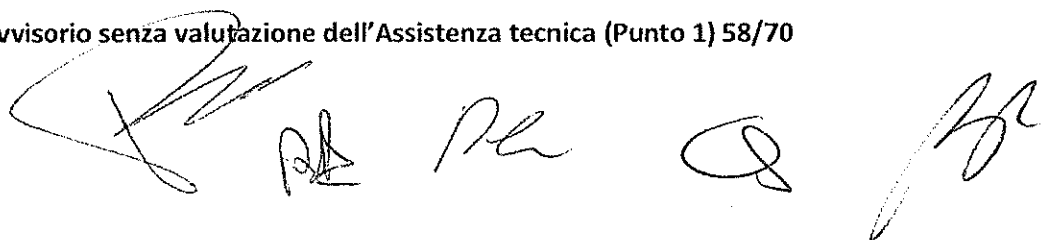
Punto 5 Le medicazioni in schiuma si presentano in confezione singola ma assenti di doppio sacchetto contenitore (solo sacchetto esterno). La medicazione in garza si presenta con ulteriore sacchetto contenitore la garza in rotolo. La confezione presenta lotto e data di scadenza con contenuto ben visibile dall'esterno, in quanto la busta è trasparente; l'etichettatura è ben visibile. Esternamente comunque appare ben descritto il tipo di medicazione e il contenuto della busta. La busta contiene: pellicola adesiva con serigrafie che possono aiutare l'operatore nell'applicazione e la cui applicazione appare maneggevole e semplice; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; è presente inoltre righello flessibile per la misurazione della lesione e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione. Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta idoneo, con chiare indicazioni per l'applicazione da parte dell'operatore. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. L'attacco del tubo al sistema di canister è rapido e a baionetta. Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

Punto 7 La medicazione è fornita in ampia gamma di dimensioni e forme, personalizzabile ritagliandola a seconda della necessità sia per dimensione che per spessore. (Numerosi gli accessori presentati a parte come, ad esempio, confezioni contenenti le sole pellicole adesive, o il solo sistema di fissaggio del tubo di aspirazione alla medicazione.) Per tali motivi si assegnano punti **15/15**

Punto 8 Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando touchscreen multicolor anche se di non ampie dimensioni; le medicazioni sono varie e facilmente applicabili. Il software appare di facile comprensione sia per i messaggi che per il codice colore, che aiuta l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Per tali motivi si assegnano punti **4/5**

TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza tecnica (Punto 1) 58/70



Ditta Lohmann & Rauscher

Punto 2 La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, con pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. Il sistema di aggancio al letto seppur presente, è basico. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura, assieme ai contenitori per il serbatoio di aspirazione (grande e piccolo). La presenza pellicola protettiva la finestra di accesso al touchscreen ne consente una maggiore igiene. Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

Punto 4 Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore, è inoltre presente led che si illumina di diverso colore a seconda del buono e cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Gli allarmi risultano facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo di allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura si presenta di ampie dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

Punto 5 Le medicazioni si presentano in confezione singola con doppio sacchetto contenitore (sacchetto esterno non sterile e interno sterile). La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente comunque appare ben descritto il tipo di medicazione e il contenuto della busta. La busta contiene: pellicola adesiva senza serigrafie che possano aiutare l'operatore nell'applicazione che appare discretamente maneggevole; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione. Per tali motivi si assegnano punti **3/5**

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, il meccanismo di fissaggio al serbatoio di aspirazione è a pressione diretta e a blocco. Tuttavia il meccanismo del sistema di inserimento del tubo di aspirazione e al serbatoio di drenaggio appare fragile per la presenza di parti in plastica facilmente usurabili, rendendo quindi il sistema stesso poco pratico. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti **4/10**

Punto 7 La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta (3 misure), appena sufficiente; le dimensioni, seppur conformabili, sono standard. Le pellicole adesive si presentano assenti di serigrafie per l'operatore e di dimensioni ridotte. Solo la medicazione in garza presenta rotolo adesivo ritagliabile. Per tali motivi si assegnano punti **8/15**

Punto 8 Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando con touchscreen multicolor e di ampie dimensioni. Il software appare di facile comprensione sia per la sequenza dei colori che per i messaggi che aiutano l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza tecnica (Punto 1) 45/70



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials (BR, RA, Q, and another signature) to the right.

Ditta Sanacilia

Punto 2 La durata e autonomia della batteria è di 24 ore, ma deve essere verificato se anche quando in uso. Per tali motivi si assegnano punti **8/10**

Punto 3 L'apparecchiatura appare piuttosto ingombrante, completa di borsetta pluriuso in materiale scadente e non idonea a contenere il serbatoio di più grandi dimensioni. Non è presente valigetta contenitore e la cavetteria viene fornita a parte in sacchetto di plastica, così come il dispositivo stesso. Assente il sistema di fissaggio e aggancio al letto. Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

Punto 4 L'allarme è acustico e con messaggio su schermo che però si presenta monocoloro. Assente un codice colore che faciliti la comprensione dello stesso. Lo schermo non è touch screen per la gestione degli allarmi. Durante la prova la segnalazione di perdita d'aria si presenta solo dopo parecchi minuti. Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

Punto 5 Le medicazioni si presentano in confezione singola con doppio sacchetto contenitore (sacchetto esterno non sterile e interno sterile) solo per quelle in garza. Sulla busta principale sono presenti lotto e data di scadenza, la descrizione del contenuto è assolutamente sommaria. Per tali motivi si assegnano punti **2/5**

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, e privo di serigrafia che possa aiutare l'operatore nella sua applicazione, che comunque si presenta poco maneggevole e di non facile posizionamento. Il meccanismo di collegamento del tubo di drenaggio al sistema di aspirazione è a vite. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti **4/10**

Punto 7 La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta (3 misure), le dimensioni, seppur conformabili, sono standard. Le pellicole adesive si presentano idonee con serigrafie che indicano all'operatore la corretta sequenza di applicazione. I canister sono disposable e graduati, ma i più grandi non solo utilizzabili con la borsa fornita per il trasporto. La medicazione in garza si presenta a tramatura larga, in pezzi e non a rotolo e di materiale appena accettabile. Per tali motivi si assegnano punti **6/15**

Punto 8 Nel complesso il sistema si presenta poco maneggevole e poco pratico non presentando touchscreen ed essendo monocoloro. Il software appare poco chiaro e il sistema di serbatoio (canister) non è sempre utilizzabile con la borsa in dotazione. Per tali motivi si assegnano punti **2/10**

AP

TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza (Punto 1) 28/70

La Valutazione ha dimostrato 4 parametri pienamente insufficienti, anche in mancanza della valutazione del punto 1 in ogni caso la ditta non raggiunge il punteggio minimo stabilito nei documenti di gara (42 punti).

Ditta Smith & Nephew

Punto 2 La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti.
Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, con pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. La borsa fornita in dotazione tuttavia non è idonea a contenere il canister di dimensioni maggiori. Il sistema di aggancio al letto è molto valido. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura. La presenza pellicola protettiva la finestra di accesso al touchscreen ne consente una maggiore igiene.

Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

Punto 4 Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore. Gli allarmi risultano facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura si presenta di ampie dimensioni, touchscreen, multicolor.

Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

Punto 5 Le medicazioni si presentano in confezione singola e unica busta. La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente è presente la descrizione del contenuto. La busta contiene: pellicola adesiva con serigrafie che possono aiutare l'operatore nell'applicazione che appare maneggevole; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione.

Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta idoneo, il meccanismo di collegamento tra tubo di drenaggio e serbatoio appare a pressione e completato da ulteriore meccanismo di sicurezza a incastro. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Non sono tuttavia presenti serigrafie per l'operatore.

Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

Punto 7 La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta varia ma comunque ridotta. Le medicazioni appaiono tuttavia conformabili. Le pellicole adesive sono numerose, ma presentano serigrafie per l'operatore appena sufficienti. La medicazione in garza si presenta in rotolo adesivo separato. (Numerosi gli accessori)

Per tali motivi si assegnano punti **10/15**

Punto 8 Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando un touchscreen multicolor e di ampie dimensioni. Il software appare di facile comprensione sia per la sequenza dei colori che per i messaggi che aiutano l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Tuttavia la borsa in dotazione non risulta essere idonea a contenere il canister di maggiori dimensioni.

Per tali motivi si assegnano punti **4/5**

TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza tecnica (Punto 1) 53/70

Ditta Zuccato HC

Punto 2 La durata e autonomia della batteria è di 24 ore, ma deve essere verificato se anche quando in uso. Per tali motivi si assegnano punti **8/10**

Punto 3 L'apparecchiatura appare leggermente ingombrante. Non è presente valigetta contenitore e la cavetteria viene fornita a parte. Non è presente un sistema di aggancio aletto specifico. Per tali motivi si assegnano punti **5/10**

Punto 4 Lo schermo si presenta monocolor e di dimensioni estremamente ridotte e non adeguate per la visualizzazione e l'interpretazione degli allarmi che risultano quindi difficilmente visibili e interpretabili. E' assente un codice colore. Per tali motivi si assegnano punti **2/10**

Punto 5 Le medicazioni si presentano in doppia busta. Sulla busta principale sono presenti lotto e data di scadenza, la descrizione del contenuto è assolutamente sommaria. Assenti le serigrafie per l'operatore. E' tuttavia presente righello per misurare la lesione. Per tali motivi si assegnano punti **3/5**

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, e privo di serigrafia che possa aiutare l'operatore nella sua applicazione, che comunque si presenta discretamente maneggevole. Il meccanismo di collegamento del tubo di drenaggio al sistema di aspirazione è a baionetta. Il sistema di serbatoio (canister) appare non adeguato presentando blocco a vite sull'apparecchiatura. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

Punto 7 La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta, così come le dimensioni delle pellicole adesive che sono prive di serigrafie. La spugna di poliuretano appare poco malleabile e poco maneggevole. Per tali motivi si assegnano punti **4/15**

Punto 8 Nel complesso il sistema si presenta poco maneggevole e poco pratico non presentando touchscreen ed essendo monocolor. Il software appare poco chiaro; il sistema di serbatoio (canister) appare non adeguato presentando sistema di aggancio all'apparecchiatura con blocco a vite. Per tali motivi si assegnano punti **2/10**

AP

TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza tecnica (Punto 1) 30/70

Anche in mancanza della valutazione del punto 1 in ogni caso la ditta non raggiunge il punteggio minimo stabilito nei documenti di gara (42 punti).

PAR NA S AD

Lotto 2: Argento.

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione di ogni Ditta e all'assegnazione dei punteggi.

Ditta Waldner Technologie Medicali

Punto 2 La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, ma tuttavia assente di pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. Il sistema di aggancio al letto seppur presente, è basilico. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura, assieme alla sacca per la disinfezione. Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

Punto 4 Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore. Facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura però, pur essendo multicolor e touch screen, non si presenta di ampie dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

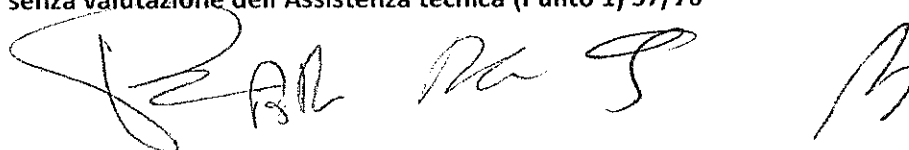
Punto 5 Le medicazioni in schiuma si presentano in confezione singola ma assenti di doppio sacchetto contenitore (solo sacchetto esterno). La confezione presenta lotto e data di scadenza con contenuto ben visibile dall'esterno, in quanto la busta è trasparente; l'etichettatura è ben visibile. Esternamente comunque appare ben descritto il tipo di medicazione e il contenuto della busta. La busta contiene: pellicola adesiva con serigrafie che possono aiutare l'operatore nell'applicazione e la cui applicazione appare maneggevole e semplice; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; è presente inoltre righello flessibile per la misurazione della lesione e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione. Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta idoneo, con chiare indicazioni per l'applicazione da parte dell'operatore. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. L'attacco del tubo al sistema di canister è rapido e a baionetta. Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

Punto 7 La medicazione è fornita in ampia gamma di dimensioni e forme, personalizzabile ritagliandola a seconda della necessità sia per dimensione che per spessore. L'argento richiesto appare contenuto all'interno della schiuma stessa, caratteristica questa che ne comporta la rimozione ogni qual volta la medicazione esterna, come ad esempio la pellicola adesiva o la schiuma, debba essere rinnovata. (Numerosi gli accessori presentati a parte come, ad esempio, confezioni contenenti le sole pellicole adesive, o il solo sistema di fissaggio del tubo di aspirazione alla medicazione.) Per tali motivi si assegnano punti **14/15**

Punto 8 Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando touchscreen multicolor anche se di **non** ampie dimensioni; le medicazioni sono varie e facilmente applicabili. Il software appare di facile comprensione sia per i messaggi che per il codice colore, che aiuta l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Per tali motivi si assegnano punti **4/5**

TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza tecnica (Punto 1) 57/70



Ditta Smith and Nephew

Punto 2 La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti.
Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, con pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. La borsa fornita in dotazione tuttavia non è idonea a contenere il canister di dimensioni maggiori. Il sistema di aggancio al letto è molto valido. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura. La presenza pellicola protettiva la finestra di accesso al touchscreen ne consente una maggiore igiene.
Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

Punto 4 Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore. Gli allarmi risultano facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura si presenta di ampie dimensioni, touchscreen, multicolor.
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**


Punto 5 Le medicazioni si presentano in confezione singola e unica busta. La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente è presente la descrizione del contenuto. La busta contiene: pellicola adesiva con serigrafie che possono aiutare l'operatore nell'applicazione che appare maneggevole; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione.
Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta idoneo, il meccanismo di collegamento tra tubo di drenaggio e serbatoio appare a pressione e completato da ulteriore meccanismo di sicurezza a incastro. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Non sono tuttavia presenti serigrafie per l'operatore.
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

Punto 7 La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta varia ma comunque ridotta. Le medicazioni appaiono tuttavia conformabili. Le pellicole adesive sono numerose, ma presentano serigrafie per l'operatore appena sufficienti. L'argento è contenuto in una medicazione a parte (Acticoat) che viene posizionata al di sotto della schiuma in poliuretano consentendo la sua permanenza in sede, anche qualora sia necessario il cambio di medicazione esterna intesa come pellicola adesiva e/o schiuma di poliuretano. (Numerosi gli accessori).
Per tali motivi si assegnano punti **12/15**

Punto 8 Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando un touchscreen multicolor e di ampie dimensioni. Il software appare di facile comprensione sia per la sequenza dei colori che per i messaggi che aiutano l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Tuttavia la borsa in dotazione non risulta essere idonea a contenere il canister di maggiori dimensioni..
Per tali motivi si assegnano punti **4/5**

TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza tecnica (Punto 1) 56/70

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature that appears to be 'R' followed by 'AL'. To its right are the initials 'ML', a signature that looks like 'S', and another signature that is partially cut off on the right edge of the page.

Lotto 3: Instillazione

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione della Ditta Sanacilia.

La Ditta Waldner Tecnologie Medicali **NON** rispetta i requisiti minimi di durata della batteria e pertanto, nonostante presenti apparecchiatura valida, maneggevole e ampia gamma di medicazioni viene esclusa.

Ditta Sanacilia

Punto 2 La durata e autonomia della batteria è di 24 ore, ma deve essere verificato se anche quando in uso. Per tali motivi si assegnano punti **8/10**

Punto 3 L'apparecchiatura appare piuttosto ingombrante, completa di borsetta pluriuso in materiale scadente e non idonea a contenere il serbatoio di più grandi dimensioni. Non è presente valigetta contenitore e la cavetteria viene fornita a parte in sacchetto di plastica, così come il dispositivo stesso. Assente il sistema di fissaggio e aggancio al letto.

Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

Punto 4 L'allarme è acustico e con messaggio su schermo che però si presenta monocore. Assente un codice colore che faciliti la comprensione dello stesso. Lo schermo non è touchscreen per la gestione degli allarmi. Durante la prova la segnalazione di perdita d'aria si presenta solo dopo parecchi minuti.

Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

Punto 5 Le medicazioni si presentano in confezione singola con doppio sacchetto contenitore (sacchetto esterno non sterile e interno sterile) solo per quelle in garza. Sulla busta principale sono presenti lotto e data di scadenza, la descrizione del contenuto è assolutamente sommaria. Il sistema per instillazione si presenta a parte in ulteriore confezione.

Per tali motivi si assegnano punti **2/5**

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, e privo di serigrafia che possa aiutare l'operatore nella sua applicazione, che comunque si presenta poco maneggevole e di non facile posizionamento il meccanismo di collegamento del tubo di drenaggio al sistema di aspirazione è a vite. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking.

Per tali motivi si assegnano punti **4/10**

Punto 7 La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta (3 misure), appena sufficiente, le dimensioni, seppur conformabili, sono standard. Le pellicole adesive si presentano idonee con serigrafie che indicano all'operatore la corretta sequenza di applicazione. I canister sono disposable e graduati, ma i più grandi non solo utilizzabili con la borsa fornita per il trasporto. La medicazione in garza si presenta a tramatura larga, in pezzi e non a rotolo e di materiale appena accettabile. Il sistema per instillazione consta di un semplice sistema a caduta che viene applicato come secondo pad sulla medicazione e come tale non risulta idoneo per il trattamento di lesioni di ridotte dimensioni.

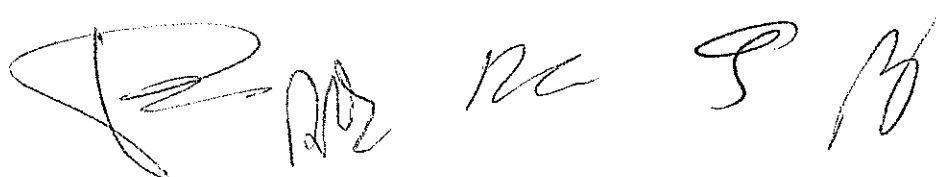
Per tali motivi si assegnano punti **5/15**

Punto 8 Nel complesso il sistema si presenta poco maneggevole e poco pratico non presentando touchscreen ed essendo monocore. Il software appare poco chiaro e il sistema di serbatoio (canister) non è sempre utilizzabile con la borsa in dotazione.

Per tali motivi si assegnano punti **2/10**

TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza tecnica (Punto 1) 27/70.

La Valutazione ha dimostrato 4 parametri pienamente insufficienti, la ditta non raggiunge il punteggio minimo stabilito nei documenti di gara anche nel caso nel criterio "Assistenza tecnica" dovesse essere assegnato il punteggio massimo (5 punti)



Lotto 4: Addome Aperto

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione della Ditta Lohmann & Rauscher.

La Ditta Waldner **NON** rispetta i requisiti minimi di durata della batteria e pertanto, nonostante presenti apparecchiatura valida, maneggevole e medicazione assolutamente idonea al contatto con i visceri, non viene ammessa al prosieguo della gara.

La Ditta Zuccato **NON** rispetta i requisiti minimi: presenta Canister NON sterili e materiale NON idoneo al contatto con i visceri, in quanto manca in IFU la specifica di possibile utilizzo a contatto con gli stessi, e pertanto non viene ammessa al prosieguo della gara.

Ditta Lohmann

Punto 2 La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, con pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. Il sistema di aggancio al letto seppur presente, è basico. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura, assieme ai contenitori per il serbatoio di aspirazione (grande e piccolo). La presenza pellicola protettiva la finestra di accesso al touchscreen ne consente una maggiore igiene. Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

Punto 4 Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore, è inoltre presente led che si illumina di diverso colore a seconda del buono e cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Gli allarmi risultano facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura si presenta di ampie dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

Punto 5 Le medicazioni si presentano in confezione singola. La confezione presenta lotto e data di scadenza. L'etichettatura è ben visibile. Esternamente comunque appare ben descritto il tipo di medicazione e il contenuto della busta. La busta contiene: pellicola adesiva senza serigrafie che possano aiutare l'operatore nell'applicazione che appare discretamente maneggevole; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione. E' presente involucri per "impacchettare" la spugna e applicarla a contatto con visceri. Per tali motivi si assegnano punti **3/5**

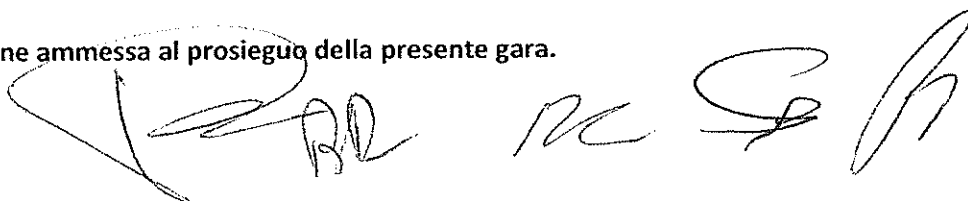
Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, il meccanismo di fissaggio al serbatoio di aspirazione è a pressione diretta e a blocco. Tuttavia il meccanismo del sistema di inserimento del tubo di aspirazione e al serbatoio di drenaggio appare fragile per la presenza di parti in plastica facilmente rompibili, rendendo quindi il sistema stesso poco idoneo alla sua funzione. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti **4/10**

Punto 7 La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta. 1 sola misura non sufficiente. Le pellicole adesive si presentano assenti di serigrafie per l'operatore e di dimensioni ridotte. E' presente involucri per "impacchettare" la spugna e applicarla a contatto con visceri. Tale involucri si presenta assolutamente molto fragile alla minima trazione, e come tale assolutamente non adeguato al posizionamento all'interno dell'addome. La sua fragilità infatti comporta un elevato rischio di permanenza del materiale in sede e di contatto diretto della schiuma di poliuretano con i visceri, evenienza questa assolutamente dannosa.

Per tali motivi il materiale si ritiene NON IDONEO e NON rispondente ai requisiti minimi del Lotto in oggetto

Punto 8 Non valutabile

La Ditta non viene ammessa al prosieguo della presente gara.



Lotto 5: Monouso

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione delle varie Ditte.

Ditta Convatec

Punto 2 L'apparecchiatura è fornita con 6 batterie ministilo monouso, di cui 3 di ricambio.
Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso molto contenuto. Non è tuttavia presente sistema di trasporto dedicato.
Per tali motivi si assegnano punti **15/15**

Punto 4 La letteratura presentata consta di case report e case series. E' presente un solo studio randomizzato prospettico. Nel complesso quindi è da ritenere di basso Level of Evidence.
Per tali motivi si assegnano punti **5/15**

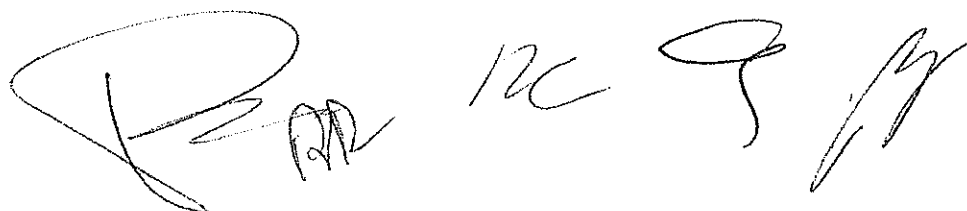
Punto 5 Le medicazioni si presentano in confezione singola e unica busta. La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente è presente comunque la descrizione del contenuto che appare comunque ben visibile essendo la confezione costituita di parte trasparente.
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

Punto 6 La gamma e la tipologia delle medicazioni si presenta molto varia (7 misure), e di facile applicazione grazie alle serigrafie presenti. La medicazione è applicabile su ferita chiusa.
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

Punto 7 Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico con allarmi ben visibili, il software si presenta di facile interpretazione
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza tecnica (Punto 1) 55/70

AR

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized signature on the left, the initials 'RC' in the center, and another signature on the right.

Ditta Smith and Nephew

Punto 2 L'apparecchiatura è fornita con batterie stilo monouso senza ricambio. La durata comunque è sufficiente come da requisiti.

Per tali motivi si assegnano punti 5/5

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso molto contenuto. E' presente sistema di trasporto.

Per tali motivi si assegnano punti 15/15

Punto 4 La letteratura presentata è costituita da studi randomizzato, di cui uno prospettico e uno controllato e da una metaanalisi. Nel complesso è quindi da ritenere Level of Evidence medio alto.

Per tali motivi si assegnano punti 12/15

Punto 5 Le medicazioni si presentano in confezione singola e unica busta. La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente è presente comunque la descrizione del contenuto che appare comunque ben visibile essendo la confezione costituita di parte trasparente.

Per tali motivi si assegnano punti 10/10

Punto 6 La gamma e la tipologia delle medicazioni si presenta molto varia (10 misure), e di facile applicazione grazie alle serigrafie presenti. La medicazione è applicabile su ferita chiusa.

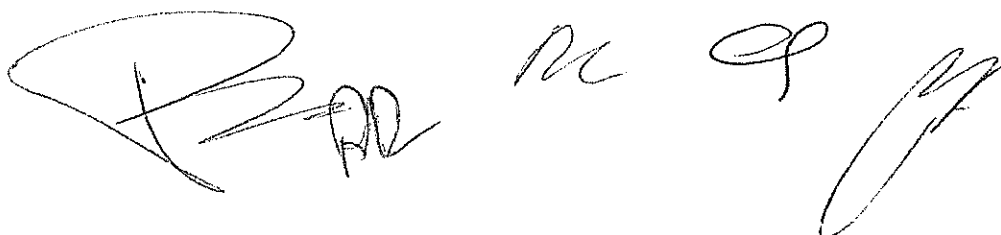
Per tali motivi si assegnano punti 10/10

Punto 7 Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico con allarmi ben visibili, il software si presenta di facile interpretazione

Per tali motivi si assegnano punti 10/10

TOTALE provvisorio senza valutazione dell'Assistenza (Punto 1) 62/70

AK

The image shows four handwritten signatures or initials in black ink. From left to right: a large, stylized signature that appears to be 'AR'; a smaller signature that looks like 'AL'; a signature that looks like 'S'; and a large, stylized signature that looks like 'M'.

Ditta Waldner

Punto 2 L'apparecchiatura non prevede batterie essendo meccanica a depressione, come tale non è possibile prevedere la durata della terapia e la sua autonomia, dipendendo la stessa dalla quantità di essudato aspirato nel canister portatile e, di conseguenza, la prestazione risulta essere inferiore e non uniforme rispetto a quelle a batteria.

Per tali motivi si assegnano punti **2/5**

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso molto contenuto, anche se lo stantuffi opresente per creare la depressione risulta essere sporgente e di facile rottura. Inoltre per mantenere la depressione richiesta è necessario ripetere l'operazione con stantuffo più volte. E' presente sistema di trasporto.

Per tali motivi si assegnano punti **10/15**

Punto 4 La letteratura presentata è costituita da 2 studi randomizzati, un caso controllo, una analisi di letteratura (ma non sistematica) e un lavoro sperimentale. Nel complesso è quindi da ritenere Level of Evidence medio-basso.

Per tali motivi si assegnano punti **6/15**

Punto 5 Le medicazioni si presentano in più confezioni contenute in una scatola che riporta lotto e scadenza.

Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

Punto 6 La gamma e la tipologia delle medicazioni si presenta molto ridotta e applicabile solo su lesione aperta. Il pad adesivo in idrocolloide costituisce parte integrante della medicazione, e come tale non è conformabile.

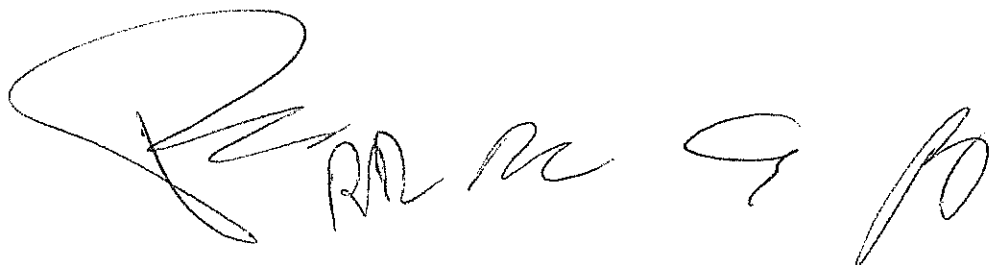
Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

Punto 7 Nel complesso il sistema si presenta insufficientemente maneggevole e poco pratico, non essendo possibile prevederne la durata. L'impossibilità inoltre di conformare il pad adesivo ne limita fortemente il nostro utilizzo.

Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

Preso atto delle insufficienze ottenute nella valutazione, 34 punti, la Ditta non raggiunge il punteggio minimo stabilito (42 punti).

AS

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. R. M. S. P.' or similar, written across the bottom of the page.

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA
www.aospd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aospd@pecveneto.it
via Nicolò Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA
c.f./p.iva 00349040287

VERBALE N. 3 del 7 settembre 2020

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE COMPLESSE PER L'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA PER IL PERIODO DI 48 MESI (COMPRENSIVO DELL'OPZIONE DI RINNOVO PER 24 MESI) – ID GARA 18P065

L'anno duemilaventi, il giorno 7 del mese di settembre alle ore 15,00 presso il Centro Gallucci - Biblioteca "Pier Giuseppe Cevese" dell'Azienda Ospedale – Università Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura aperta telematica mediante piattaforma Sintel, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" per l'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 31/01/2020.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 950 del 10/07/2020 è così composta:

PRESIDENTE: Dott. Roberto Bianco – U.O.C. Cardiocirurgia

COMPONENTI: Dott.ssa Carlotta Scarpa – U.O.C. Chirurgia Plastica

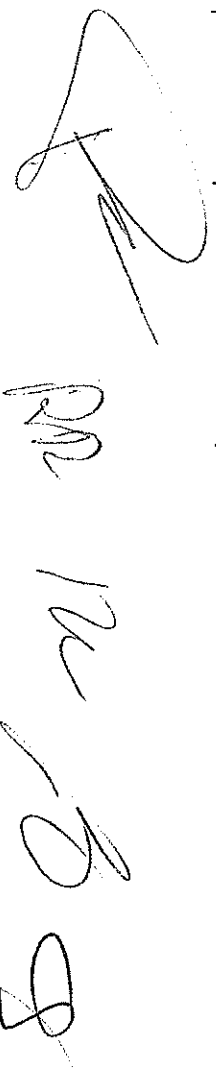
Dott. Alex Pontini – U.O.C. Grandi Ustionati

Dott. Enzo Mammanno – S.C. Chirurgia OSA



P.I. Roberto Bacchin – U.O.S. Ingegneria Clinica

PREMESSO

- che l'aggiudicazione della fornitura succitata verrà effettuata per lotto completo ed indivisibile (le ditte dovranno offrire tutti i riferimenti facenti parte del lotto);



AR

Dott. Enzo Mammamo	
P.I. Roberto Bacchin	

Verbalizzante: Dott.ssa Carlotta Scarpa



PR
S

Domande Gara ID18P058

ASSISTENZA

1. Qual è la Vostra Organizzazione sul Territorio?
2. C'è la presenza di un tecnico dedicato per Padova?
3. Qual è la tempistica di risposta dell'operatore?
4. Qual è la tempistica di distribuzione delle nuove macchine?
5. Qual è la tempistica ritiro e sanificazione delle apparecchiature utilizzate?
6. Fino a quante apparecchiature potete mantenere contemporaneamente disponibili?

APPARECCHIATURA

7. La durata della batteria dichiarata riguarda la batteria durante l'uso dell'apparecchiatura o durante lo stand by?
8. Sul monitor è presente un sistema grafico che indichi il livello della batteria e che sia completo di interpretazione grafica della durata?
9. Il monitor presente sull'apparecchiatura è touchscreen o no?
10. Il monitor presente sull'apparecchiatura è multicolor o no?
11. Il monitor rimane visibile anche qualora l'apparecchiatura sia posizionata all'interno della borsa da trasporto?
12. Una volta inserita l'apparecchiatura nella borsa di trasporto, il monitor è protetto da un sistema di pellicola trasparente oppure no?
13. La borsa per il trasporto è lavabile?
14. La borsa per il trasporto consente l'utilizzo di canister di diverse dimensioni o è necessaria una borsa più grande per i canister di maggiori dimensioni?
15. L'aggancio al letto è costituito dalla borsa o vi è un sistema di aggancio separato?
16. Gli allarmi sono acustici, con messaggio, con codice colore, con descrizione della causa e possibile risoluzione della stessa?
17. Quanto tempo impiega l'apparecchiatura per creare la depressione?
18. E' presente il seal check?
19. L'apparecchiatura è impermeabile?
20. L'apparecchiatura può essere disinfettata e se sì con quali detergenti?
21. I detergenti utilizzati per la sanificazione sono quelli in dotazione all'Azienda Ospedale – Università Padova o sono specifici per questo procedimento?



AP

MEDICAZIONI

22. Le confezioni delle medicazioni contengono quanti steridrape?
23. Gli steridrape forniti nella confezione sono sufficienti e di idonee dimensioni per essere utilizzati con le diverse misure della spugna in schiuma di poliuretano, o è necessario aprire ulteriori confezioni di steridrape per le schiume a maggiore dimensione?
24. Ci sono confezioni di soli steridrape a parte?
25. Ci sono confezioni contenenti a parte il sistema di fissaggio alla medicazione?
26. Sono presenti confezioni contenenti accessori quali ad esempio il raccordo ad Y o il gel adesivo? *(Tale domanda non è oggetto della quantificazione del punteggio)*
27. Le medicazioni sono conformabili?

Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a large, stylized 'P' followed by 'RR'. To the right, there are the initials 'na' followed by a large, stylized 'B' and a circled 'S'.A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA
www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
via Nicolò Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA
c.f./p.iva 00349040287

VERBALE N. 4 del 22 settembre 2020

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE COMPLESSE PER L'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA PER IL PERIODO DI 48 MESI (COMPRENSIVO DELL'OPZIONE DI RINNOVO PER 24 MESI) – ID GARA 18P065

L'anno duemilaventiti, il giorno 22 del mese di settembre alle ore 15,00 presso il Centro Gallucci - Biblioteca "Pier Giuseppe Cevese" dell'Azienda Ospedale – Università Padova si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura aperta telematica mediante piattaforma Sintel, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Sistemi a pressione negativa per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche complesse" per l'Azienda Ospedale - Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 31/01/2020.

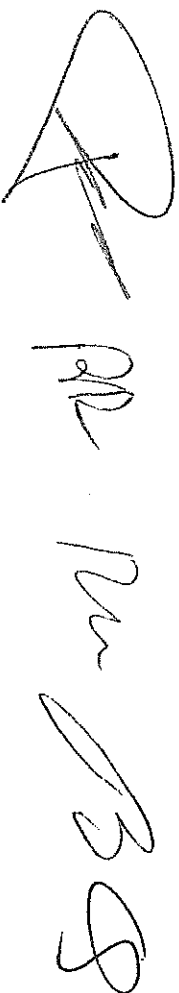
La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 950 del 10/07/2020 è così composta:

PRESIDENTE: Dott. Roberto Bianco – U.O.C. Cardiocirurgia

COMPONENTI: Dott.ssa Carlotta Scarpa – U.O.C. Chirurgia Plastica
Dott. Alex Pontini – U.O.C. Grandi Ustionati
Dott. Enzo Mammano – S.C. Chirurgia OSA
P.I. Roberto Bacchin – U.O.S. Ingegneria Clinica

PREMESSO

- che l'aggiudicazione della fornitura succitata verrà effettuata per lotto completo ed indivisibile (le ditte dovranno offrire tutti i riferimenti facenti parte del lotto);



MATERIALE DI CONSUMO		-	
5	Confezionamento (inteso come facilità di apertura del confezionamento primario, chiarezza e facile comprensibilità dei dati relativi al dispositivo contenuto, lotto, scadenza, ref, ecc.)	-	5
6	Sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione	-	10
7	Gamma, misure e caratteristiche tecniche delle medicazioni	-	15
APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO			
8	Maneggevolezza e praticità d'uso del sistema	-	5
TOTALE PUNTEGGIO			70

n.	Criteria di valutazione della qualità LOTTO 5	Punteggio minimo pena esclusione	Punteggio massimo
APPARECCHIATURE			
1	Assistenza tecnica (organizzazione del servizio, tecnici dedicati su Padova, tempi di risposta massima per intervento tecnico, risoluzione del guasto, da specificare, ed intervento tempestivo in caso di guasto) fornire autodichiarazione	-	5
2	Durata ed autonomia della batteria	-	5
3	Ingombro e sistema di trasporto	-	15
4	Numerosità e tipologia degli studi clinici a supporto dei prodotti presentati	-	15
MATERIALE DI CONSUMO		-	



BR

Mu




5	Confezionamento (inteso come facilità di apertura del confezionamento primario, chiarezza e facile comprensibilità dei dati relativi al dispositivo contenuto, lotto, scadenza, ref, ecc.)	-	10
6	Gamma, misure e caratteristiche tecniche delle medicazioni	-	10
APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO			
7	Maneggevolezza e praticità d'uso del sistema	-	10
TOTALE PUNTEGGIO			70

Non verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le ditte che totalizzeranno un punteggio di qualità inferiore al punteggio minimo di 42 punti.





Le risposte inviate dalle ditte relativamente al criterio 1: "Assistenza tecnica (organizzazione del servizio, tecnici dedicati su Padova, tempi di risposta massima per intervento tecnico, risoluzione del guasto, da specificare, ed intervento tempestivo in caso di guasto) fornire autodichiarazione" risultano complete e esaustive per poter procedere all'assegnazione del punteggio.

Gli allegati riportanti i punteggi con relative motivazioni assegnati alle ditte concorrenti vengono allegati al presente verbale e ne fanno parte integrante e sostanziale (n. 12 Allegati), e vengono riassunti nella tabella sottostante:






Lotto	MEDI-H-ART	Zuccato HC	Smith&Nephew	Sanacilia	Waldner	Lohmann	Convatec
1	NO requisiti minimi	NO punteggio minimo	58 punti	NO punteggio minimo	63 punti	50 punti	//////////
2	NO requisiti minimi	//////////	61 punti	//////////	62 punti	//////////	//////////
3	//////////	//////////	//////////	NO punteggio minimo	NO requisiti minimi	//////////	//////////
4	//////////	NO requisiti minimi	//////////	//////////	NO requisiti minimi	NO requisiti minimi	//////////
5	//////////	//////////	67 punti	//////////	NO punteggio minimo	//////////	60 punti

I lavori si concludono alle ore 16,30.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

AR

Dott. Roberto Bianco	
Dott.ssa Carlotta Scarpa	
Dott. Alex Pontini	
Dott. Enzo Marmaro	
P.I. Roberto Bacchin	

Verbalizzante: Rag. Fabio Moro



Lotto 1: Terapia a pressione negativa.

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione di ogni Ditta e all'assegnazione dei punteggi

Ditta Waldner Tecnologie Medicali

Punto 1 Si assegnano punti **5/5**

Punto 2 La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, ma tuttavia assente di pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touchscreen del dispositivo. Il sistema di aggancio al letto seppur presente, è basilico. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura, assieme alla sacca per la disinfezione. Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

Punto 4 Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore. Facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura però, pur essendo multicolor e touchscreen, non si presenta di ampie dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti **9/10**

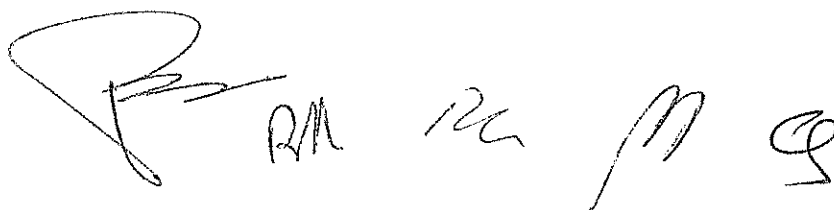
Punto 5 Le medicazioni in schiuma si presentano in confezione singola ma assenti di doppio sacchetto contenitore (solo sacchetto esterno). La medicazione in garza si presenta con ulteriore sacchetto contenitore la garza in rotolo. La confezione presenta lotto e data di scadenza con contenuto ben visibile dall'esterno, in quanto la busta è trasparente; l'etichettatura è ben visibile. Esternamente comunque appare ben descritto il tipo di medicazione e il contenuto della busta. La busta contiene: pellicola adesiva con serigrafie che possono aiutare l'operatore nell'applicazione e la cui applicazione appare maneggevole e semplice; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; è presente inoltre righello flessibile per la misurazione della lesione e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione. Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta idoneo, con chiare indicazioni per l'applicazione da parte dell'operatore. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. L'attacco del tubo al sistema di canister è rapido e a baionetta. Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

Punto 7 La medicazione è fornita in ampia gamma di dimensioni e forme, personalizzabile ritagliandola a seconda della necessità sia per dimensione che per spessore. (Numerosi gli accessori presentati a parte come, ad esempio, confezioni contenenti le sole pellicole adesive, o il solo sistema di fissaggio del tubo di aspirazione alla medicazione.) Per tali motivi si assegnano punti **15/15**

Punto 8 Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando touchscreen multicolor anche se di non ampie dimensioni; le medicazioni sono varie e facilmente applicabili. Il software appare di facile comprensione sia per i messaggi che per il codice colore, che aiuta l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Per tali motivi si assegnano punti **4/5**

TOTALE 63/70

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, the initials 'RM', '126', 'M', and 'G'.

Ditta Lohmann & Rauscher

Punto 1 Si assegnano punti 5/5

Punto 2 La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti 6/10

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, con pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. Il sistema di aggancio al letto seppur presente, è basico. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura, assieme ai contenitori per il serbatoio di aspirazione (grande e piccolo). La presenza pellicola protettiva la finestra di accesso al touchscreen ne consente una maggiore igiene. Per tali motivi si assegnano punti 9/10

Punto 4 Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore, è inoltre presente led che si illumina di diverso colore a seconda del buono e cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Gli allarmi risultano facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo di allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura si presenta di ampie dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti 10/10

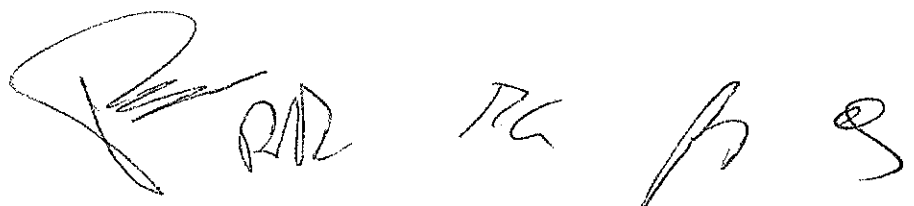
Punto 5 Le medicazioni si presentano in confezione singola con doppio sacchetto contenitore (sacchetto esterno non sterile e interno sterile). La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente comunque appare ben descritto il tipo di medicazione e il contenuto della busta. La busta contiene: pellicola adesiva senza serigrafie che possano aiutare l'operatore nell'applicazione che appare discretamente maneggevole; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione. Per tali motivi si assegnano punti 3/5

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, il meccanismo di fissaggio al serbatoio di aspirazione è a pressione diretta e a blocco. Tuttavia il meccanismo del sistema di inserimento del tubo di aspirazione e al serbatoio di drenaggio appare fragile per la presenza di parti in plastica facilmente usurabili, rendendo quindi il sistema stesso poco pratico. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti 4/10

Punto 7 La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta (3 misure), appena sufficiente; le dimensioni, seppur conformabili, sono standard. Le pellicole adesive si presentano assenti di serigrafie per l'operatore e di dimensioni ridotte. Solo la medicazione in garza presenta rotolo adesivo ritagliabile. Per tali motivi si assegnano punti 8/15

Punto 8 Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando con touchscreen multicolor e di ampie dimensioni. Il software appare di facile comprensione sia per la sequenza dei colori che per i messaggi che aiutano l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Per tali motivi si assegnano punti 5/5

TOTALE 50/70

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized signature, the initials 'R12', 'TC', and other scribbles.

Ditta Sanacilia

Punto 1 Disponibilità apparecchiature limitato (10 apparecchiature). Si assegnano punti **3/5**

Punto 2 La durata e autonomia della batteria è di 24 ore, ma deve essere verificato se anche quando in uso. Per tali motivi si assegnano punti **8/10**

Punto 3 L'apparecchiatura appare piuttosto ingombrante, completa di borsetta pluriuso in materiale scadente e non idonea a contenere il serbatoio di più grandi dimensioni. Non è presente valigetta contenitore e la cavetteria viene fornita a parte in sacchetto di plastica, così come il dispositivo stesso. Assente il sistema di fissaggio e aggancio al letto. Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

Punto 4 L'allarme è acustico e con messaggio su schermo che però si presenta monocoloro. Assente un codice colore che faciliti la comprensione dello stesso. Lo schermo non è touch screen per la gestione degli allarmi. Durante la prova la segnalazione di perdita d'aria si presenta solo dopo parecchi minuti. Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

Punto 5 Le medicazioni si presentano in confezione singola con doppio sacchetto contenitore (sacchetto esterno non sterile e interno sterile) solo per quelle in garza. Sulla busta principale sono presenti lotto e data di scadenza, la descrizione del contenuto è assolutamente sommaria. Per tali motivi si assegnano punti **2/5**

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, e privo di serigrafia che possa aiutare l'operatore nella sua applicazione, che comunque si presenta poco maneggevole e di non facile posizionamento. Il meccanismo di collegamento del tubo di drenaggio al sistema di aspirazione è a vite. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti **4/10**

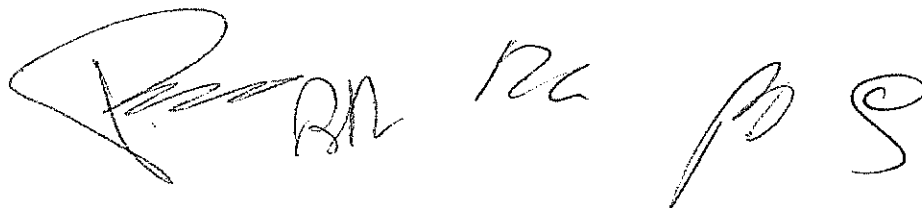
Punto 7 La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta (3 misure), le dimensioni, seppur conformabili, sono standard. Le pellicole adesive si presentano idonee con serigrafie che indicano all'operatore la corretta sequenza di applicazione. I canister sono disposable e graduati, ma i più grandi non solo utilizzabili con la borsa fornita per il trasporto. La medicazione in garza si presenta a tramatura larga, in pezzi e non a rotolo e di materiale appena accettabile. Per tali motivi si assegnano punti **6/15**

Punto 8 Nel complesso il sistema si presenta poco maneggevole e poco pratico non presentando touchscreen ed essendo monocoloro. Il software appare poco chiaro e il sistema di serbatoio (canister) non è sempre utilizzabile con la borsa in dotazione. Per tali motivi si assegnano punti **2/10**

AR

TOTALE 31/70

La Valutazione ha dimostrato 4 parametri pienamente insufficienti, la ditta non raggiunge il punteggio minimo stabilito nei documenti di gara (42 punti).

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, the initials 'AN', 'RC', and a signature that looks like 'PS'.

Ditta Smith & Nephew

Punto 1 Si assegnano punti 5/5

Punto 2 La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti 6/10

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, con pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. La borsa fornita in dotazione tuttavia non è idonea a contenere il canister di dimensioni maggiori. Il sistema di aggancio al letto è molto valido. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura. La presenza pellicola protettiva la finestra di accesso al touchscreen ne consente una maggiore igiene.

Per tali motivi si assegnano punti 9/10

Punto 4 Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore. Gli allarmi risultano facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura si presenta di ampie dimensioni, touchscreen, multicolor.

Per tali motivi si assegnano punti 10/10

Punto 5 Le medicazioni si presentano in confezione singola e unica busta. La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente è presente la descrizione del contenuto.

La busta contiene: pellicola adesiva con serigrafie che possono aiutare l'operatore nell'applicazione che appare maneggevole; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione.

Per tali motivi si assegnano punti 5/5

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta idoneo, il meccanismo di collegamento tra tubo di drenaggio e serbatoio appare a pressione e completato da ulteriore meccanismo di sicurezza a incastro. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Non sono tuttavia presenti serigrafie per l'operatore.

Per tali motivi si assegnano punti 9/10

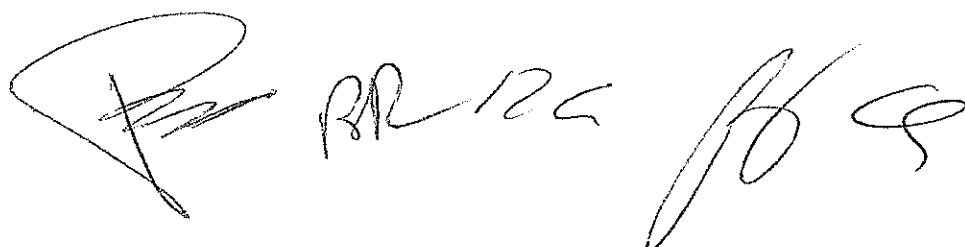
Punto 7 La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta varia ma comunque ridotta. Le medicazioni appaiono tuttavia conformabili. Le pellicole adesive sono numerose, ma presentano serigrafie per l'operatore appena sufficienti. La medicazione in garza si presenta in rotolo adesivo separato. (Numerosi gli accessori)

Per tali motivi si assegnano punti 10/15

Punto 8 Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando un touchscreen multicolor e di ampie dimensioni. Il software appare di facile comprensione sia per la sequenza dei colori che per i messaggi che aiutano l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Tuttavia la borsa in dotazione non risulta essere idonea a contenere il canister di maggiori dimensioni.

Per tali motivi si assegnano punti 4/5

TOTALE 58/70

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. The first is a large, stylized signature that appears to be 'R'. The second is 'RR 125'. The third is a signature that appears to be 'JG'.

Ditta Zuccato HC

Punto 1 Disponibilità apparecchiature limitato (30 apparecchiature). Si assegnano punti **4/5**

Punto 2 La durata e autonomia della batteria è di 24 ore, ma deve essere verificato se anche quando in uso. Per tali motivi si assegnano punti **8/10**

Punto 3 L'apparecchiatura appare leggermente ingombrante. Non è presente valigetta contenitore e la cavetteria viene fornita a parte. Non è presente un sistema di aggancio aletto specifico. Per tali motivi si assegnano punti **5/10**

Punto 4 Lo schermo si presenta monocolor e di dimensioni estremamente ridotte e non adeguate per la visualizzazione e l'interpretazione degli allarmi che risultano quindi difficilmente visibili e interpretabili. E' assente un codice colore. Per tali motivi si assegnano punti **2/10**

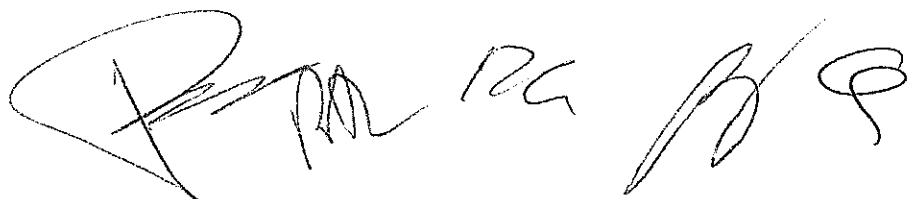
Punto 5 Le medicazioni si presentano in doppia busta. Sulla busta principale sono presenti lotto e data di scadenza, la descrizione del contenuto è assolutamente sommaria. Assenti le serigrafie per l'operatore. E' tuttavia presente righello per misurare la lesione. Per tali motivi si assegnano punti **3/5**

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, e privo di serigrafia che possa aiutare l'operatore nella sua applicazione, che comunque si presenta discretamente maneggevole. Il meccanismo di collegamento del tubo di drenaggio al sistema di aspirazione è a baionetta. Il sistema di serbatoio (canister) appare non adeguato presentando blocco a vite sull'apparecchiatura. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti **6/10**

Punto 7 La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta, così come le dimensioni delle pellicole adesive che sono prive di serigrafie. La spugna di poliuretano appare poco malleabile e poco maneggevole. Per tali motivi si assegnano punti **4/15**

Punto 8 Nel complesso il sistema si presenta poco maneggevole e poco pratico non presentando touchscreen ed essendo monocolor. Il software appare poco chiaro; il sistema di serbatoio (canister) appare non adeguato presentando sistema di aggancio all'apparecchiatura con blocco a vite. Per tali motivi si assegnano punti **2/10**

TOTALE 34/70 la ditta non raggiunge il punteggio minimo stabilito nei documenti di gara (42 punti).

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page. From left to right: a large signature, the initials 'RM', the initials 'RG', and another signature.

Lotto 2: Argento.

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione di ogni Ditta e all'assegnazione dei punteggi.

Ditta Waldner Tecnologie Medicali

Punto 1 Si assegnano punti 5/5

Punto 2 La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti 6/10

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, ma tuttavia assente di pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. Il sistema di aggancio al letto seppur presente, è basilico. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura, assieme alla sacca per la disinfezione. Per tali motivi si assegnano punti 9/10

Punto 4 Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore. Facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura però, pur essendo multicolor e touch screen, non si presenta di ampie dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti 9/10

Punto 5 Le medicazioni in schiuma si presentano in confezione singola ma assenti di doppio sacchetto contenitore (solo sacchetto esterno). La confezione presenta lotto e data di scadenza con contenuto ben visibile dall'esterno, in quanto la busta è trasparente; l'etichettatura è ben visibile. Esternamente comunque appare ben descritto il tipo di medicazione e il contenuto della busta.

La busta contiene: pellicola adesiva con serigrafie che possono aiutare l'operatore nell'applicazione e la cui applicazione appare maneggevole e semplice; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; è presente inoltre righello flessibile per la misurazione della lesione e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione.

Per tali motivi si assegnano punti 5/5

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta idoneo, con chiare indicazioni per l'applicazione da parte dell'operatore. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. L'attacco del tubo al sistema di canister è rapido e a baionetta.

Per tali motivi si assegnano punti 10/10

Punto 7 La medicazione è fornita in ampia gamma di dimensioni e forme, personalizzabile ritagliandola a seconda della necessità sia per dimensione che per spessore. L'argento richiesto appare contenuto all'interno della schiuma stessa, caratteristica questa che ne comporta la rimozione ogni qual volta la medicazione esterna, come ad esempio la pellicola adesiva o la schiuma, debba essere rinnovata. (Numerosi gli accessori presentati a parte come, ad esempio, confezioni contenenti le sole pellicole adesive, o il solo sistema di fissaggio del tubo di aspirazione alla medicazione.)

Per tali motivi si assegnano punti 14/15

Punto 8 Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando touchscreen multicolor anche se di **non** ampie dimensioni; le medicazioni sono varie e facilmente applicabili. Il software appare di facile comprensione sia per i messaggi che per il codice colore, che aiuta l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato.

Per tali motivi si assegnano punti 4/5

TOTALE 6/70

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'A. P.' followed by another signature. In the center, there are initials 'RA' and 'Pa'. On the right, there is a signature that looks like 'D. S.' and another set of initials.

Ditta Smith and Nephew

Punto 1 Si assegnano punti 5/5

Punto 2 La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti 6/10

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, con pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. La borsa fornita in dotazione tuttavia non è idonea a contenere il canister di dimensioni maggiori. Il sistema di aggancio al letto è molto valido. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura. La presenza pellicola protettiva la finestra di accesso al touchscreen ne consente una maggiore igiene.

Per tali motivi si assegnano punti 9/10

Punto 4 Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore. Gli allarmi risultano facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura si presenta di ampie dimensioni, touchscreen, multicolor.

Per tali motivi si assegnano punti 10/10

Punto 5 Le medicazioni si presentano in confezione singola e unica busta. La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente è presente la descrizione del contenuto.

La busta contiene: pellicola adesiva con serigrafie che possono aiutare l'operatore nell'applicazione che appare maneggevole; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione.

Per tali motivi si assegnano punti 5/5

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presentai idoneo, il meccanismo di collegamento tra tubo di drenaggio e serbatoio appare a pressione e completato da ulteriore meccanismo di sicurezza a incastro. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Non sono tuttavia presenti serigrafie per l'operatore.

Per tali motivi si assegnano punti 10/10

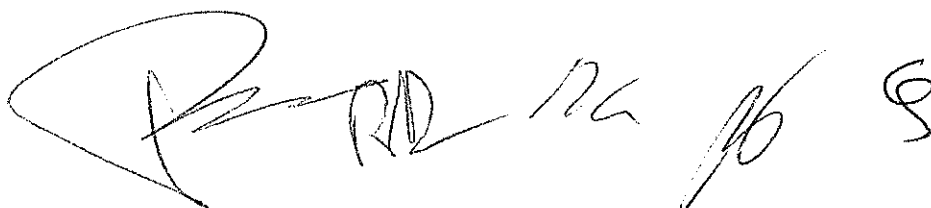
Punto 7 La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta varia ma comunque ridotta. Le medicazioni appaiono tuttavia conformabili. Le pellicole adesive sono numerose, ma presentano serigrafie per l'operatore appena sufficienti. L'argento è contenuto in una medicazione a parte (Acticoat) che viene posizionata al di sotto della schiuma in poliuretano consentendo la sua permanenza in sede, anche qualora sia necessario il cambio di medicazione esterna intesa come pellicola adesiva e/o schiuma di poliuretano. (Numerosi gli accessori).

Per tali motivi si assegnano punti 12/15

Punto 8 Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico presentando un touchscreen multicolor e di ampie dimensioni. Il software appare di facile comprensione sia per la sequenza dei colori che per i messaggi che aiutano l'operatore nell'installazione e monitoraggio. Il sistema di serbatoio (canister) è di facile aggancio e sgancio all'apparecchiatura e presenta valida scala graduata per controllare la quantità di essudato. Tuttavia la borsa in dotazione non risulta essere idonea a contenere il canister di maggiori dimensioni..

Per tali motivi si assegnano punti 4/5

TOTALE 61/70

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'R', 'RD', 'NG', 'PB', and 'S'.

Lotto 3: Instillazione

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione della Ditta Sanacilia.

La Ditta Waldner Tecnologie Medicali **NON** rispetta i requisiti minimi di durata della batteria e pertanto, nonostante presenti apparecchiatura valida, maneggevole e ampia gamma di medicazioni viene esclusa.

Ditta Sanacilia

Punto 1 Disponibilità apparecchiature limitato (10 apparecchiature). Si assegnano punti **3/5**

Punto 2 La durata e autonomia della batteria è di 24 ore, ma deve essere verificato se anche quando in uso. Per tali motivi si assegnano punti **8/10**

Punto 3 L'apparecchiatura appare piuttosto ingombrante, completa di borsetta pluriuso in materiale scadente e non idonea a contenere il serbatoio di più grandi dimensioni. Non è presente valigetta contenitore e la cavetteria viene fornita a parte in sacchetto di plastica, così come il dispositivo stesso. Assente il sistema di fissaggio e aggancio al letto. Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

Punto 4 L'allarme è acustico e con messaggio su schermo che però si presenta monocoloro. Assente un codice colore che faciliti la comprensione dello stesso. Lo schermo non è touchscreen per la gestione degli allarmi. Durante la prova la segnalazione di perdita d'aria si presenta solo dopo parecchi minuti. Per tali motivi si assegnano punti **3/10**

Punto 5 Le medicazioni si presentano in confezione singola con doppio sacchetto contenitore (sacchetto esterno non sterile e interno sterile) solo per quelle in garza. Sulla busta principale sono presenti lotto e data di scadenza, la descrizione del contenuto è assolutamente sommaria. Il sistema per instillazione si presenta a parte in ulteriore confezione. Per tali motivi si assegnano punti **2/5**

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, e privo di serigrafia che possa aiutare l'operatore nella sua applicazione, che comunque si presenta poco maneggevole e di non facile posizionamento. Il meccanismo di collegamento del tubo di drenaggio al sistema di aspirazione è a vite. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti **4/10**

Punto 7 La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta (3 misure), appena sufficiente, le dimensioni, seppur conformabili, sono standard. Le pellicole adesive si presentano idonee con serigrafie che indicano all'operatore la corretta sequenza di applicazione. I canister sono disposable e graduati, ma i più grandi non solo utilizzabili con la borsa fornita per il trasporto. La medicazione in garza si presenta a tramatura larga, in pezzi e non a rotolo e di materiale appena accettabile. Il sistema per instillazione consta di un semplice sistema a caduta che viene applicato come secondo pad sulla medicazione e come tale non risulta idoneo per il trattamento di lesioni di ridotte dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti **5/15**

Punto 8 Nel complesso il sistema si presenta poco maneggevole e poco pratico non presentando touchscreen ed essendo monocoloro. Il software appare poco chiaro e il sistema di serbatoio (canister) non è sempre utilizzabile con la borsa in dotazione. Per tali motivi si assegnano punti **2/10**

TOTALE 30/70 La valutazione ha dimostrato 4 parametri pienamente insufficienti, la ditta non raggiunge il punteggio minimo stabilito (42 punti)



Lotto 4: Addome Aperto

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione della Ditta Lohmann & Rauscher.

La Ditta Waldner **NON** rispetta i requisiti minimi di durata della batteria e pertanto, nonostante presenti apparecchiatura valida, maneggevole e medicazione assolutamente idonea al contatto con i visceri, non viene ammessa al prosieguo della gara.

La Ditta Zuccato **NON** rispetta i requisiti minimi: presenta Canister NON sterili e materiale NON idoneo al contatto con i visceri, in quanto manca in IFU la specifica di possibile utilizzo a contatto con gli stessi, e pertanto non viene ammessa al prosieguo della gara.

Ditta Lohmann

Punto 1 Si assegnano punti 5/5

Punto 2 La durata e autonomia della batteria sono al limite inferiore dei requisiti richiesti, ma sufficienti. Per tali motivi si assegnano punti 6/10

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso contenuto, completa di borsetta pluriuso, in materiale lavabile, con pellicola protettiva a coprire la finestra di accesso al touch screen del dispositivo. Il sistema di aggancio al letto seppur presente, è basico. La cavetteria è presente nella valigetta che contiene l'apparecchiatura, assieme ai contenitori per il serbatoio di aspirazione (grande e piccolo). La presenza pellicola protettiva la finestra di accesso al touchscreen ne consente una maggiore igiene. Per tali motivi si assegnano punti 9/10

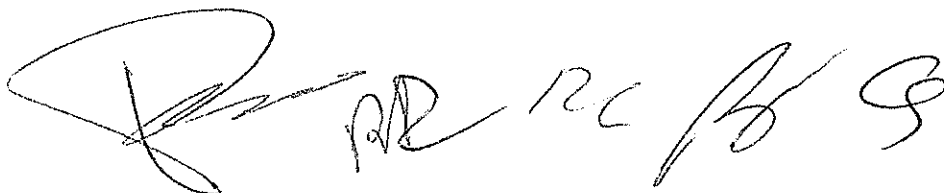
Punto 4 Gli allarmi sono presenti di tipo acustico e visivo con codice colore, è inoltre presente led che si illumina di diverso colore a seconda del buono e cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Gli allarmi risultano facilmente percepibili. E' presente inoltre messaggio esplicativo l'allarme e la possibile causa. Il display per la loro lettura si presenta di ampie dimensioni. Per tali motivi si assegnano punti 10/10

Punto 5 Le medicazioni si presentano in confezione singola. La confezione presenta lotto e data di scadenza. L'etichettatura è ben visibile. Esternamente comunque appare ben descritto il tipo di medicazione e il contenuto della busta. La busta contiene: pellicola adesiva senza serigrafie che possano aiutare l'operatore nell'applicazione che appare discretamente maneggevole; spugna in poliuretano personalizzabile nelle dimensioni; e sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione. E' presente involucro per "impacchettare" la spugna e applicarla a contatto con visceri. Per tali motivi si assegnano punti 3/5

Punto 6 Il sistema di fissaggio del tubo di drenaggio alla medicazione si presenta appena sufficiente, il meccanismo di fissaggio al serbatoio di aspirazione è a pressione diretta e a blocco. Tuttavia il meccanismo del sistema di inserimento del tubo di aspirazione e al serbatoio di drenaggio appare fragile per la presenza di parti in plastica facilmente rompibili, rendendo quindi il sistema stesso poco idoneo alla sua funzione. Il tubo si presenta con flusso unidirezionale e antikinking. Per tali motivi si assegnano punti 4/10

Punto 7 La gamma delle medicazioni in schiuma di poliuretano si presenta molto ridotta 1 sola misura non sufficiente. Le pellicole adesive si presentano assenti di serigrafie per l'operatore e di dimensioni ridotte. E' presente involucro per "impacchettare" la spugna e applicarla a contatto con visceri. Tale involucro si presenta assolutamente molto fragile alla minima trazione, e come tale assolutamente non adeguato al posizionamento all'interno dell'addome. La sua fragilità infatti comporta un elevato rischio di permanenza del materiale in sede e di contatto diretto della schiuma di poliuretano con i visceri, evenienza questa assolutamente dannosa.

Per tali motivi il materiale si ritiene NON IDONEO e NON rispondente ai requisiti minimi del Lotto in oggetto

Handwritten signature and initials, including 'AR' and 'RC'.

Punto 8 Non valutabile

L'offerta tecnica della Ditta non viene ammessa al prosieguo della presente gara.

Lotto 5: Monouso

Si aprono i contenitori del materiale e si procede alla valutazione delle varie Ditte.

Ditta Convatec

Punto 1 Si assegnano punti **5/5**

Punto 2 L'apparecchiatura è fornita con 6 batterie ministilo monouso, di cui 3 di ricambio.
Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso molto contenuto. Non è tuttavia presente sistema di trasporto dedicato.
Per tali motivi si assegnano punti **15/15**

Punto 4 La letteratura presentata consta di case report e case series. E' presente un solo studio randomizzato prospettico. Nel complesso quindi è da ritenere di basso Level of Evidence.
Per tali motivi si assegnano punti **5/15**

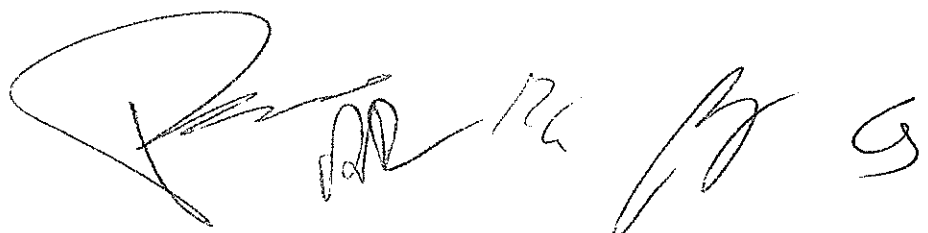
Punto 5 Le medicazioni si presentano in confezione singola e unica busta. La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente è presente comunque la descrizione del contenuto che appare comunque ben visibile essendo la confezione costituita di parte trasparente.
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

Punto 6 La gamma e la tipologia delle medicazioni si presenta molto varia (7 misure), e di facile applicazione grazie alle serigrafie presenti. La medicazione è applicabile su ferita chiusa.
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

Punto 7 Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico con allarmi ben visibili, il software si presenta di facile interpretazione
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

TOTALE 60/70

MR

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, several smaller initials, and a final 'G'.

Ditta Smith and Nephew

Punto 1 Si assegnano punti **5/5**

Punto 2 L'apparecchiatura è fornita con batterie stilo monouso senza ricambio. La durata comunque è sufficiente come da requisiti.

Per tali motivi si assegnano punti **5/5**

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso molto contenuto. E' presente sistema di trasporto.

Per tali motivi si assegnano punti **15/15**

Punto 4 La letteratura presentata è costituita da studi randomizzato, di cui uno prospettico e uno controllato e da una metaanalisi. Nel complesso è quindi da ritenere Level of Evidence medio alto.

Per tali motivi si assegnano punti **12/15**

Punto 5 Le medicazioni si presentano in confezione singola e unica busta. La confezione presenta lotto e data di scadenza, l'etichettatura è ben visibile. Esternamente è presente comunque la descrizione del contenuto che appare comunque ben visibile essendo la confezione costituita di parte trasparente.

Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

Punto 6 La gamma e la tipologia delle medicazioni si presenta molto varia (10 misure), e di facile applicazione grazie alle serigrafie presenti. La medicazione è applicabile su ferita chiusa.

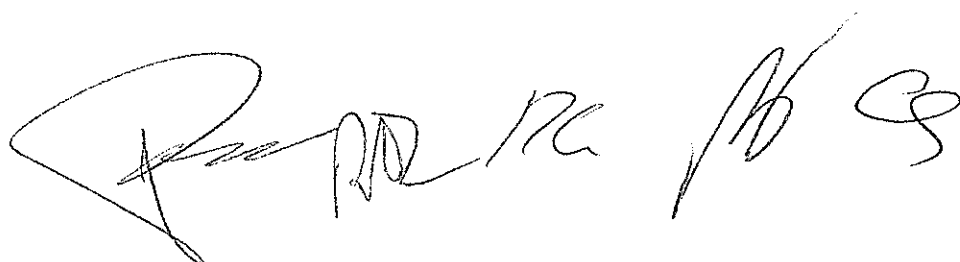
Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

Punto 7 Nel complesso il sistema si presenta maneggevole e pratico con allarmi ben visibili, il software si presenta di facile interpretazione

Per tali motivi si assegnano punti **10/10**

TOTALE 67/70

AK

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, the initials 'RD', 'MC', 'AB', and 'CS'.

Ditta Waldner

Punto 1 Si assegnano punti 5/5

Punto 2 L'apparecchiatura non prevede batterie essendo meccanica a depressione, come tale non è possibile prevedere la durata della terapia e la sua autonomia, dipendendo la stessa dalla quantità di essudato aspirato nel canister portatile e, di conseguenza, la prestazione risulta essere inferiore e non uniforme rispetto a quelle a batteria.

Per tali motivi si assegnano punti 2/5

Punto 3 L'apparecchiatura appare poco ingombrante e compatta, di peso molto contenuto, anche se lo stantuffo presente per creare la depressione risulta essere sporgente e di facile rottura. Inoltre per mantenere la depressione richiesta è necessario ripetere l'operazione con stantuffo più volte. E' presente sistema di trasporto.

Per tali motivi si assegnano punti 10/15

Punto 4 La letteratura presentata è costituita da 2 studi randomizzati, un caso controllo, una analisi di letteratura (ma non sistematica) e un lavoro sperimentale. Nel complesso è quindi da ritenere Level of Evidence medio-basso.

Per tali motivi si assegnano punti 6/15

Punto 5 Le medicazioni si presentano in più confezioni contenute in una scatola che riporta lotto e scadenza.

Per tali motivi si assegnano punti 10/10

Punto 6 La gamma e la tipologia delle medicazioni si presenta molto ridotta e applicabile solo su lesione aperta. Il pad adesivo in idrocolloide costituisce parte integrante della medicazione, e come tale non è conformabile.

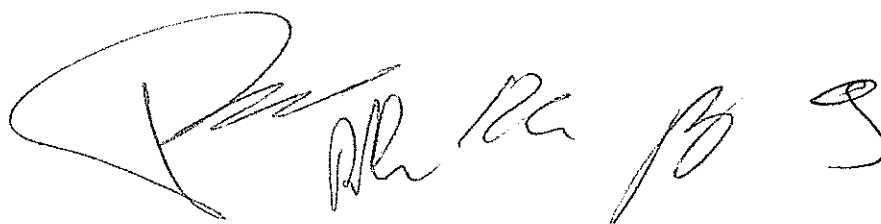
Per tali motivi si assegnano punti 3/10

Punto 7 Nel complesso il sistema si presenta insufficientemente maneggevole e poco pratico, non essendo possibile prevederne la durata. L'impossibilità inoltre di conformare il pad adesivo ne limita fortemente il nostro utilizzo.

Per tali motivi si assegnano punti 3/10

TOTALE 39/70

Preso atto delle insufficienze ottenute nella valutazione, la Ditta non raggiunge il punteggio minimo stabilito (42 punti).

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, the initials 'Alu', 'Ba', 'B', and 'S'.

AK

Handwritten initials

**OGGETTO: ID 18P058 SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE
COMPLESSE PER L'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA**

La scrivente Impresa SMITH & NEPHEW S.R.L., con sede legale in ... AGGATE BRINAZZA (MB), Via ... DE CARPANI 2/A, avverte p. l. n. n. 00953780992/09531210154, nella persona del Legale Rappresentante ... STEFANIA MAINO, nato a ... MONZA, il 02/10/1976, in riferimento alla Procedura APERTA, per la fornitura di "ID 18P058 SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE COMPLESSE PER I FABBISOGNI DELL'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA", presso l'Unità Operativa di Assistenza Chirurgica e Oncologica, in relazione all'oggetto della gara e delle condizioni che regolano la fornitura in oggetto, formula la seguente offerta n. 23952/2020/Prv. _____

Firma: *Stefania Maino*

Lotto Rif.	Descrizione prodotto	Nome commerciale	Codice prodotto	Marca prodotto	CND	Numero iscrizione repertorio (se Direttiva 93/42/CEE)	Fabbisogno per 12 mesi	Prezzo unitario	Prezzo x 12 mesi (prezzo unitario x fabbisogno)	Prezzo complessivo per 48 mesi	Percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta (MAX 5 decimali)
2 1	Descrizione 2.1	Console REMASYS TOUCH 4th Edition (2019) - Unità di azione comprensiva di: REMASYS TOUCH contenitore per trasporto	66802134	SMITH & NEPHEW	212040205	1778920	800	€ 2,11	€ 1.688,00	€ 6.752,00000	
		REMASYS TOUCH tracciola	66801276	SMITH & NEPHEW	212040205	1360598					
		REMASYS TOUCH borsa	66801277	SMITH & NEPHEW	212040205	1360595					
		REMASYS TOUCH asta di supporto per pompa (completa di clamp per letto)	66801278	SMITH & NEPHEW	212040205	1451750					
		REMASYS TOUCH alimentatore 220 Vac	66801286	SMITH & NEPHEW	212040205	1451724					
2 2	Descrizione 2.2	REMASYS - F	66800794	SMITH & NEPHEW	M90999	1413611		€ 30,00			
		REMASYS - F Kit Medium	66800795	SMITH & NEPHEW	M90999	1413613	200	€ 30,00	€ 6.000,00	€ 24.000,00000	
		REMASYS - F Kit Large	66800796	SMITH & NEPHEW	M90999	1413679		€ 30,00			
		REMASYS - F Kit Extra Large	66800797	SMITH & NEPHEW	M90999	1413738		€ 30,00			
		ACTICCAT FLEX cm. 10 x 10	66800399	SMITH & NEPHEW	M09000201	983839	200	€ 6,12	€ 1.224,00	€ 4.896,00000	
2 3	Descrizione 2.3	REMASYS TOUCH canister integrato									
		REMASYS TOUCH canister integrato da 300 ml con solidificante	66801273	SMITH & NEPHEW	A060399	1360582		€ 30,00			
		REMASYS TOUCH canister integrato da 800 ml con solidificante	66801274	SMITH & NEPHEW	A060399	1360590	200	€ 36,00	€ 6.000,00	€ 24.000,00000	
		REMASYS TOUCH canister integrato da 300 ml senza solidificante non sterile	66801275	SMITH & NEPHEW	A060399	1497534		€ 30,00			
TOTALE OFFERTA ECONOMICA (48 mesi)										€ 59.648,00000	
TOTALE PERCENTUALE RIBASSO										34,07765%	

N.B. Il prezzo del Lotto 1 Rif.to 1, del Lotto 2 Rif.to 1, del Lotto 3 Rif.to 1 e del Lotto 4 Rif.to 1 dovrà essere comprensivo della manutenzione e assistenza tecnica Full-Risk per ciascuna apparecchiatura

Per i punti 1, 2, 3 e 4 si precisa quanto segue:

Nel caso in cui i Kit medicazione e i contenitori siano articolati in diverse misure e capacità, nell'offerta la ditta dovrà proporre UN UNICO PREZZO

Nell'offerta dovrà essere indicato il VALORE COMMERCIALE di ciascuna apparecchiatura offerta

Nell'offerta dovrà essere indicato il costo per l'eventuale passaggio di proprietà delle apparecchiature al termine del periodo contrattuale

Nell'offerta dovrà essere riportata la PERCENTUALE DI SCONTO che verrà applicata sull'ULTIMO LISTINO PREZZI PER TUTTA LA DURATA DELLA FORNITURA per l'acquisto di eventuale ulteriore materiale di consumo

VALORE COMMERCIALE DELL'APPARECCHIATURA OFFERTA € 34.048,45 (comprensiva di accessori) IVA esclusa
costo per l'eventuale passaggio di proprietà delle apparecchiature al termine del periodo contrattuale € 3.500,00 IVA esclusa
PERCENTUALE DI SCONTO che verrà applicata sull'ULTIMO LISTINO PREZZI PER TUTTA LA DURATA DELLA FORNITURA per l'acquisto di eventuale ulteriore materiale di consumo 30% (trentapercento)

Tutti i prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per almeno 240 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

Struttura economica dell'offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate negli articoli 95, c. 10 e nell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio.

Voci di prezzo	%	costo
costi industriali:	36,90%	22010,11
costi generali:	41,70%	24673,22
costi della manodopera	18,20%	10855,94
costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante)		
costi per la formazione del personale	0,10%	59,65
eventuali altri costi	//	59,65
utili di impresa	3,0%	1789,44
onni della sicurezza in relazione ai rischi, infortuni, valutati dalla Stazione appaltante non soggetti a noasso.	0%	0

OGGETTO: ID 18P058 SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE COMPLESSE PER L'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA

La scrivente impresa SMITH & NEPHEW S.p.A., con sede legale in AGATE BRANCA (MB), Via DE CABITANI 2/A, av. P.I.C.F. n. 00953780962/09631210154, nella persona del Legale Rappresentante STEFANIA MAINO, nato a MONZA, il 02/10/1970, in riferimento alla Procedura APERTA, per la fornitura di ID 18P058 SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO AVANZATO DI FERITE ACUTE E CRONICHE COMPLESSE PER I FABBRICOMI DELL'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA, presso l'attuale modalità di aspletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura in oggetto, formula la seguente offerta:

n. 2385272020hrv _____ Firma: _____

Lotto	Rif.	Descrizione prodotto	Nome commerciale	Codice prodotto	Marca prodotto	CND	Numero iscrizione repertorio (se Direttiva 93/42/CEE)	Fabbisogno per 12 mesi	Prezzo unitario	Prezzo x 12 mesi (prezzo unitario x fabbisogno)	Prezzo complessivo per 48 mesi	Percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta (MAX 5 decimali)
5	1	Descrizione 5.1	medicazione	66802010	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678581		€ 135,00			
			medicazione	66802011	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678559		€ 135,00			
			medicazione cm 10 x 20	66802012	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678560		€ 135,00			
			medicazione cm 10 x 30	66802013	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678561		€ 135,00			
			medicazione cm 10 x 40	66802014	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678563	200	€ 135,00	€ 27.000,00	€ 108.000,00000	
			medicazione cm 15 x 15	66802015	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678564		€ 135,00			
			medicazione cm 15 x 20	66802016	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678582		€ 135,00			
			medicazione cm 15 x 30	66802017	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678584		€ 135,00			
			medicazione cm 20 x 20	66802018	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678578		€ 135,00			
			medicazione cm 25 x 25	66802019	SMITH & NEPHEW	Z12040205	1678579		€ 135,00			
TOTALE OFFERTA ECONOMICA (48 mesi)										€ 108.000,00		
TOTALE PERCENTUALE RIBASSO											10,00000%	

Per il lotto 5 si precisa quanto segue:

Nell'offerta dovrà essere riportata la PERCENTUALE DI SCONTO che verrà applicata sull'ULTIMO LISTINO PREZZI PER TUTTA LA DURATA DELLA FORNITURA per l'acquisto di eventuale ulteriore materiale di consumo

PERCENTUALE DI SCONTO che verrà applicata sull'ULTIMO LISTINO PREZZI PER TUTTA LA DURATA DELLA FORNITURA per l'acquisto di eventuale ulteriore materiale di consumo: 45% (quarantacinquepercento)

Tutti i prezzi sopra indicati sono impegnativi e irrevocabili per almeno 240 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

Sintetizza economicamente l'offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate negli articoli 95, c. 10 e nell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio:

Voci di prezzo	%	costo
costi industriali	36,90%	39852,00
costi generali	41,70%	45036,00
costi della manodopera	18,20%	19656,00

costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (dalla partecipante)	0,10%	108,00
costi per la formazione del personale	0,10%	108,00
eventuali altri costi	0	0
utili di impresa	3,0%	3240,00
oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione appaltante non soggetti a ribasso	0%	0