

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

ID GARA N. 20SIC030 – FORNITURA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER ENDOSCOPIA ED ECOENDOSCOPIA OLYMPUS DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITÀ PADOVA.

VERBALE DEL 01/06/2021

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 1 (uno) del mese di giugno alle ore 9,20 (nove\venti) in Padova presso la sede della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica sita in Viale della Navigazione Interna n. 38 Padova, ha luogo la seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica della ditta partecipante alla gara per la fornitura di servizio di manutenzione e assistenza tecnica di apparecchiature elettromedicali per endoscopia ed eco endoscopia Olympus di proprietà dell'Azienda Ospedale- Università Padova indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 18/2/2021.

In data 31 maggio 2021 si è provveduto a comunicare e convocare la ditta per presenziare a distanza alla seduta pubblica tramite Google Meet.

Il seggio di gara incaricato individuato con nota del Sostituto Responsabile della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica del 01/06/2021 è costituito da:

- Ing. Francesca Menotto– in qualità di Autorità di gara
- Sig. Marco Ravazzi - in qualità di teste
- Dott.ssa Veronica Abbate - in qualità di teste e verbalizzante.

La procedura viene espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL.

Si prende atto che la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore



Generale n. 812 del 06/05/2021, ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate dalla ditta ammessa alla gara durante la seduta pubblica del 20/04/2021, e ha redatto per ogni attività svolta il relativo verbale che qui si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegati n. 3)

In via preliminare vengono ricordate le modalità di aggiudicazione.

L'autorità di gara procede alla lettura del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice contenente la valutazione qualitativa effettuata e comunicando i relativi punteggi finali attribuiti a ciascuna offerta.

Dall'analisi tecnica svolta dalla Commissione Giudicatrice risulta che:

- La ditta Olympus ha ottenuto un punteggio tecnico di 65/70.

Si procede, quindi, all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica, dando lettura dell'importo offerto.

In base alle disposizioni previste negli atti di gara il punteggio complessivo raggiunto dalle ditte (punteggio parametro prezzo + punteggio parametri qualità), individua quanto segue:

- La ditta Olympus ha ottenuto un punteggio complessivo di 95/100 quale aggiudicatario.

Si procederà alle verifiche relative all'anomalia, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, per l'offerta presentata.

La seduta di gara si conclude alle ore 9,35 (nove/trentacinque).

Il presente verbale, steso in base alle risultanze di gara, è composto da n. 2 (due) facciate e n. 3 (tre) allegati e viene sottoscritto come segue, previa lettura e conferma:

AUTORITA' DI GARA



TESTE



TESTE VERBALIZZANTE



VERBALE N. 1 DELL'11 MAGGIO 2021

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER ENDOSCOPIA ED ECOENDOSCOPIA OLYMPUS PER L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

ID.GARA N. 20SIC030

L'anno duemilaventuno, il giorno 11 maggio alle ore 14,30 presso l' Aula Battocchio si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura ID 20SIC030, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura "servizio di manutenzione e assistenza tecnica di apparecchiature elettromedicali per endoscopia ed ecoendoscopia Olympus" per l'Azienda Ospedale-Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 18/02/2021.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 812 del 06/05/2021, è così composta:


Presidente: Dr.Francesco Ferrara – U.O.C. Gastroenterologia
Componente: Dr.ssa Gabri Bertaglia – D.M.O. Piastra Endoscopia Digestiva
Componente: Ing. Marco Benozzi – U.O.S. Ingegneria Clinica

PREMESSO

- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
 - qualità punteggio massimo punti 70
 - prezzo punteggio massimo punti 30

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti componenti;
- rileva che entro i termini previsti ha presentato offerta per la gara in oggetto la seguente ditta Olympus Italia S.r.l.;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
 - la presentazione della gara
 - l'esame della documentazione tecnica presentata dalla ditta concorrente tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato Speciale;



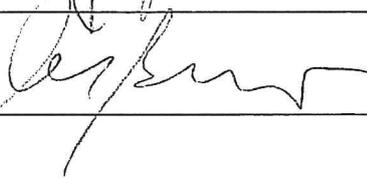


LA COMMISSIONE

Valutata la complessità della documentazione presentata, ritiene di effettuare una prima lettura individuale e fissa il prossimo incontro il 17.5.2021.

I lavori terminano alle ore 15,15.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Presidente: Dr. Francesco Ferrara	
Componente: Dott.ssa Gabri Bertaglia	
Componente: Ing. Marco Benozzi	

Il Verbalizzante

Dott.ssa Veronica Abbate

**VERBALE N.2 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 17/05/2021
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER ENDOSCOPIA ED
ECOENDOSCOPIA OLYMPUS PER L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**

ID.GARA N. 20SIC030

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore 11,30 presso l'Aula Battocchio si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura ID 20SIC030, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura "servizio di manutenzione e assistenza tecnica di apparecchiature elettromedicali per endoscopia ed ecoendoscopia Olympus" per l'Azienda Ospedale-Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 18/02/2021.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 812 del 06/05/2021, è così composta:

Presidente: Dr.Francesco Ferrara – U.O.C. Gastroenterologia
Componente: Dr.ssa Gabri Bertaglia – D.M.O. Piastra Endoscopia Digestiva
Componente: Ing. Marco Benozzi – U.O.S. Ingegneria Clinica

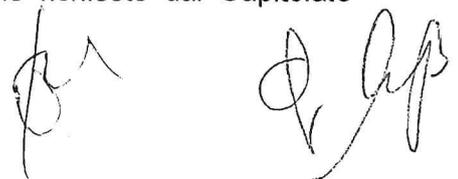
PREMESSO

- che la fornitura di cui trattasi sarà effettuata a lotto unico;
- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
 - l'esame della documentazione tecnica presentata dalla ditta partecipante;
 - l'analisi della documentazione tecnica secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale e dal Disciplinare di gara;
 - la verifica del possesso dei requisiti e delle caratteristiche minime richieste dal Capitolato Speciale;

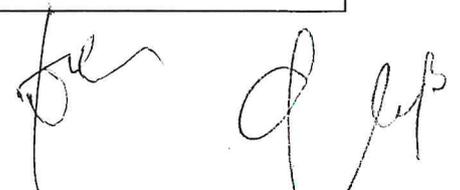


- l'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione della qualità indicati nel Capitolato Speciale.

LA COMMISSIONE

- verificata la completezza di tutta la documentazione tecnica presentata;
- dà corso alla lettura della documentazione tecnica secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale e dal Disciplinare di gara;
- rileva, dall'analisi della documentazione tecnica presentata dalla Ditta concorrente, la presenza dei requisiti minimi richiesti, per ciascun riferimento, dal Capitolato Speciale, come indicato nel prospetto sotto riportato;

Requisiti minimi	DITTA Olympus
servizio di manutenzione preventiva, comprensiva di prove funzionali e/o di tarature e in accordo a criteri prescritti dal fabbricante;	si
verifiche di sicurezza conformemente alle norme CEI di pertinenza (CEI 62-5, particolari e collaterali);	si
servizio di manutenzione correttiva per garantire il ripristino delle condizioni di normale funzionamento a seguito di segnalazioni di guasto e/o malfunzionamento anche se causato da danni accidentali durante il normale utilizzo (schiacciamenti, morsicature, infiltrazioni);	si
fornitura di tutte le parti difettose, di tutti i ricambi, le parti usurabili necessarie al funzionamento, sostituite sia durante la manutenzione preventiva sia durante la manutenzione correttiva;	si
rigenerazione dei canali in caso di positività rilevata a seguito di procedura interna per usura;	si
ritiro e smaltimento delle parti sostituite;	si
assistenza telefonica;	si
servizio di trasporto dall'AOPD e verso il laboratorio esterno e viceversa qualora sia necessario trasportare l'apparecchiatura o parte di essa presso un laboratorio specialistico esterno con fornitura di tutti gli imballi e materiali anche nella situazione di endoscopio non ricondizionato;	si
assistenza diretta presso i reparti dove vengono utilizzate le apparecchiature (on site);	si



tempo massimo di intervento/ritiro garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (cioè macchina non utilizzabile) = 8 ore lavorative dalla chiamata;	si
tempo massimo di intervento/ritiro garantito in caso di chiamata per guasto tecnico non bloccante (cioè macchina utilizzabile) = 16 ore lavorative dalla chiamata;	si
tempo massimo di risoluzione guasto dalla chiamata per guasto bloccante = 32 ore lavorative (cioè macchina ferma al massimo 4 giorni dalla chiamata) o fornitura del muletto;	si
interventi di manutenzione evolutiva consistenti in fornitura di eventuali upgrade software e hardware previsti dal fabbricante riguardanti adeguamenti a normative nazionali;	si
raccordarsi su richiesta dell'ente Appaltante con il fabbricante a seguito di segnalazioni o azioni di campo in caso di problematiche che hanno generato incidenti o mancati incidenti e/o segnalazioni al Ministero secondo quanto previsto dalla Dispositivo Vigilanza.	si
le parti di ricambio devono essere nuove e originali o comunque previste dal fabbricante, in modo da poter effettuare eventuali interventi senza causare alterazioni, variazioni o modifiche al dispositivo che possano provocare un deterioramento del livello di sicurezza e funzionalità garantito dalla marcatura CE	si
personale tecnico impiegato nel servizio di manutenzione deve essere adeguatamente addestrato e qualificato, e costantemente aggiornato secondo quanto stabilito nel manuale d'uso e di service e secondo le procedure previste dal fabbricante per la specifica apparecchiatura	si
personale tecnico impiegato nel servizio di manutenzione deve essere formato sulle casistiche di guasto e specializzato sulle singole tipologie di apparecchiature affinché sia preservato lo stato di efficienza e durabilità nel tempo dell'apparecchiatura anche in caso di riparazioni con sostituzione di parti importanti	si
personale tecnico impiegato nel servizio di manutenzione deve essere avere un'esperienza adeguata o una rete di supporto che permetta di conoscere in anticipo eventuali problematiche relative a difetti/ usure e diagnostica di guasto, al fine di prevedere delle manutenzioni proattive e la riduzione dei tempi di fermo macchina	si
personale tecnico impiegato nel servizio di manutenzione deve esse-	si

re disporre di un magazzino di ricambi nuovi e originali e di muletti secondo quanto richiesto nell' Allegato H "Muletti" che dovrà essere compilato in ogni sua parte	
Per la movimentazione di endoscopi che a causa dei guasti rilevati non possono essere sanificati e ricondizionati in lavaendoscopi si chiede di presentare la propria procedura per l'imballo e il trasporto in regime di sicurezza.	si


- durante l'attribuzione dei punteggi di qualità sulla base dell'analisi della documentazione tecnica presentata dalla Ditta concorrente, è necessario richiedere alcune precisazioni, quali:

1. Relativamente al punto "tempo massimo di intervento/ritiro garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (cioè macchina non utilizzabile) = 8 ore lavorative dalla chiamata" delle caratteristiche minime si richiede in base a quali elementi si definisce il guasto bloccante e a chi compete questa valutazione (ingegneria clinica e/o tecnico Olympus on site)
2. In relazione alla domanda precedente, da quando è prevista la fornitura del muletto? Dal momento dell'apertura della chiamata o dalla valutazione del tecnico?
3. In riferimento all'allegato H, il numero dei muletti riportato nella colonna dotazione migliorativa intende il numero di apparecchi disponibili riservati all'Azienda Ospedale- Università Padova o un numero di apparecchi disponibili a magazzino su base territoriale (locale, regionale,nazionale)?
4. Riguardo le modalità di imballo e il trasporto in regime di sicurezza, si richiedono maggiori dettagli nell'individuazione degli strumenti imbustabili di categoria B e disponibilità a fornire presidi e materiali adeguati.

La Commissione demanda al Provveditorato di richiedere alla ditta quanto sopra espresso.

La Commissione termina i lavori alle 12,40.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Presidente: Dr. Francesco Ferrara	
Componente: Dott.ssa Gabri Bertaglia	
Componente: Ing. Marco Benozzi	

Il verbalizzante: Dott.ssa Veronica Abbate

**VERBALE N.3 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 25/05/2021
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER ENDOSCOPIA ED
ECOENDOSCOPIA OLYMPUS PER L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**

ID.GARA N. 20SIC030

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 10,30 presso l'Aula Battocchio si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura ID 20SIC030, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura "servizio di manutenzione e assistenza tecnica di apparecchiature elettromedicali per endoscopia ed ecoendoscopia Olympus" per l'Azienda Ospedale-Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 18/02/2021.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 812 del 06/05/2021, è così composta:

Presidente:	Dr.Francesco Ferrara – U.O.C. Gastroenterologia
Componente:	Dr.ssa Gabri Bertaglia – D.M.O. Piastra Endoscopica Digestiva
Componente:	Ing. Marco Benozzi – U.O.S. Ingegneria Clinica

PREMESSO

- che la fornitura di cui trattasi sarà effettuata a lotto unico;
- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:

- la lettura delle risposte alle precisazioni richieste;

- l'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione della qualità indicati nel Capitolato Speciale in seguito alla richiesta di chiarimenti da parte della Commissione.

LA COMMISSIONE



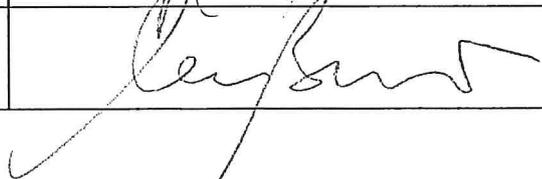


- procede, sulla base dell'analisi della documentazione tecnica presentata dalla Ditta concorrente e delle precisazioni fornite, all'attribuzione finale dei punteggi di qualità, come indicato nel prospetto sotto riportato.

Criteria di valutazione della qualità	Punteggio massimo	Ditta Olympus	note
Struttura organizzativa (personale dedicato numero, formazione, competenze professionali ed esperienza tecnica specialistica, organizzazione sede e orario di disponibilità telefonica)	20	20	
Soluzioni organizzative, logistiche e tecnologiche (gestione magazzino ricambi indicando sede consistenza e modalità e tempi di rifornimento, strumenti di test e analizzatori di sicurezza e funzionalità, tool di configurazione)	15	15	
Gestione delle attività programmate (manutenzioni preventive, funzionali e verifiche di sicurezza elettrica) allegando i protocolli operativi, la modulistica e la periodicità	10	10	
Gestione della manutenzione correttiva: miglioramento dei livelli prestazionali richiesti in capitolato, istruzioni e procedure operative, modalità della gestione in caso di fermo macchina e modulistica	10	10	
Numero e tipo di muletti disponibili migliorativi come indicato nell'allegato H	15	10	Scarsa disponibilità per alcune tipologie di strumenti
Punteggio totale	70	65	

La Commissione termina i lavori alle 11,00

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Presidente: Dr. Francesco Ferrara	
Componente: Dott.ssa Gabri Bertaglia	
Componente: Ing. Marco Benozzi	

Il verbalizzante: Dott.ssa Veronica Abbate